


Vista 120S



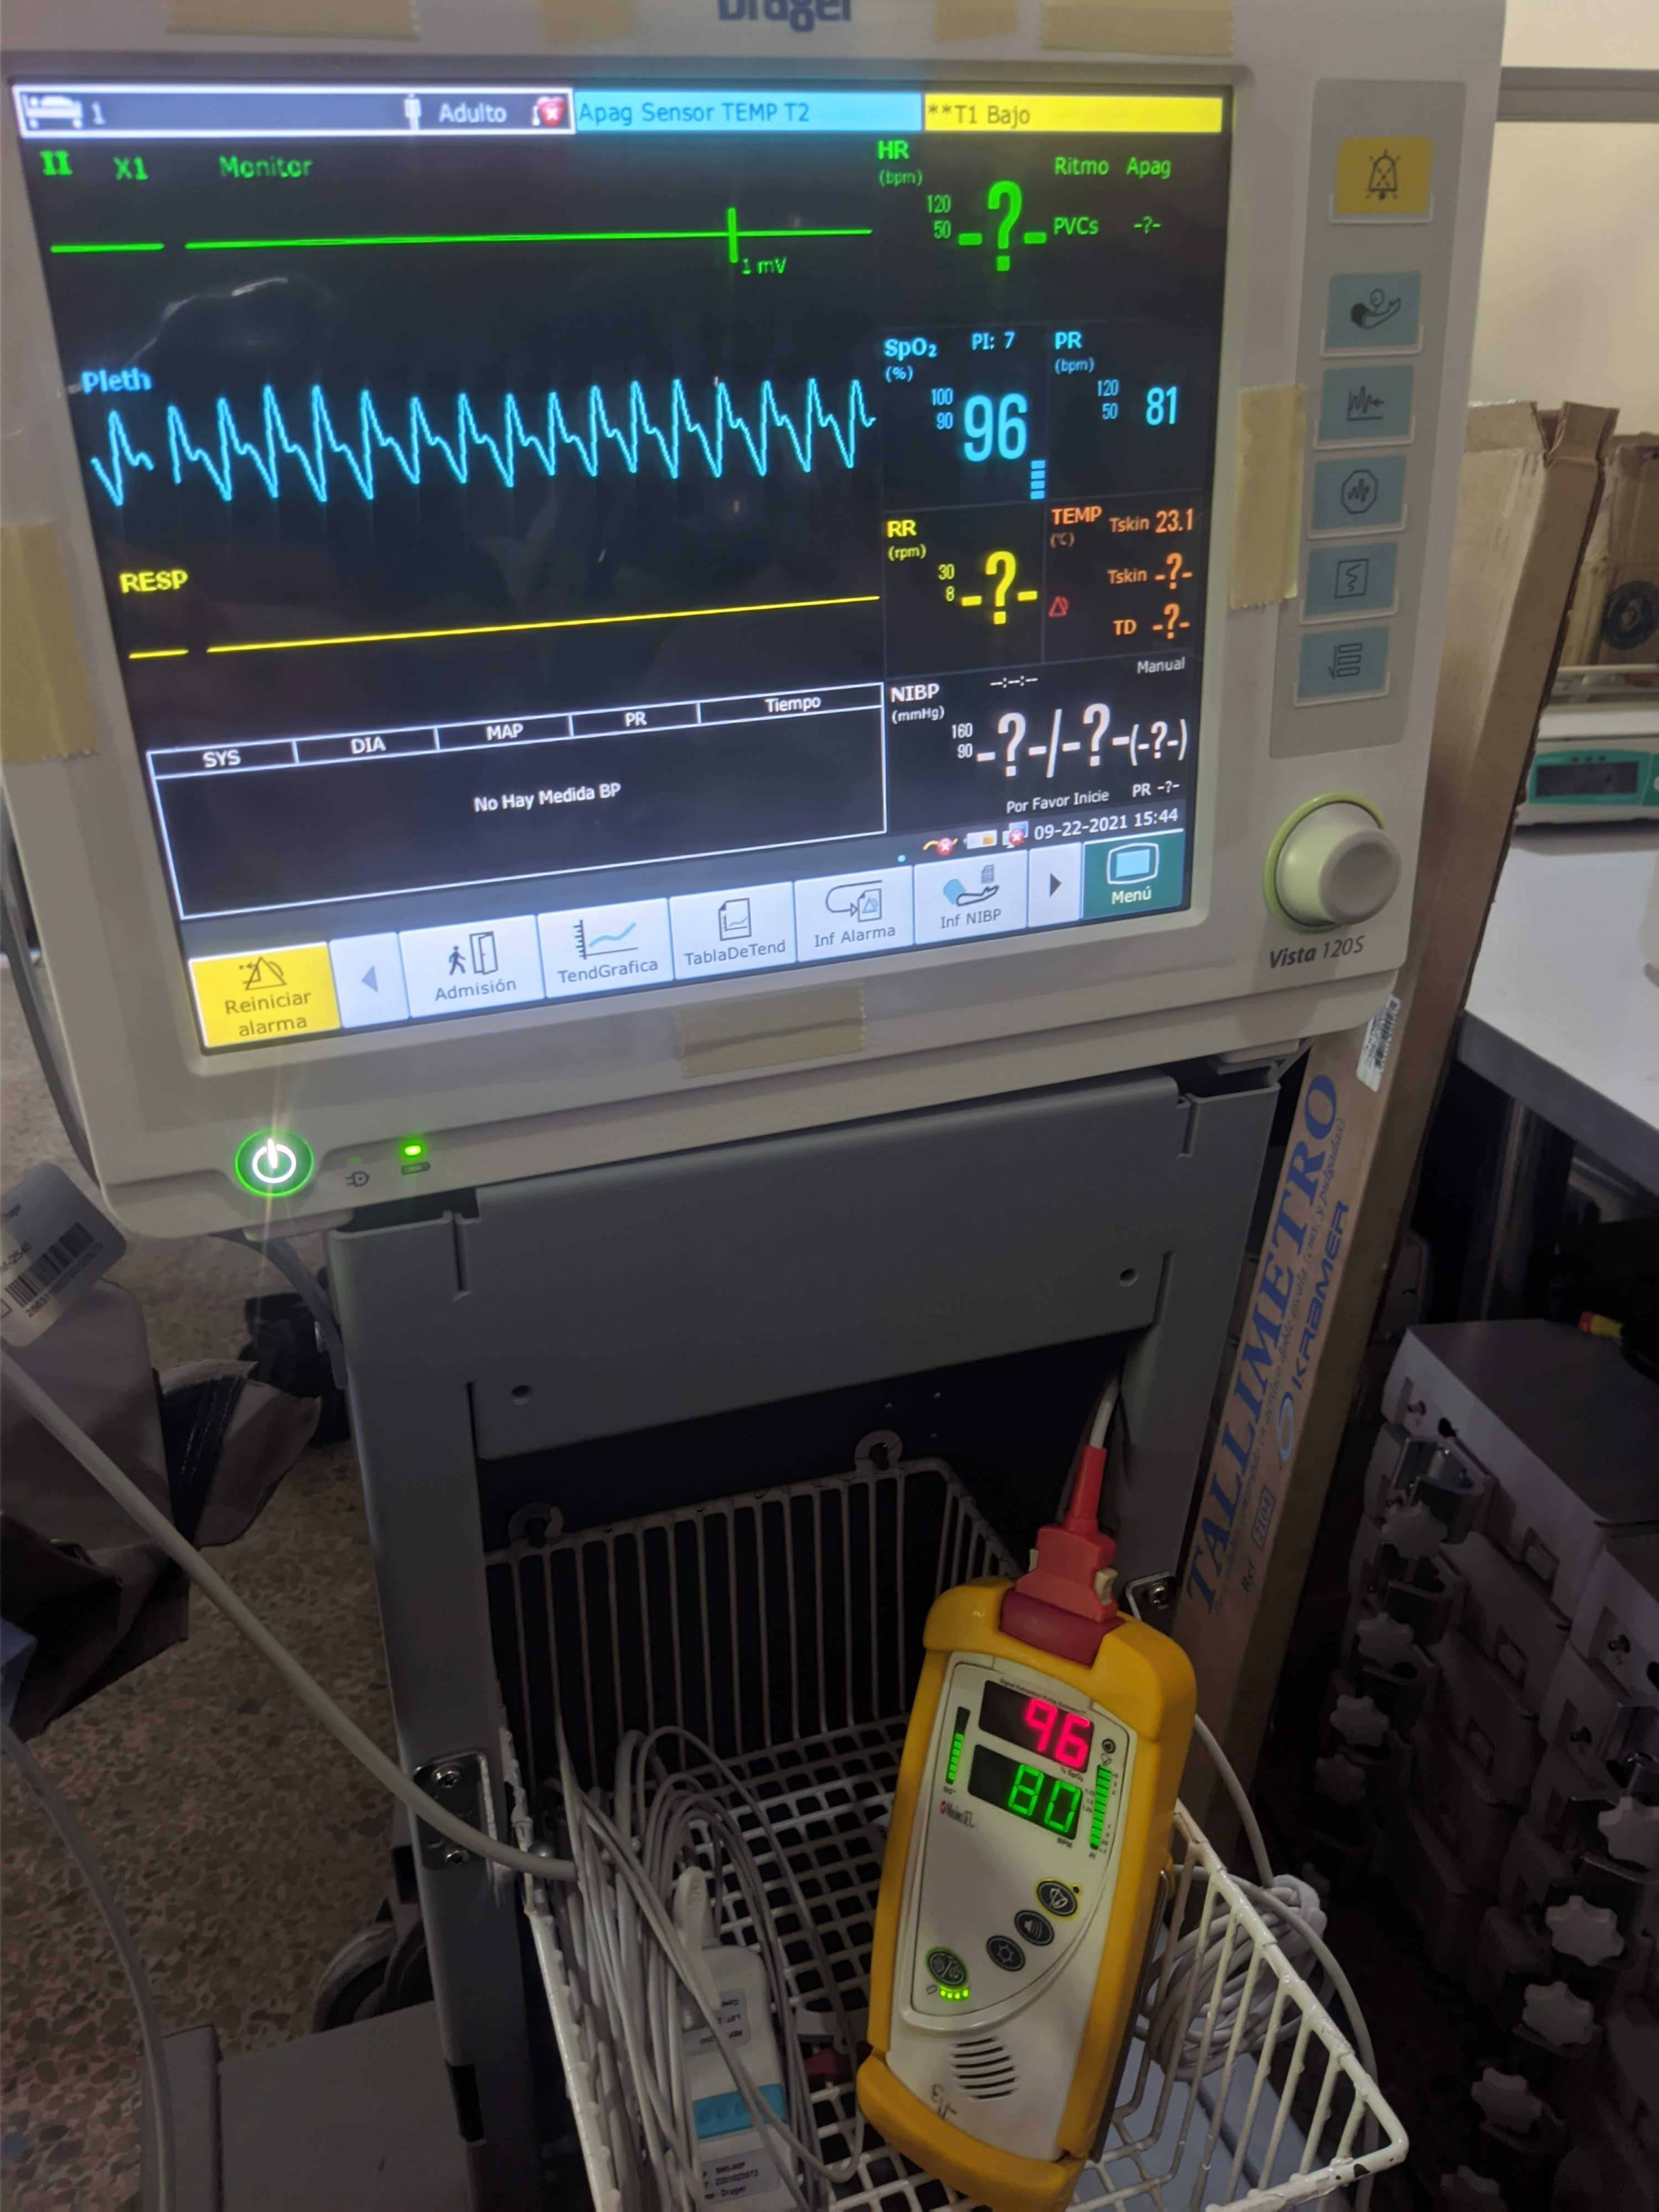

Adulto Apag Sensor TEMP T2 **T1 Bajo

HR (bpm) 120 50 -?- Ritmo Apag PVCs -?-



SpO2 (%) 100 90 96
PI: 7
PR (bpm) 120 50 81
RR (rpm) 30 8 -?
TEMP (°C) Tskin 23.1 Tskin -?- TD -?-

RESP

SYS	DIA	MAP	PR	Tiempo
No Hay Medida BP				

NIBP (mmHg) 160 90 -?/-?/-?-(?)-
Por Favor Inicie PR -?-
09-22-2021 15:44

Reiniciar alarma Admisión TendGrafica TablaDeTend Inf Alarma Inf NIBP Menú

Vista 120S





II X1 Monitor

Adulto Apag Sensor TEMP T2

**T1 Bajo

HR (bpm) 120 50 96
Ritmo Apag
PVCs -?-
PR (bpm) 120 50 83



SpO2 (%) 100 90 96
PI: 7
PR (bpm) 120 50 83



RR (rpm) 30 8 -?
TEMP (°C) Tskin 23.1
Tskin -?-
TD -?-

SYS	DIA	MAP	PR	Tiempo
No Hay Medida BP				

NIBP (mmHg) 160 90 -?/-?/-?
Manual
Por Favor Inicie PR -?-
09-22-2021 15:44

- Reiniciar alarma
- Admisión
- TendGrafica
- TablaDeTend
- Inf Alarma
- Inf NIBP
- Menú

Vista 1205



