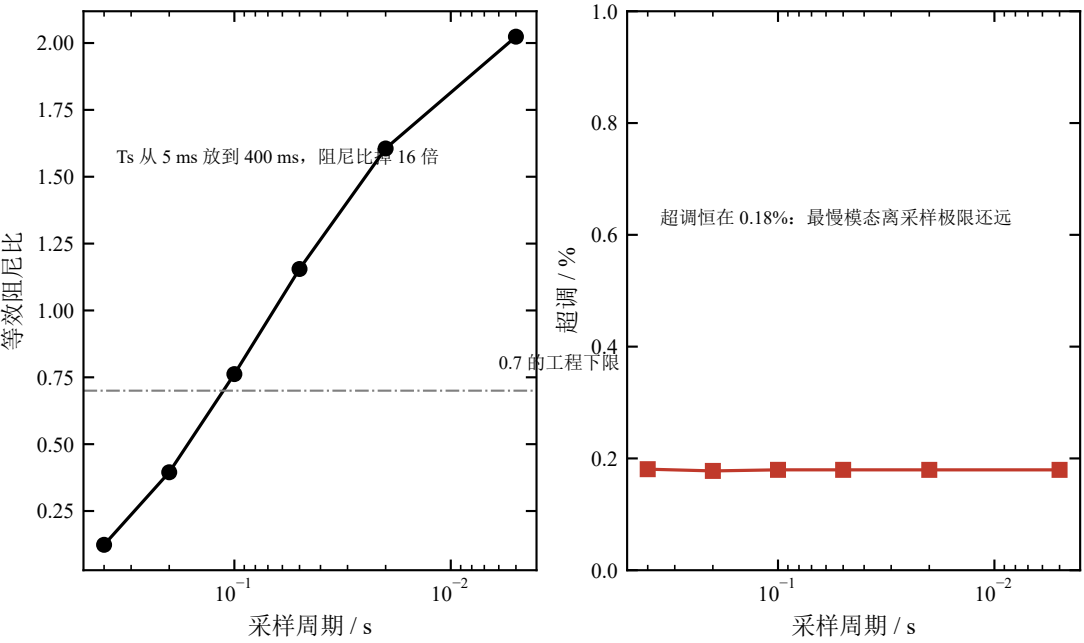
等效阻尼比
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
Ts 从 5 ms 放到 400 ms，阻尼比降 16 倍
0.7 的工程下限
10^{-1}
10^{-2}
采样周期 / s
超调 / %
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
超调恒在 0.18%：最慢模态离采样极限还远
10^{-1}
10^{-2}
采样周期 / s