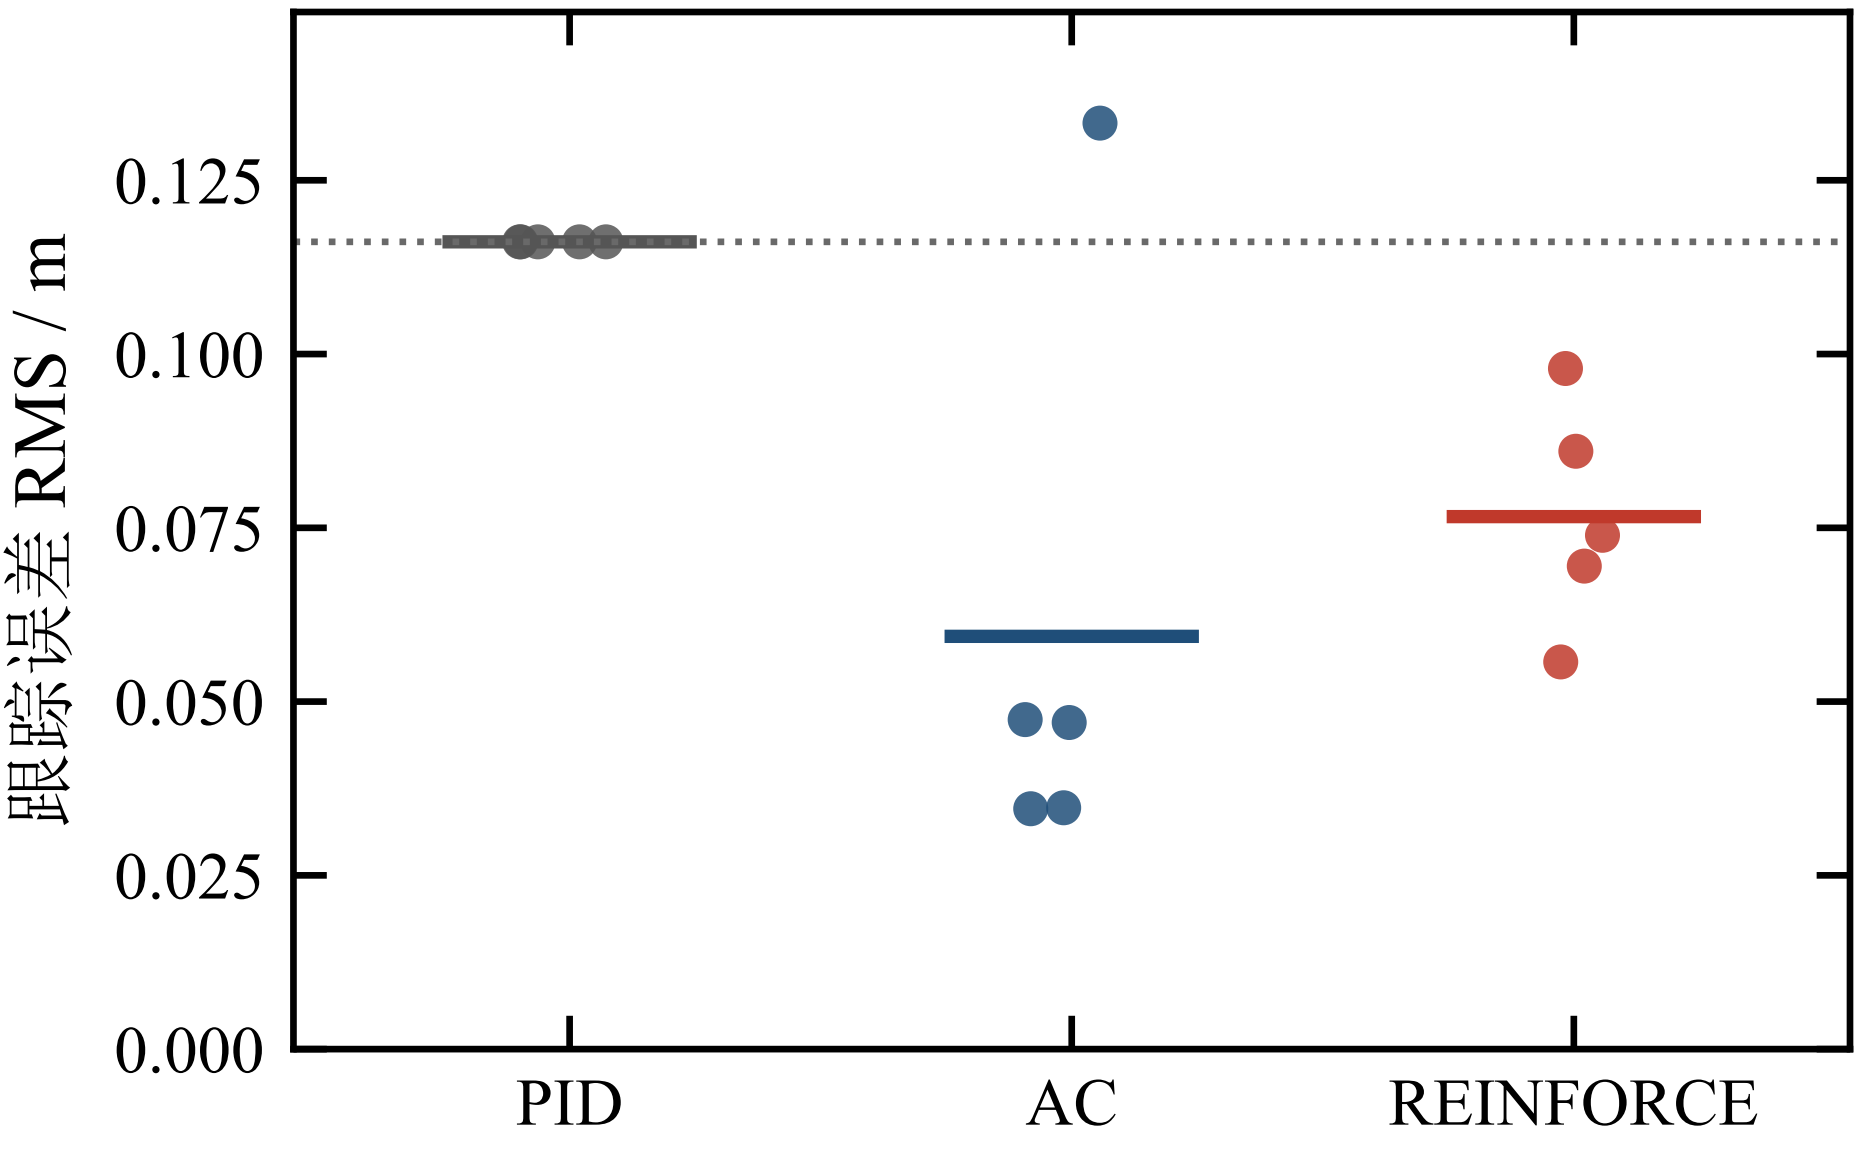
跟踪误差 RMS / m
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
PID
AC
REINFORCE