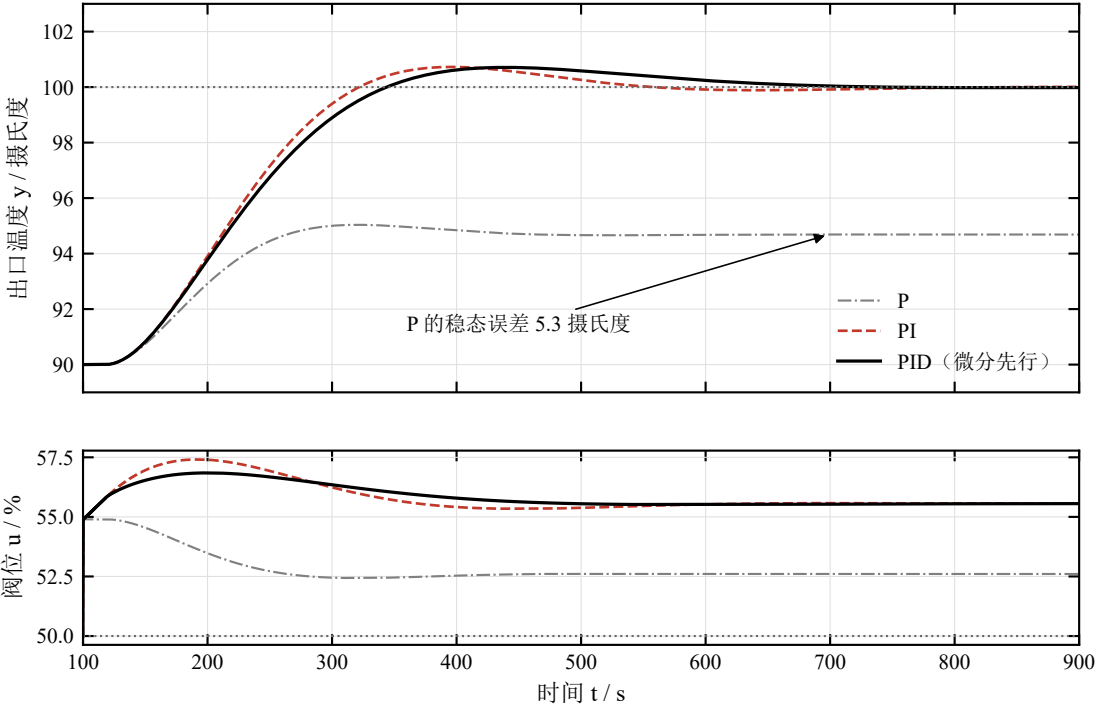
出口温度 y / 摄氏度
102
100
98
96
94
92
90
P 的稳态误差 5.3 摄氏度
P
PI
PID（微分先行）
阀位 u / %
57.5
55.0
52.5
50.0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
时间 t / s