

Fecha: 29/07/25

Orden de Servicio No: 01203

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1 TIJUANA BAJA CALIFORNIA

Equipo: ELECTROENCEFALOGRAFO

Serie:

T5160706M

Marca: NATUS/NICOLET/VIASYS HEALTHCARE/CAREFUSION

Inventario:

Modelo: NICOLET ONE

Ubicación:

☐ Mantenimiento Correctivo

☒ Mantenimiento Preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro _____

SERVICIO REALIZADO:


PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO

1. REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
2. PRUEBA DE RUIDO EN CAJA DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS.
3. PRUEBA DE LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA.
4. REVISIÓN DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
5. AJUSTE DEL SONIDO DE ESTIMULACIÓN.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL:
 - PC, TECLADOS, MOUSE, PANTALLA, IMPRESIÓN, LÁMPARA DE PIE.
 - CD-ROM, FLOPPY, DISCO DURO, BATERÍAS DE RESPALDO, Y MANEJO DE FECHA.
7. REVISIÓN DEPURACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
8. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCESORIOS (GORRO CON ELECTRODOS, CABLE DE PACIENTE, ETC. CONDICIONES ÓPTIMAS PARA USO).
9. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (CORRIENTES DE FUGA, IMPEDANCIA DE CABLES, ETC).
10. LIMPIEZA GENERAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO.

Esta orden de Servicio no procede a pago ya que se encuentra en la orden de Servicio 01202 ya que el equipo se encuentra en garantía.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
• H.G.R. No.1

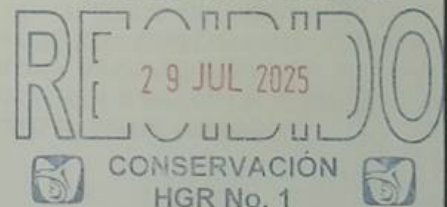

Equipo Funciona: Si ☒ No ☐

CONTRATO NO.050GYR019N09125-013-00

FIRMAS

Ingeniero Especialista

Usuario y/o Responsables de Servicio

Jefe Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

Recibe de conformidad

Recibe de conformidad