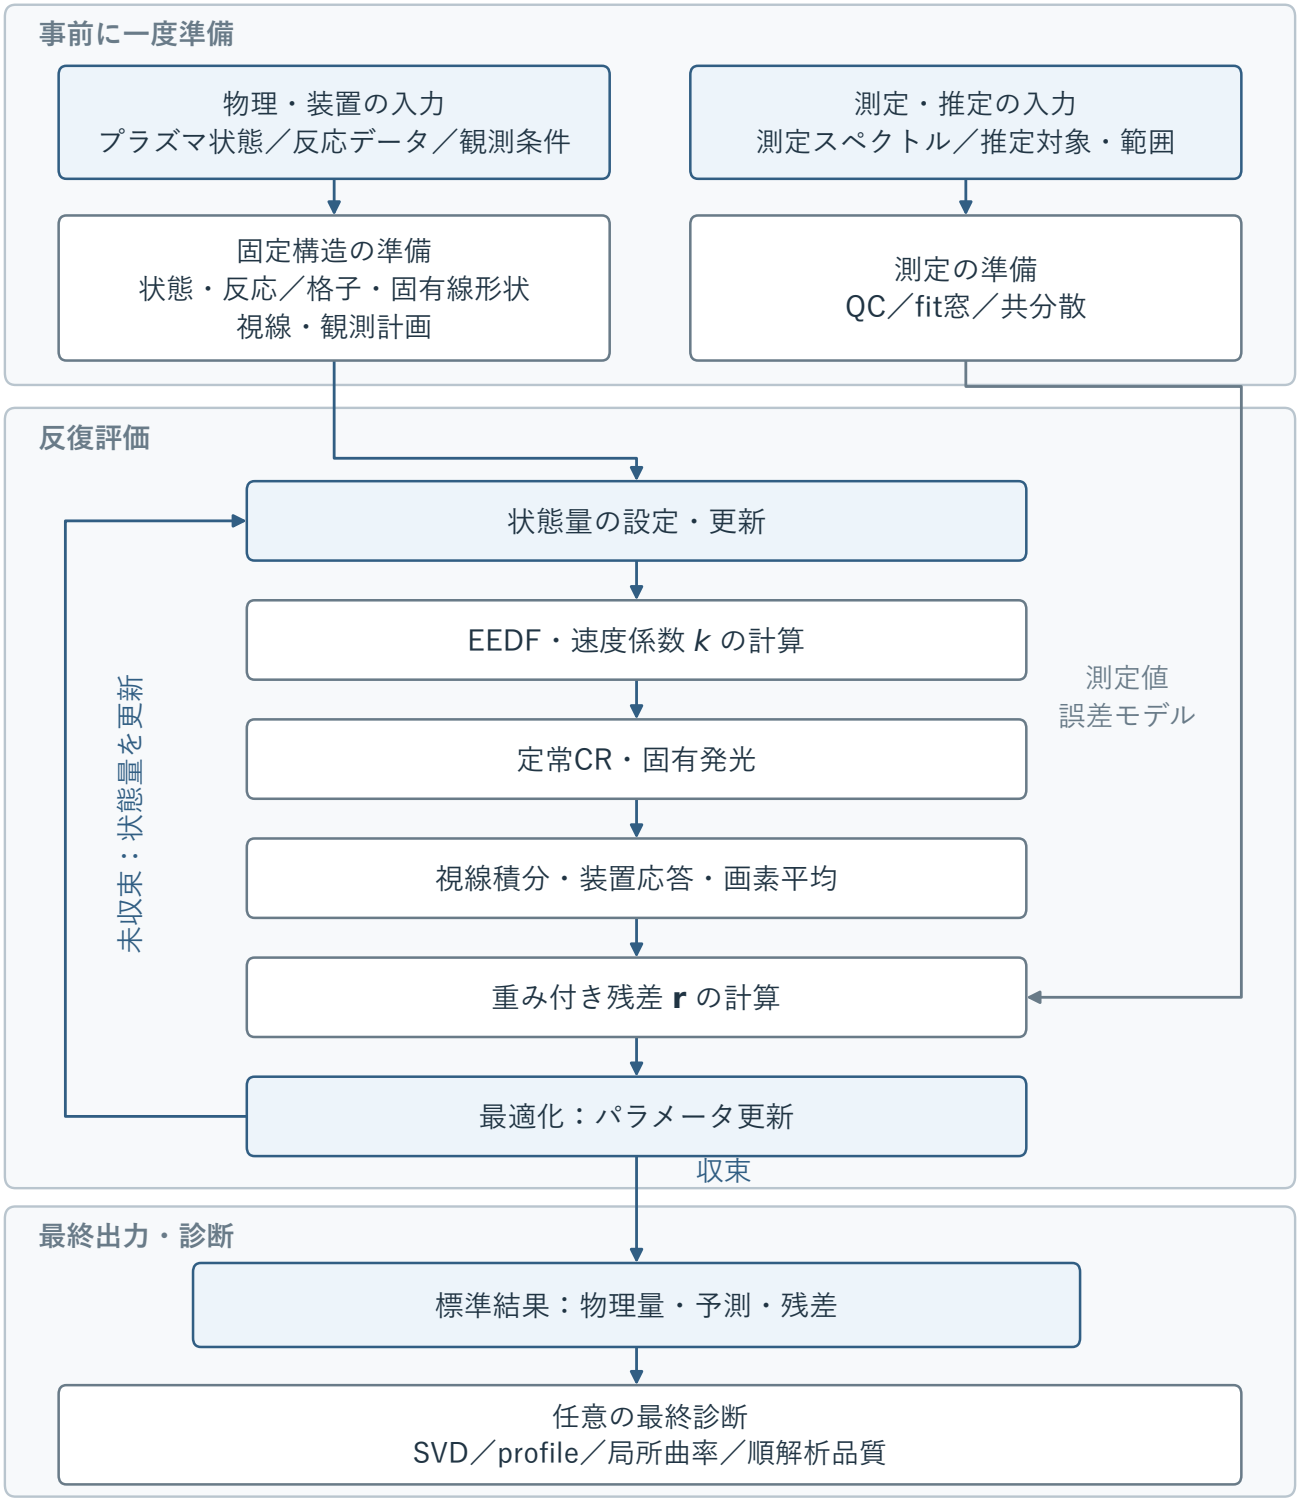

事前に一度準備
物理・装置の入力
プラズマ状態／反応データ／観測条件
測定・推定の入力
測定スペクトル／推定対象・範囲
固定構造の準備
状態・反応／格子・固有線形状
視線・観測計画
測定の準備
QC／fit窓／共分散
反復評価
状態量の設定・更新
EEDF・速度係数 k の計算
定常CR・固有発光
視線積分・装置応答・画素平均
重み付き残差 r の計算
最適化：パラメータ更新
未収束：状態量を更新
測定値
誤差モデル
収束
最終出力・診断
標準結果：物理量・予測・残差
任意の最終診断
SVD／profile／局所曲率／順解析品質