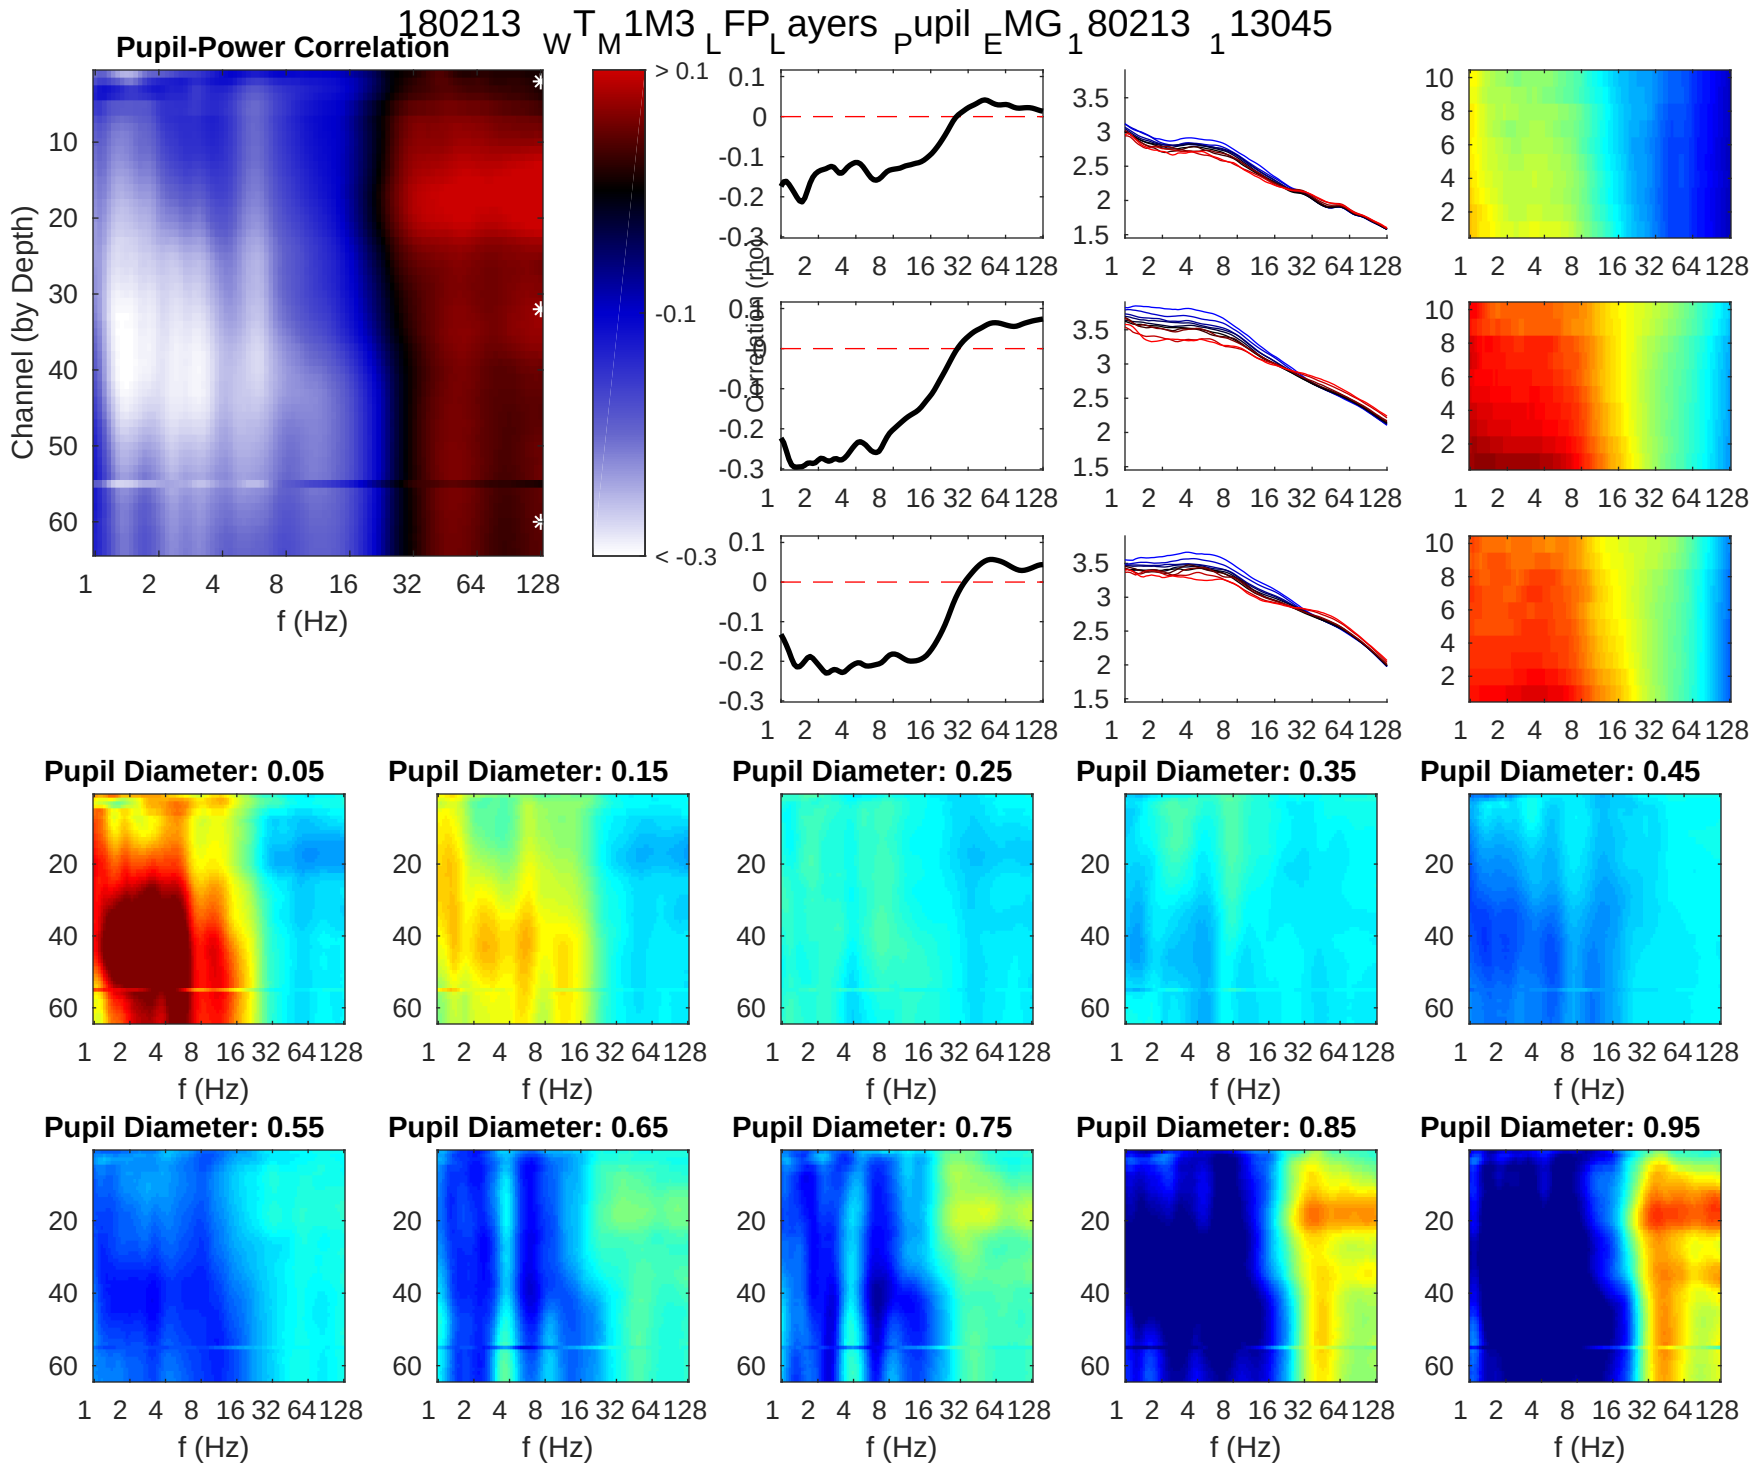
180213 WTM1M3 LFPLayers Pupil EMG 180213 113045
Pupil-Power Correlation
Channel (by Depth)
f (Hz)
> 0.1
-0.1
< -0.3
Correlation (rho)
Pupil Diameter: 0.05
Pupil Diameter: 0.15
Pupil Diameter: 0.25
Pupil Diameter: 0.35
Pupil Diameter: 0.45
Pupil Diameter: 0.55
Pupil Diameter: 0.65
Pupil Diameter: 0.75
Pupil Diameter: 0.85
Pupil Diameter: 0.95