Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1969
CALIBRATION DATE: 30-May-01

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 605

COEFFICIENTS:

PA0 =	2.593951e-001	PTCA0 =	-1.997057e+002
PA1 =	7.112125e-002	PTCA1 =	1.829565e-001
PA2 =	-2.790964e-009	PTCA2 =	-4.541725e-004
		PTCB0 =	2.400150e+001
		PTCB1 =	-1.700000e-003
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.70	6.5	21.0	14.67	-0.00
314.73	4218.9	21.0	314.20	-0.04
614.67	8432.7	21.0	613.74	-0.06
914.60	12648.2	21.0	913.30	-0.09
1214.66	16864.7	21.0	1212.83	-0.13
1514.70	21083.6	21.0	1512.43	-0.16
1514.70	21083.6	21.0	1512.43	-0.16
1214.69	16865.7	21.0	1212.90	-0.12
914.59	12648.0	21.0	913.28	-0.09
614.65	8432.5	21.0	613.73	-0.06
314.73	4218.7	21.0	314.19	-0.04
14.69	7.8	21.0	14.76	0.00

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	28.00	-5.00	24.01
29.00	28.00	35.00	23.94
24.00	27.30		
18.50	26.10		
15.00	25.00		
4.50	23.80		
1.00	23.00		

n = instrument output - (PTCA1 * t - PTCA2 * t^2)
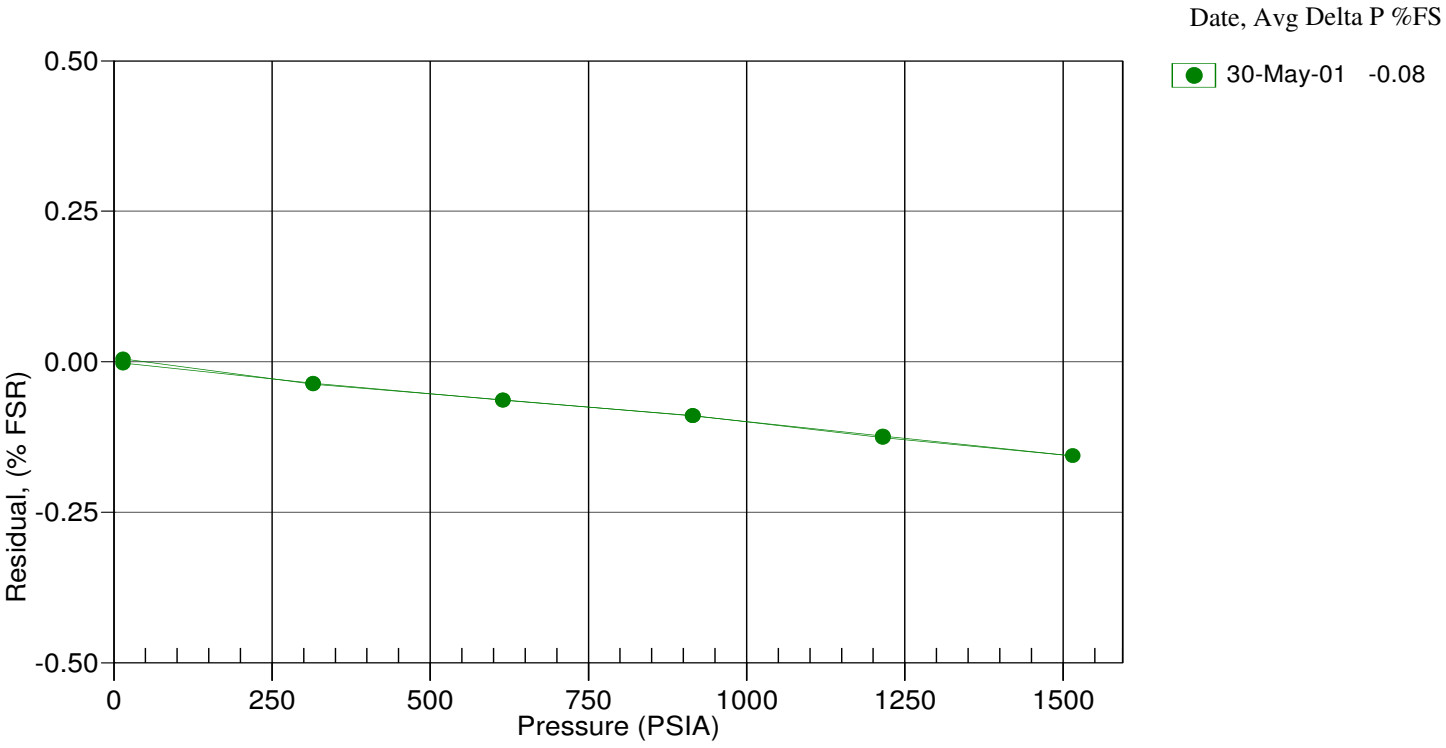
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2