Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1970
CALIBRATION DATE: 30-May-01

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 607

COEFFICIENTS:

PA0 =	1.369415e-001	PTCA0 =	-1.977507e+002
PA1 =	6.857357e-002	PTCA1 =	1.703261e-001
PA2 =	-2.466263e-009	PTCA2 =	-3.582513e-003
		PTCB0 =	2.491187e+001
		PTCB1 =	-2.500000e-005
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.70	16.4	21.0	14.68	-0.00
314.73	4391.7	21.0	314.66	-0.00
614.67	8768.5	21.0	614.65	-0.00
914.60	13146.7	21.0	914.64	0.00
1214.66	17526.4	21.0	1214.63	-0.00
1514.70	21907.8	21.0	1514.65	-0.00
1514.70	21907.8	21.0	1514.65	-0.00
1214.69	17526.7	21.0	1214.65	-0.00
914.59	13146.5	21.0	914.62	0.00
614.65	8768.1	21.0	614.62	-0.00
314.73	4391.5	21.0	314.65	-0.01
14.69	17.8	21.0	14.78	0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	25.50	-5.00	24.91
29.00	26.10	35.00	24.91
24.00	26.20		
18.50	25.90		
15.00	25.40		
4.50	24.80		
1.00	24.10		

n = instrument output - (PTCA1 * t - PTCA2 * t^2)
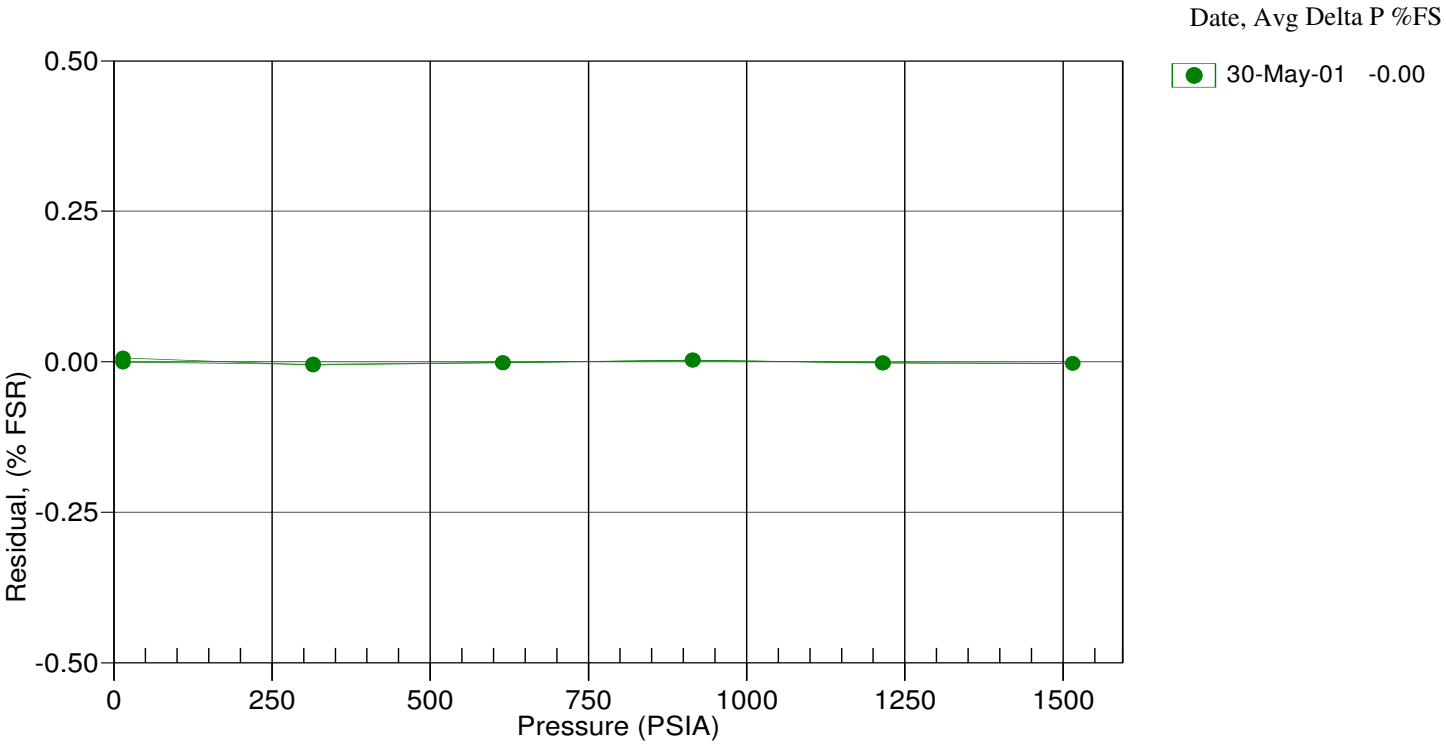
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2