# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 1971
CALIBRATION DATE: 30-May-01

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 608

COEFFICIENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PA0 = | 1.580215e-001 | PTCA0 = | -1.986124e+002 |
| PA1 = | 6.819380e-002 | PTCA1 = | 1.041860e-001 |
| PA2 = | -2.553632e-009 | PTCA2 = | 2.941593e-004 |
| | | PTCB0 = | 2.503200e+001 |
| | | PTCB1 = | 2.000000e-004 |
| | | PTCB2 = | 0.000000e+000 |

PRESSURE SPAN CALIBRATION

| PRESSURE PSIA | INST OUTPUT | TEMP ITS90 | COMPUTED PRESSURE | ERROR %FS |
|---|---|---|---|---|
| 14.70 | 17.3 | 21.0 | 14.72 | 0.00 |
| 314.73 | 4417.4 | 21.0 | 314.73 | 0.00 |
| 614.67 | 8819.6 | 21.0 | 614.78 | 0.01 |
| 914.60 | 13223.3 | 21.0 | 914.83 | 0.02 |
| 1214.66 | 17628.3 | 21.0 | 1214.87 | 0.01 |
| 1514.70 | 22035.0 | 21.0 | 1514.93 | 0.02 |
| 1514.70 | 22035.0 | 21.0 | 1514.93 | 0.02 |
| 1214.69 | 17628.5 | 21.0 | 1214.89 | 0.01 |
| 914.59 | 13222.6 | 21.0 | 914.78 | 0.01 |
| 614.65 | 8818.7 | 21.0 | 614.72 | 0.00 |
| 314.73 | 4416.8 | 21.0 | 314.69 | -0.00 |
| 14.69 | 17.8 | 21.0 | 14.76 | 0.00 |

THERMAL CORRECTION

| TEMP ITS90 | INST OUTPUT | TEMP ITS90 | SPAN MV |
|---|---|---|---|
| 32.50 | 26.00 | -5.00 | 25.03 |
| 29.00 | 26.20 | 35.00 | 25.04 |
| 24.00 | 25.70 | | |
| 18.50 | 24.70 | | |
| 15.00 | 23.80 | | |
| 4.50 | 23.20 | | |
| 1.00 | 22.80 | | |

n = instrument output - (PTCA1 * t - PTCA2 * $t^2$)
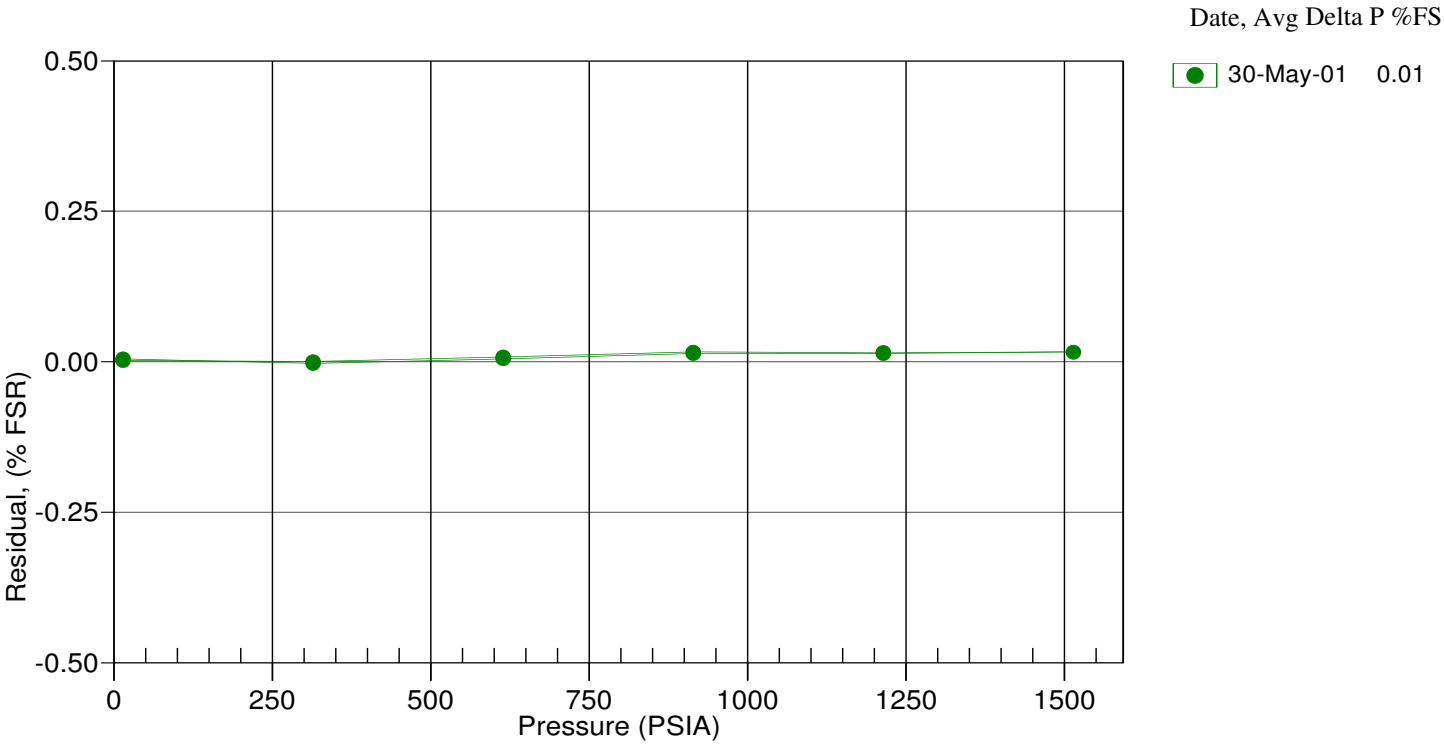
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * $n^2$