Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1970
CALIBRATION DATE: 04-Jun-01

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999892e-001
rtca1 = 1.686136e-006
rtca2 = -3.022765e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999910	0.9999909	-0.1
4.4999	0.9999960	0.9999962	0.2
14.9999	1.0000080	1.0000077	-0.3
18.4999	1.0000100	1.0000101	0.1
23.9999	1.0000120	1.0000123	0.3
29.0001	1.0000130	1.0000127	-0.3
32.5000	1.0000120	1.0000121	0.1

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2
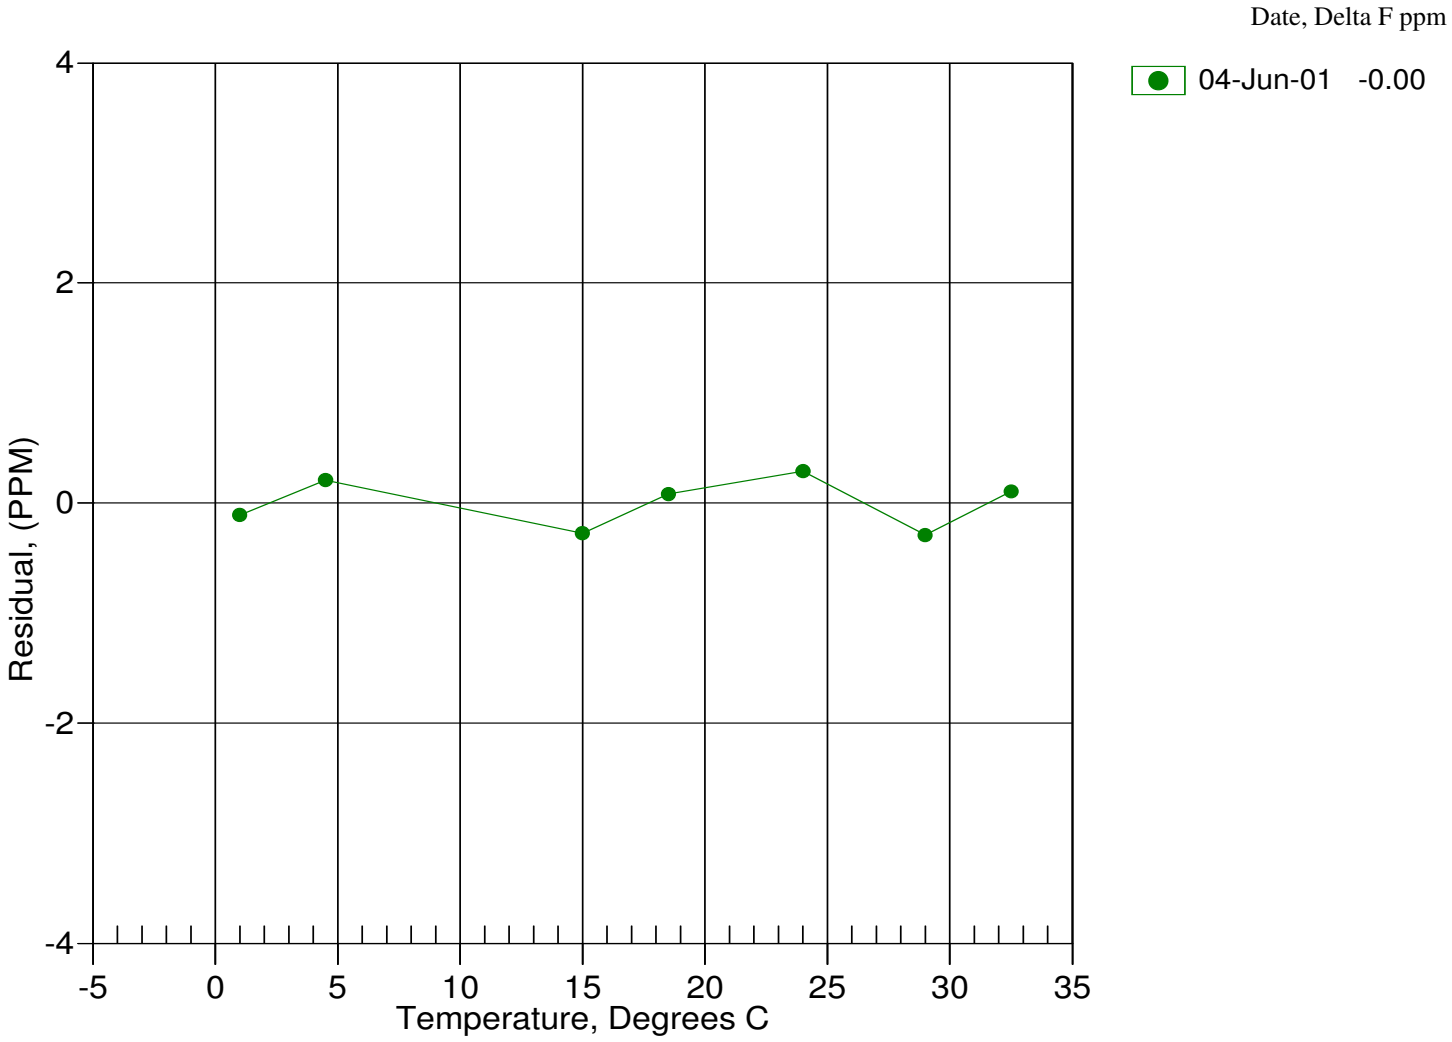
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6