Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1971
CALIBRATION DATE: 04-Jun-01

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 7.509862e-005
a1 = 2.581082e-004
a2 = -1.174138e-006
a3 = 1.262395e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	708649.3	1.0000	-0.0000
4.4999	606239.6	4.5000	0.0001
14.9999	386928.1	14.9999	-0.0000
18.4999	335175.7	18.4999	-0.0000
23.9999	269038.5	23.9999	0.0000
29.0001	221624.7	29.0001	0.0000
32.5000	194131.5	32.5000	-0.0000

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
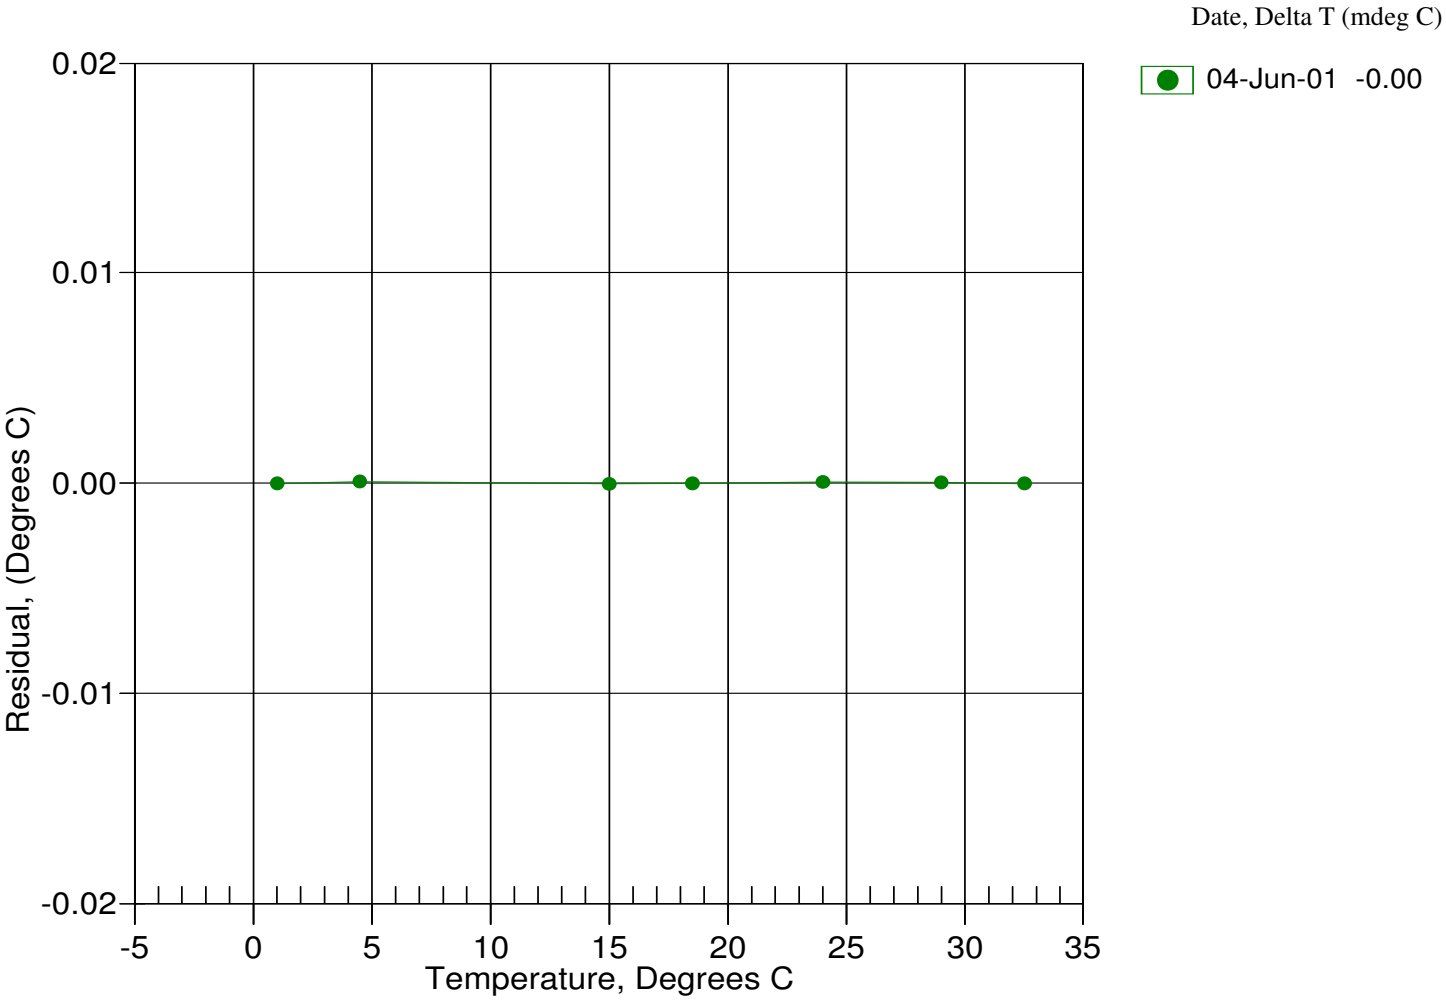
Residual = instrument temperature - bath temperature