Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1623
CALIBRATION DATE: 11-Aug-00

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.957163e-001
h =  1.496113e-001
i = -2.560187e-004
j =  4.540690e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -3.5484e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2582.99	0.00000	0.00000
1.0001	35.1968	3.00537	5173.31	3.00540	0.00003
4.5002	35.1964	3.31704	5370.26	3.31702	-0.00002
15.0000	35.1940	4.31301	5955.35	4.31297	-0.00003
18.5001	35.1932	4.66294	6147.42	4.66293	-0.00001
24.0001	35.1919	5.22828	6445.31	5.22831	0.00002
29.0000	35.1905	5.75666	6711.41	5.75672	0.00006
32.5002	35.1888	6.13357	6894.68	6.13352	-0.00005

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;
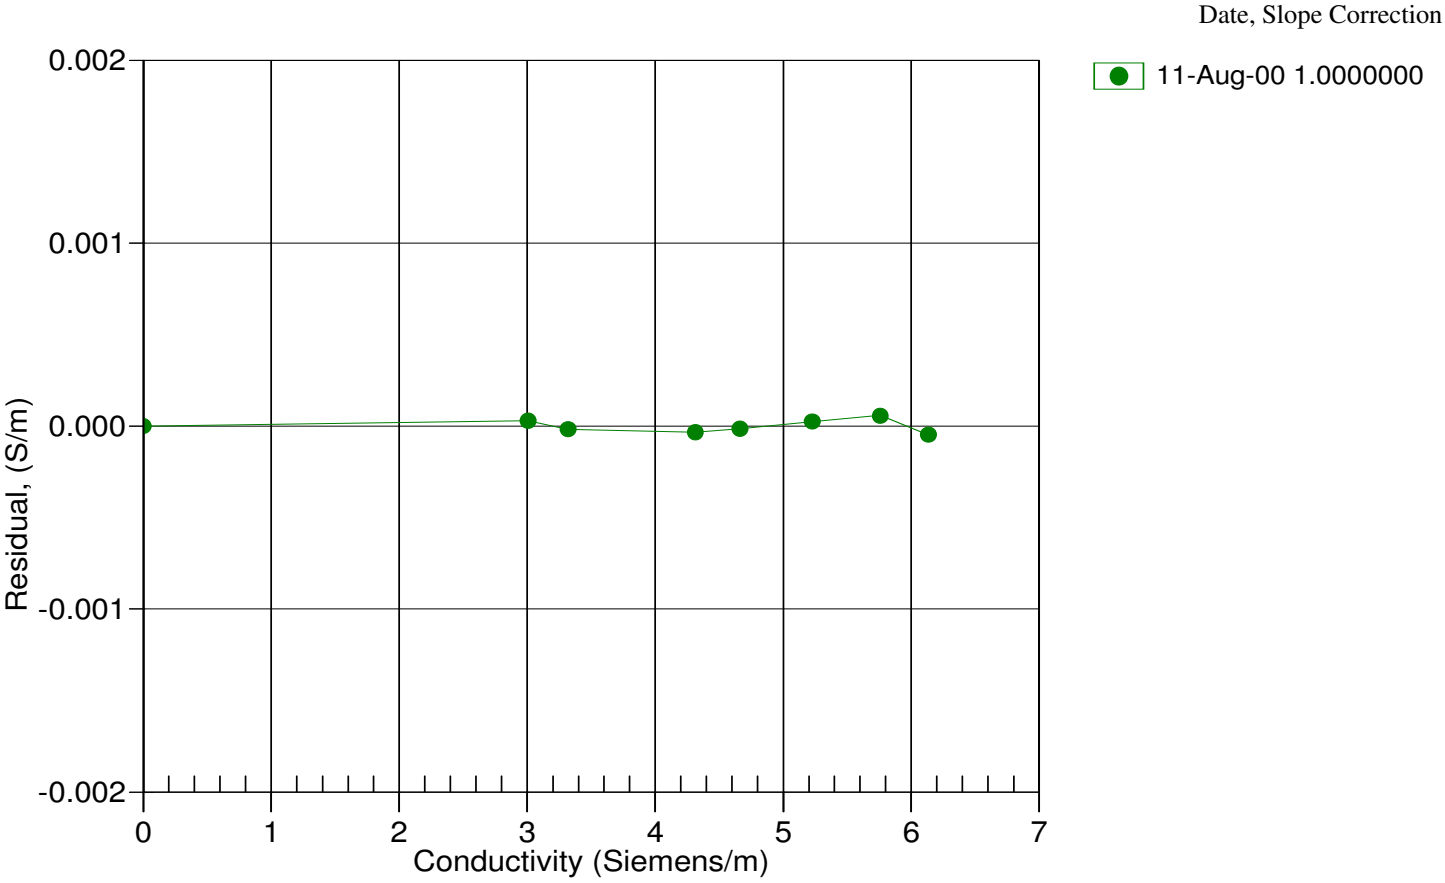
Residual = instrument conductivity - bath conductivity