Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1174
CALIBRATION DATE: 20-Jul-00

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
3000 psia S/N 193151

COEFFICIENTS:

PA0 =	-5.895389e+000	PTCA0 =	0.000000e+000
PA1 =	1.398396e-001	PTCA1 =	7.923638e-001
PA2 =	-1.102623e-008	PTCA2 =	-4.560351e-003
		PTCB0 =	0.000000e+000
		PTCB1 =	0.000000e+000
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.70	157.7	23.0	13.95	-0.03
614.56	4451.7	23.0	614.20	-0.01
1214.40	8739.5	23.0	1213.18	-0.04
1814.11	13033.2	23.0	1812.58	-0.05
2413.73	17335.1	23.0	2412.72	-0.03
3013.56	21645.6	23.0	3013.65	0.00
3013.56	21645.6	23.0	3013.65	0.00
2413.69	17348.3	23.0	2414.56	0.03
1813.99	13052.1	23.0	1815.22	0.04
1214.34	8756.6	23.0	1215.57	0.04
614.46	4460.1	23.0	615.37	0.03
14.66	166.0	23.0	15.11	0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	171.60		
29.00	169.80		
24.00	167.10		
18.50	163.80		
15.00	161.50		
4.50	154.10		
1.00	151.50		

n = instrument output - (PTCA1 * t - PTCA2 * t^2)
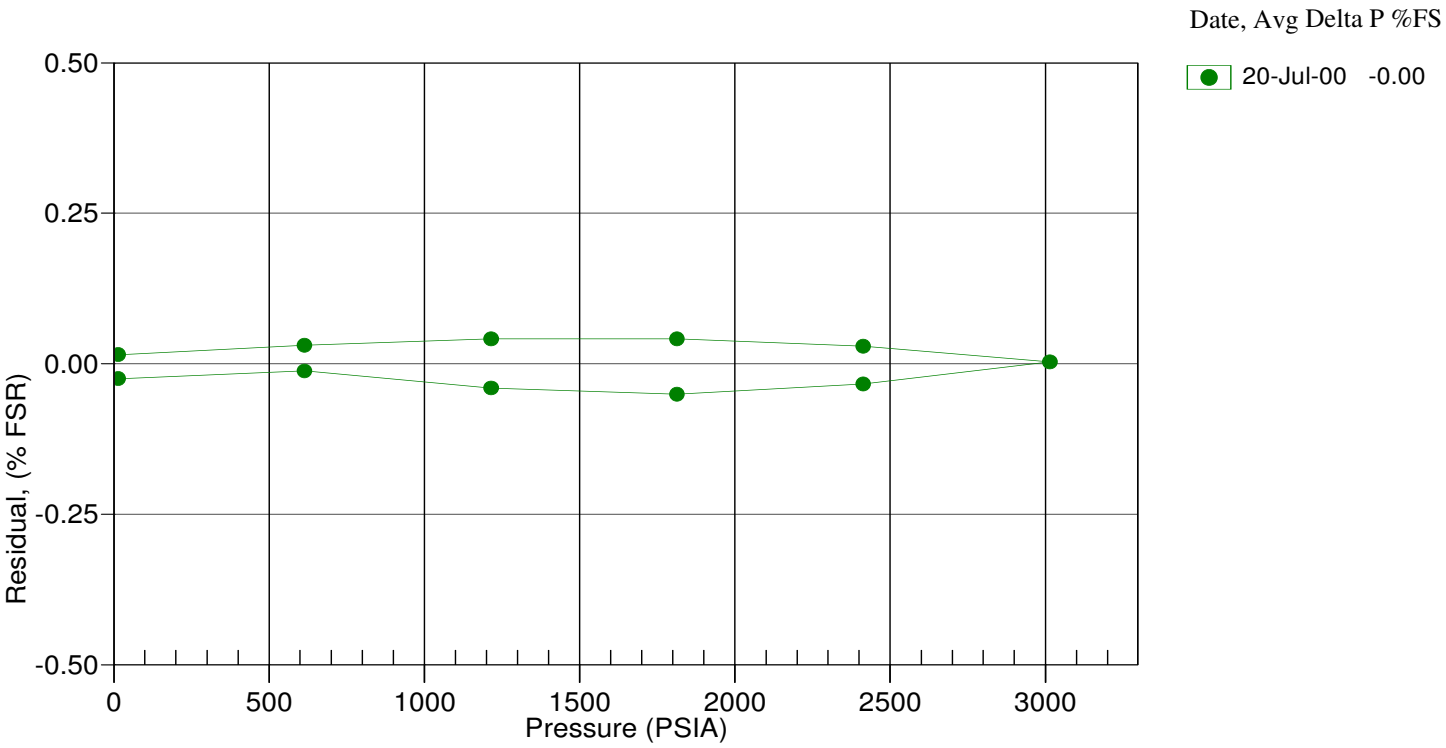
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2