Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1623
CALIBRATION DATE: 07-Aug-00

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1500 psia S/N 195324

COEFFICIENTS:

PA0 =	5.298842e-001	PTCA0 =	5.891736e+001
PA1 =	6.010062e-002	PTCA1 =	3.704993e-001
PA2 =	2.412729e-008	PTCA2 =	1.378897e-003
		PTCB0 =	3.004000e+001
		PTCB1 =	2.666667e-004
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.70	299.1	22.0	14.44	-0.02
314.82	5283.5	22.0	314.66	-0.01
614.64	10226.5	22.0	613.57	-0.07
914.45	15168.5	22.0	913.60	-0.06
1214.44	20096.7	22.0	1213.96	-0.03
1514.33	25010.6	22.0	1514.62	0.02
1514.33	25010.6	22.0	1514.62	0.02
1214.36	20119.5	22.0	1215.35	0.07
914.39	15201.4	22.0	915.60	0.08
614.50	10259.3	22.0	615.56	0.07
314.71	5294.6	22.0	315.33	0.04
14.70	305.9	22.0	14.85	0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	317.20	0.00	30.04
29.00	315.30	30.00	30.05
24.00	313.10		
18.50	310.80		
15.00	309.30		
4.50	305.90		
1.00	303.40		

n = instrument output - (PTCA1 * t - PTCA2 * t^2)
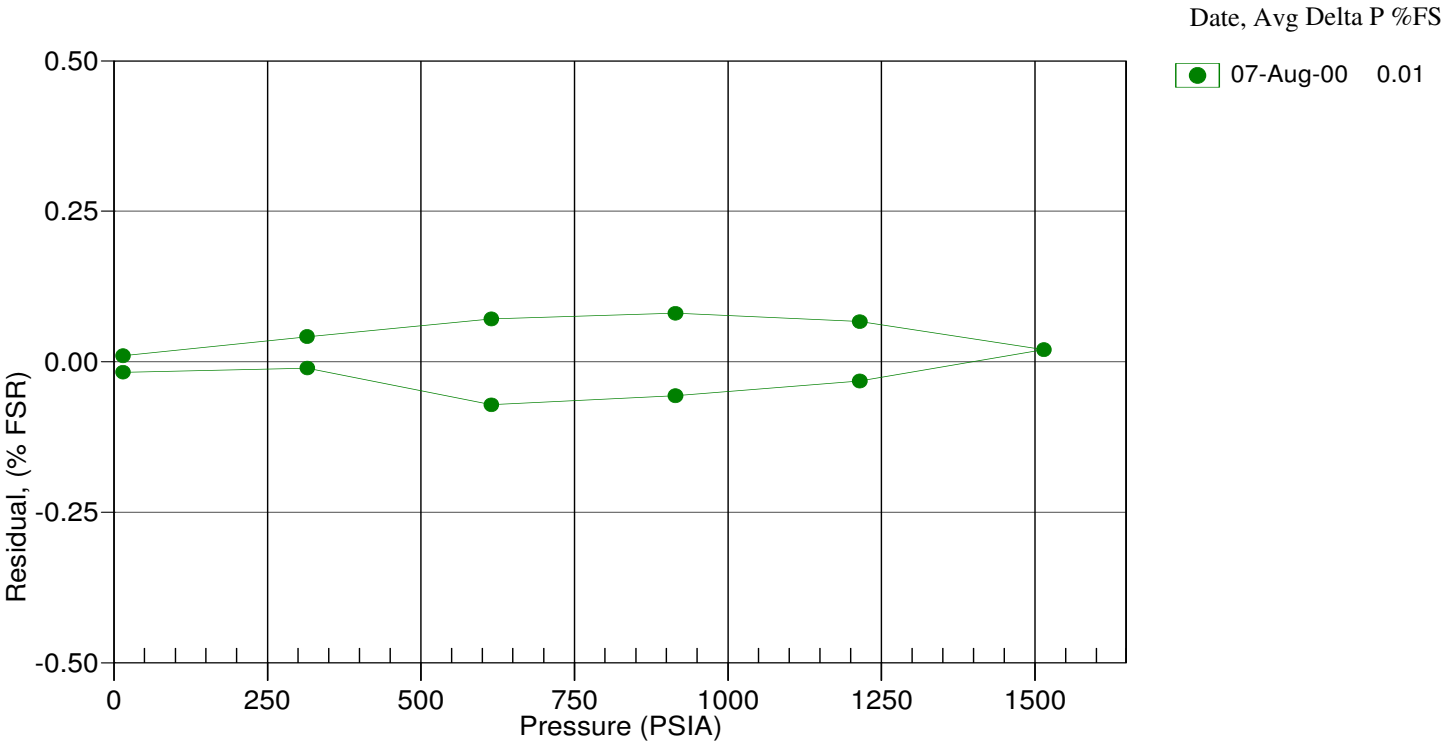
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2