Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1624
CALIBRATION DATE: 25-Sep-00

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1500 psia S/N 195326

COEFFICIENTS:

PA0 =	5.312008e+000	PTCA0 =	1.037774e+001
PA1 =	6.007996e-002	PTCA1 =	2.994289e+000
PA2 =	2.682940e-008	PTCA2 =	3.131165e-002
		PTCB0 =	2.995200e+001
		PTCB1 =	1.900000e-003
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.70	248.1	23.7	14.26	-0.03
314.45	5227.1	23.7	313.65	-0.05
614.17	10180.7	23.7	612.83	-0.09
913.95	15125.9	23.8	912.78	-0.08
1213.87	20059.9	23.7	1213.42	-0.03
1513.71	24966.3	23.8	1513.60	-0.01
1513.71	24966.3	23.8	1513.60	-0.01
1213.81	20079.7	23.8	1214.60	0.05
913.78	15162.6	23.8	915.01	0.08
613.99	10217.8	23.8	615.05	0.07
314.15	5249.0	23.9	314.92	0.05
14.23	257.0	23.8	14.77	0.04

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	299.90	0.00	29.95
29.00	282.20	30.00	30.01
24.00	258.70		
18.50	235.10		
15.00	220.10		
4.50	186.60		
1.00	169.80		

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)
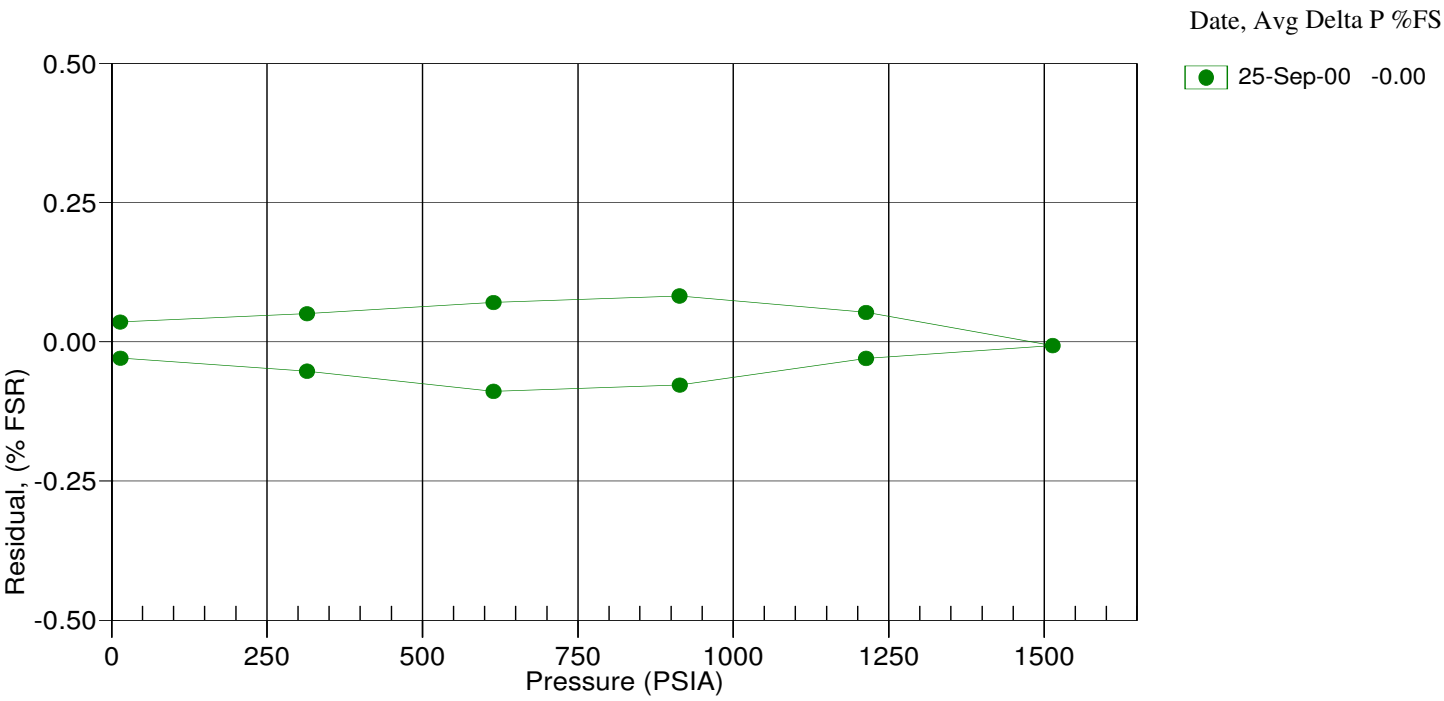
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2