Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1174
CALIBRATION DATE: 28-Jul-00

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999694e-001
rtca1 = 1.746840e-006
rtca2 = -2.861160e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0001	0.9999710	0.9999712	0.2
4.5000	0.9999770	0.9999767	-0.3
15.0000	0.9999890	0.9999892	0.2
18.5001	0.9999920	0.9999920	-0.0
23.9999	0.9999950	0.9999949	-0.1
29.0000	0.9999960	0.9999960	0.0
32.5000	0.9999960	0.9999960	-0.0

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2
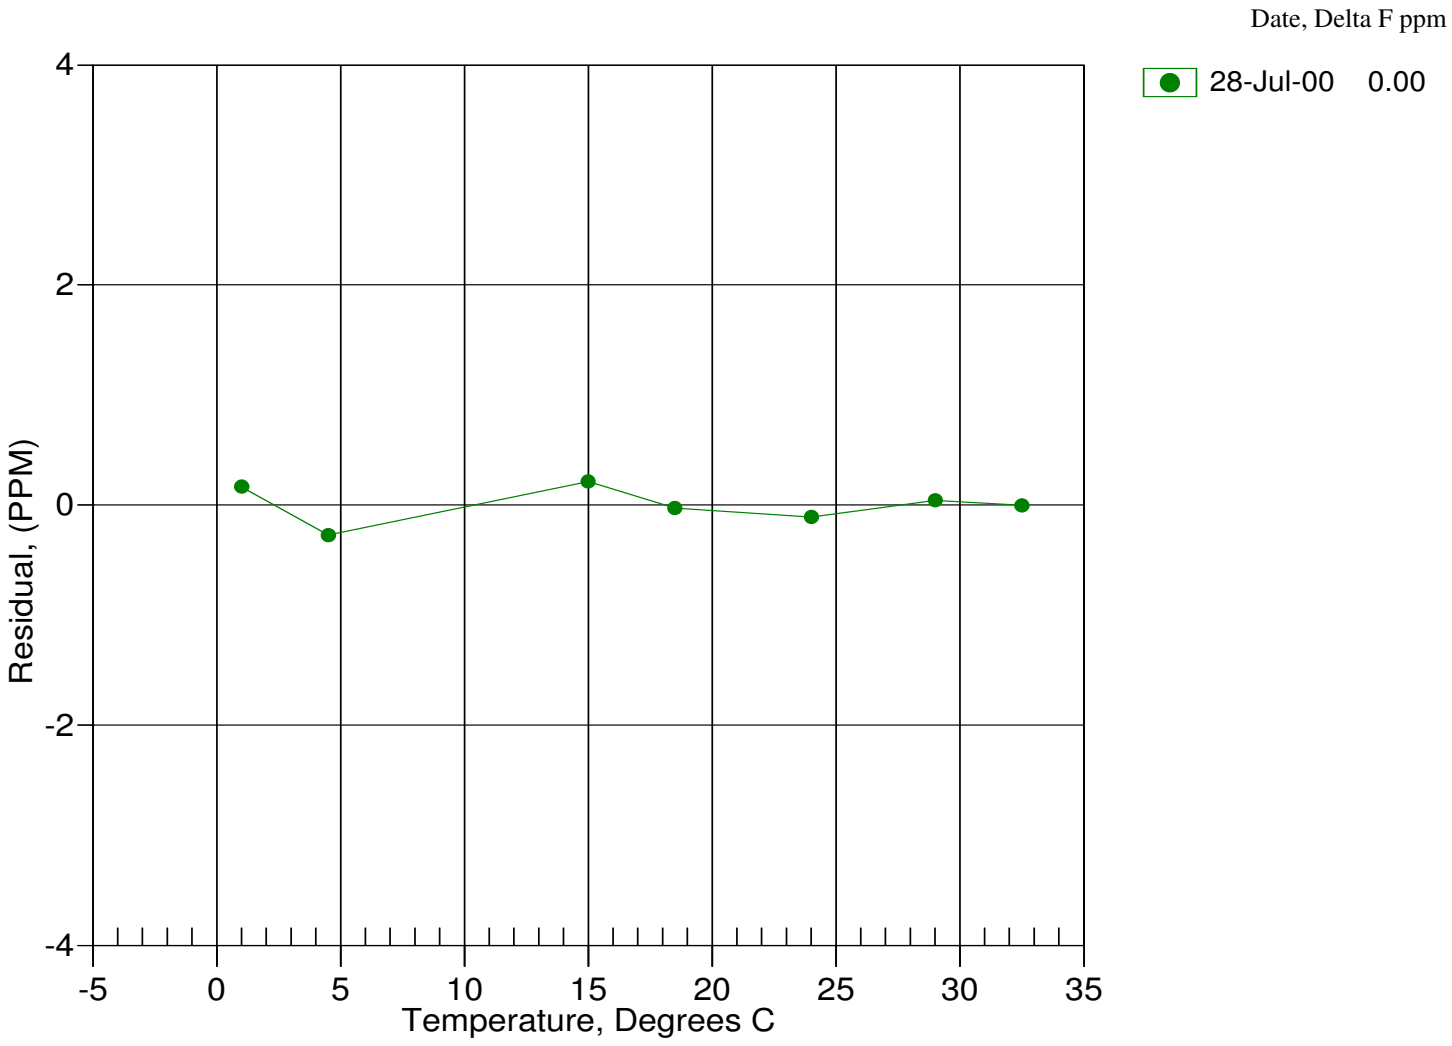
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6