Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1623
CALIBRATION DATE: 11-Aug-00

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999730e-001
rtca1 = 1.789341e-006
rtca2 = -3.482130e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0001	0.9999750	0.9999747	-0.3
4.5002	0.9999800	0.9999803	0.3
15.0000	0.9999920	0.9999920	-0.0
18.5001	0.9999940	0.9999942	0.2
24.0001	0.9999960	0.9999959	-0.1
29.0000	0.9999960	0.9999956	-0.4
32.5002	0.9999940	0.9999944	0.4

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2
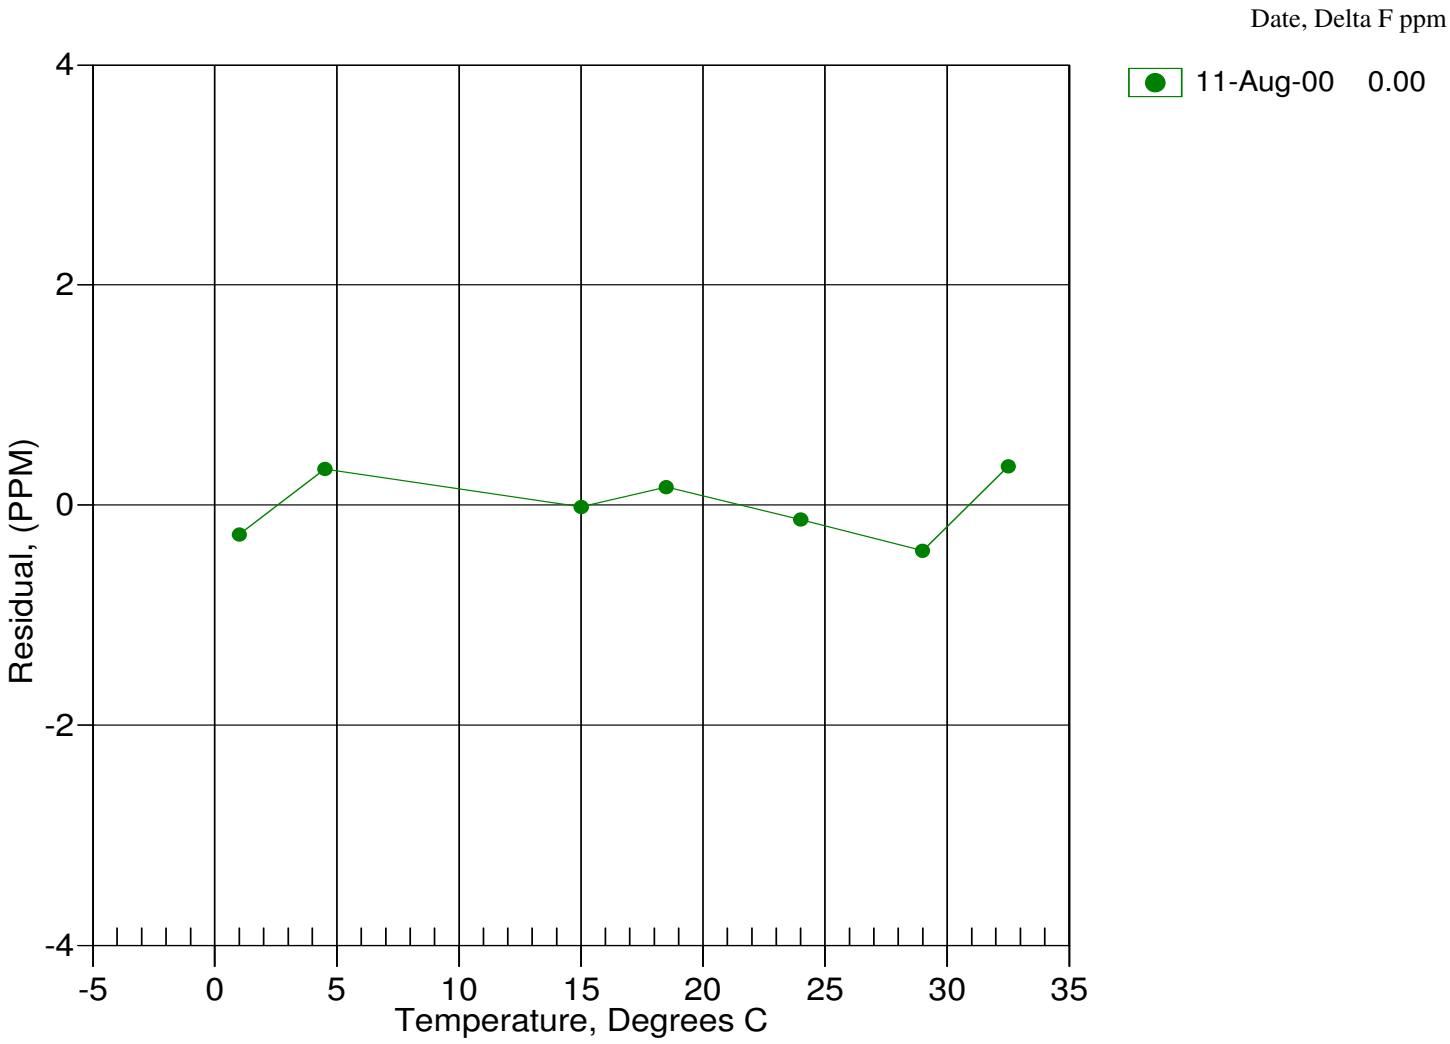
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6