Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1174
CALIBRATION DATE: 28-Jul-00

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 1.516813e-005
a1 = 2.789447e-004
a2 = -2.640254e-006
a3 = 1.621481e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0001	613752.1	1.0001	-0.0000
4.5000	524997.6	4.5000	0.0000
15.0000	334997.6	15.0000	0.0000
18.5001	290181.5	18.5000	-0.0001
23.9999	232923.0	23.9999	0.0000
29.0000	191883.7	29.0000	0.0000
32.5000	168090.3	32.5000	-0.0000

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
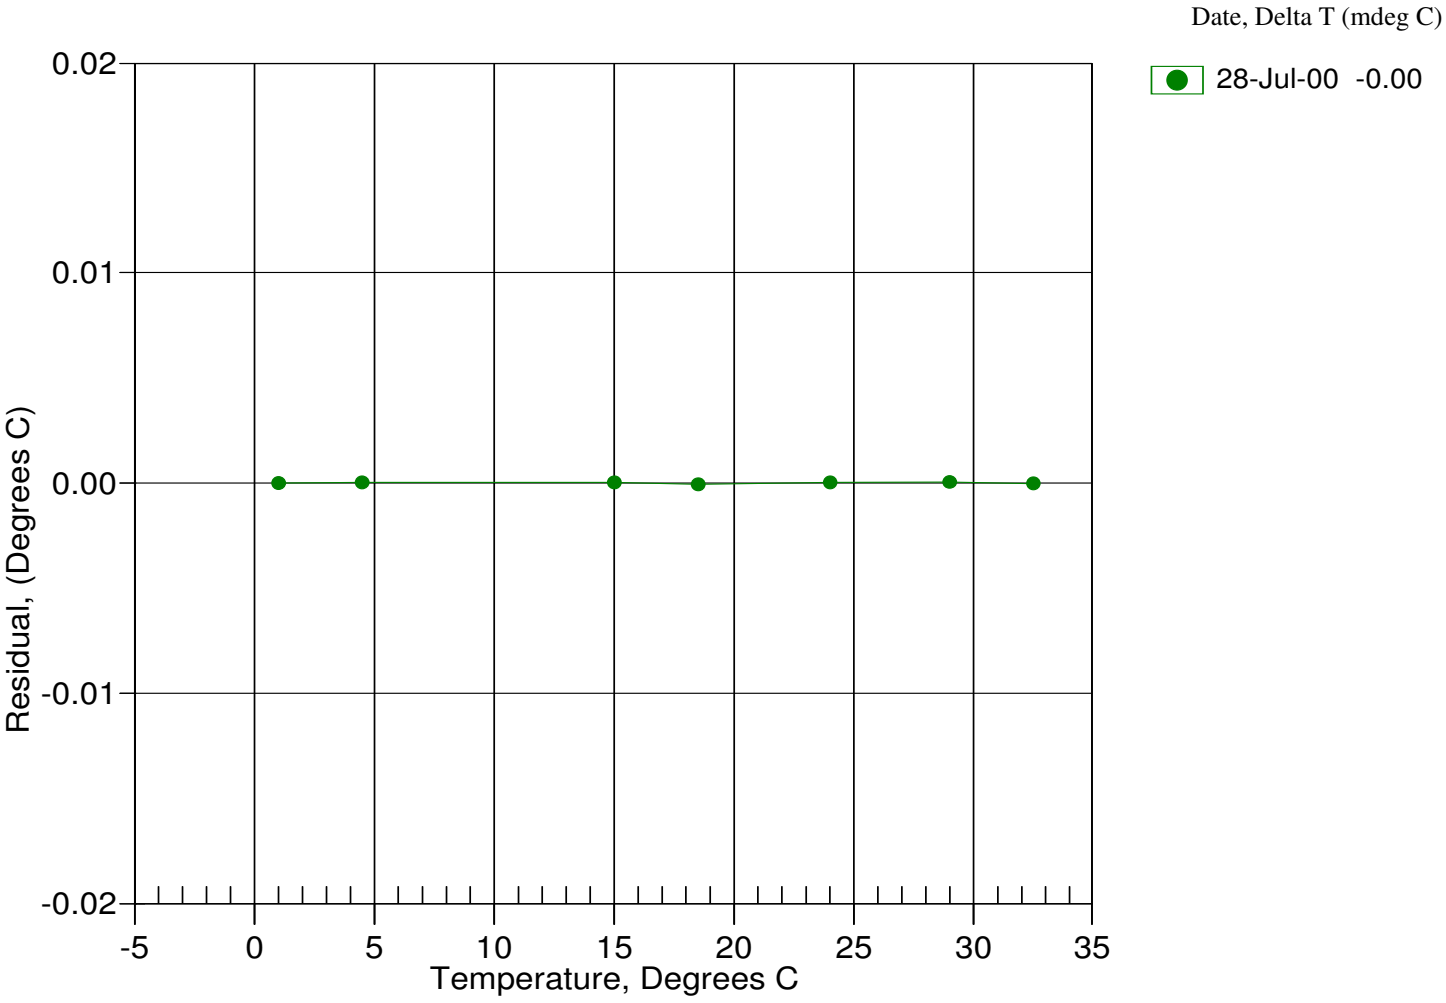
Residual = instrument temperature - bath temperature