Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1623
CALIBRATION DATE: 11-Aug-00

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -3.399520e-005
a1 = 2.809306e-004
a2 = -2.745224e-006
a3 = 1.678152e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0001	674142.1	1.0001	0.0000
4.5002	577543.6	4.5001	-0.0001
15.0000	370136.1	15.0001	0.0001
18.5001	321056.3	18.5001	0.0000
24.0001	258238.5	24.0000	-0.0001
29.0000	213122.1	29.0000	0.0000
32.5002	186919.8	32.5002	0.0000

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
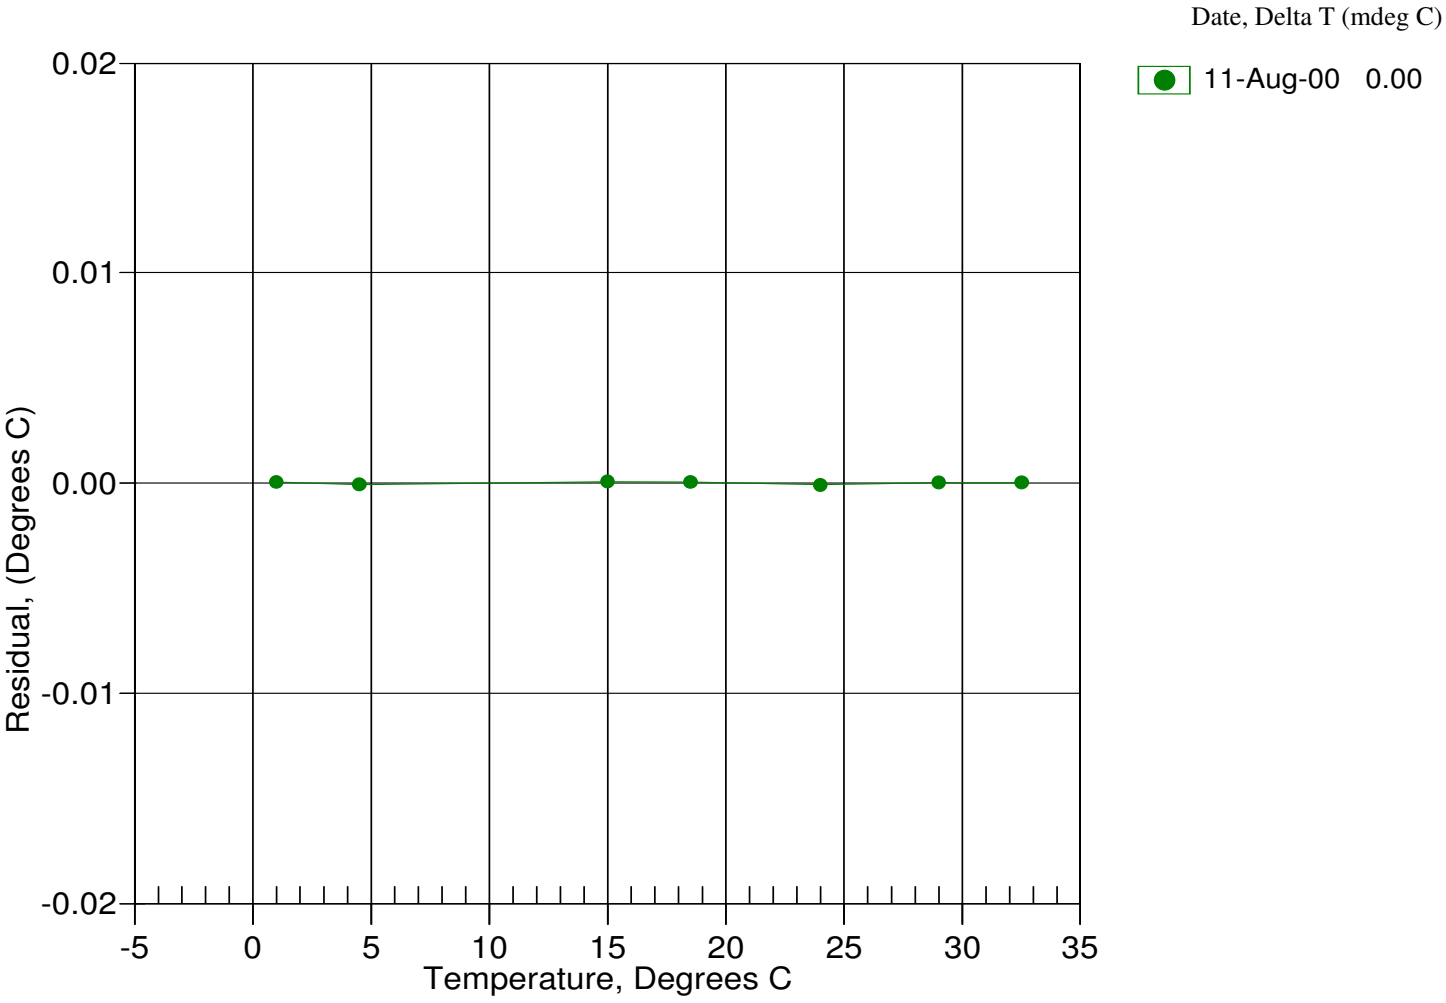
Residual = instrument temperature - bath temperature