Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1624
CALIBRATION DATE: 09-Aug-00

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -3.623396e-005
a1 = 2.830536e-004
a2 = -2.839836e-006
a3 = 1.715041e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0002	634510.5	1.0002	-0.0000
4.4998	543904.3	4.4998	0.0000
15.0000	349141.5	14.9999	-0.0001
18.5001	303003.0	18.5001	-0.0000
24.0000	243911.2	24.0002	0.0002
29.0003	201441.1	29.0001	-0.0002
32.5002	176761.7	32.5003	0.0001

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
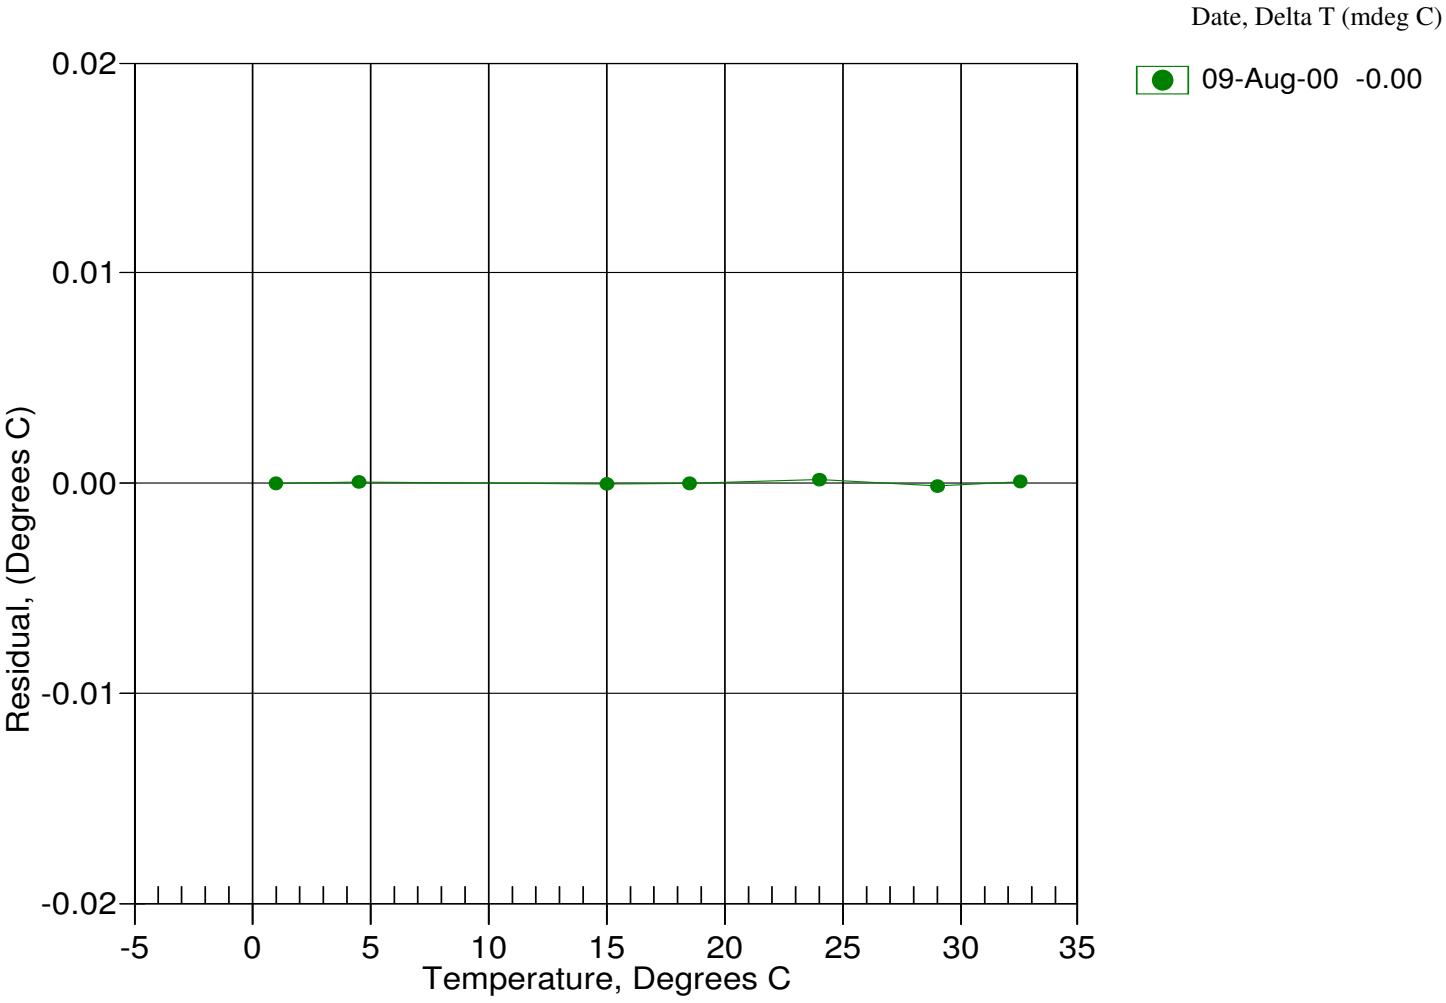
Residual = instrument temperature - bath temperature