Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1972
CALIBRATION DATE: 04-Feb-03

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 2957

COEFFICIENTS:

PA0 =	8.636313e-002	PTCA0 =	-1.751291e+002
PA1 =	6.826504e-002	PTCA1 =	1.446436e-002
PA2 =	-1.673368e-009	PTCA2 =	2.468087e-003
		PTCB0 =	2.498275e+001
		PTCB1 =	3.500000e-004
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.84	42.3	19.9	14.84	0.00
315.04	4440.3	19.9	314.95	-0.01
615.01	8837.7	20.0	614.95	-0.00
915.02	13236.7	20.0	915.00	-0.00
1215.22	17638.0	20.0	1215.14	-0.01
1515.32	22040.6	20.0	1515.31	-0.00
1515.32	22040.6	20.0	1515.31	-0.00
1215.05	17638.2	19.9	1215.16	0.01
914.98	13237.3	19.9	915.04	0.00
614.94	8838.2	20.0	614.99	0.00
314.96	4440.8	20.0	314.98	0.00
14.81	42.5	20.1	14.85	0.00

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	60.20	-5.00	24.98
29.00	59.90	35.00	25.00
24.00	59.10		
18.50	58.30		
15.00	57.90		
4.50	57.50		
1.00	57.20		

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)
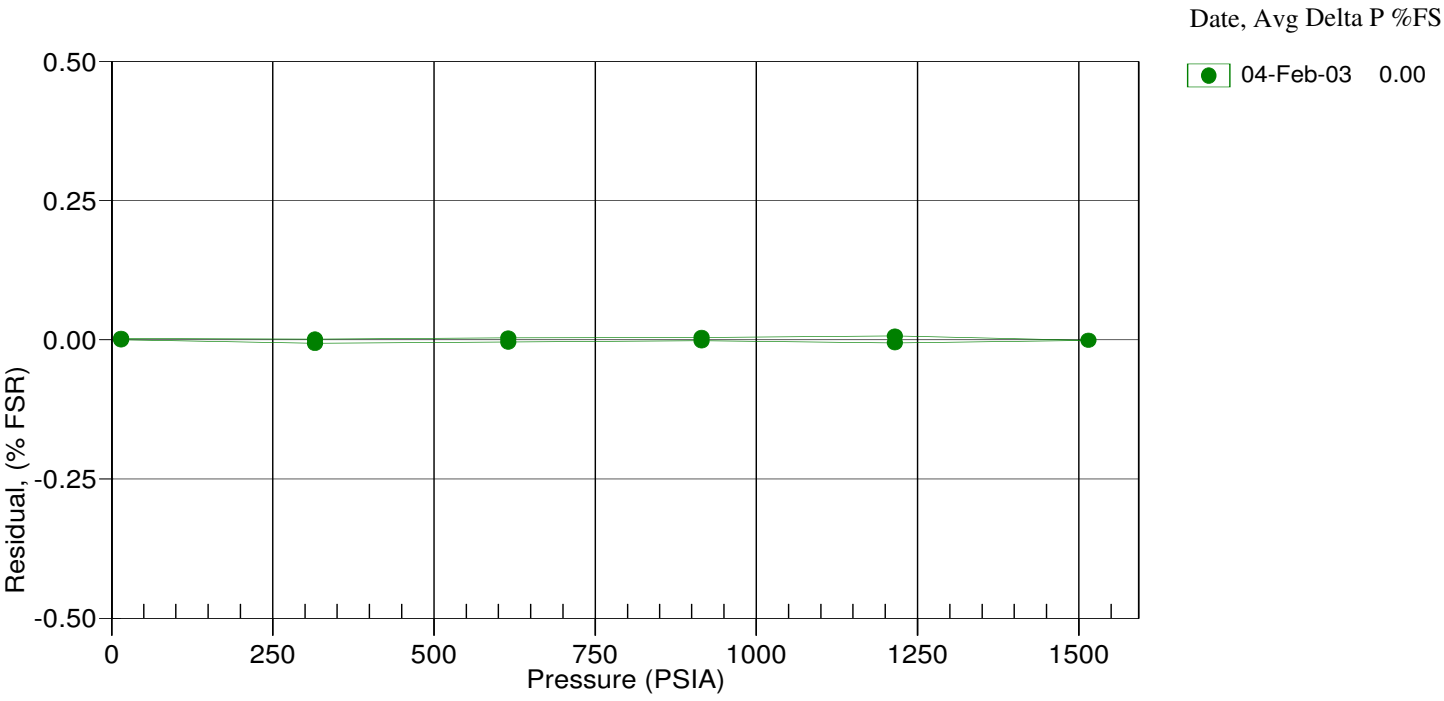
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2