Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1973
CALIBRATION DATE: 04-Feb-03

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 2958

COEFFICIENTS:

PA0 =	6.877479e-002	PTCA0 =	-1.918055e+002
PA1 =	6.823710e-002	PTCA1 =	-1.297014e-001
PA2 =	-1.993619e-009	PTCA2 =	9.121035e-003
		PTCB0 =	2.494563e+001
		PTCB1 =	-2.750000e-004
		PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.84	25.7	19.8	14.85	0.00
315.04	4423.2	19.7	314.94	-0.01
615.01	8820.6	19.9	614.95	-0.00
915.02	13219.9	19.9	915.02	-0.00
1215.22	17621.3	19.8	1215.15	-0.01
1515.32	22024.2	19.9	1515.30	-0.00
1515.32	22024.2	19.9	1515.30	-0.00
1215.05	17621.6	19.8	1215.17	0.01
914.98	13220.1	19.8	915.03	0.00
614.94	8821.0	19.8	614.98	0.00
314.96	4423.8	19.8	314.98	0.00
14.81	25.8	19.9	14.85	0.00

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	42.00	-5.00	24.95
29.00	40.80	35.00	24.94
24.00	39.00		
18.50	37.40		
15.00	36.70		
4.50	36.40		
1.00	36.60		

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)
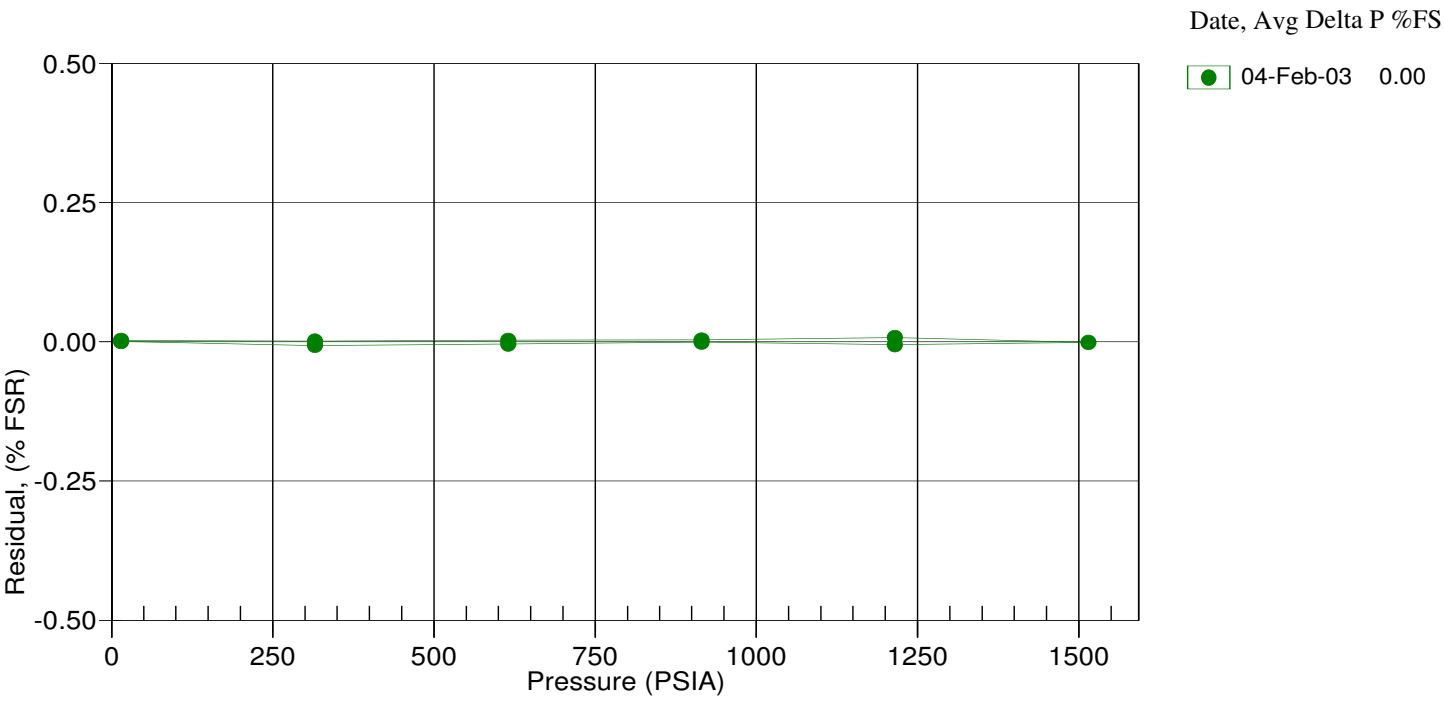
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2