Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1974
CALIBRATION DATE: 04-Feb-03

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
5076 psia S/N 2721

COEFFICIENTS:

```
PA0 =   -6.344326e-001
PA1 =    2.435639e-001
PA2 =   -1.703464e-007

PTCA0 = -1.272183e+001
PTCA1 = -4.813554e-001
PTCA2 =  1.761812e-002
PTCB0 =  2.503450e+001
PTCB1 = -1.300000e-003
PTCB2 =  0.000000e+000
```

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	TEMP ITS90	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FS
14.84	47.1	19.9	14.58	-0.00
1115.10	4573.1	20.0	1114.50	-0.01
2115.19	8714.2	19.9	2114.75	-0.01
3115.28	12879.5	20.0	3114.96	-0.01
4115.26	17069.5	20.1	4115.12	-0.00
5115.19	21284.3	20.0	5115.13	-0.00
5115.19	21284.3	20.0	5115.13	-0.00
4115.25	17071.5	20.1	4115.60	0.01
3115.26	12881.9	20.1	3115.54	0.01
2115.11	8717.7	20.1	2115.61	0.01
1114.98	4576.6	20.0	1115.35	0.01
14.78	49.5	20.2	15.15	0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	INST OUTPUT	TEMP ITS90	SPAN MV
32.50	54.20	-5.00	25.04
29.00	52.10	35.00	24.99
24.00	49.80		
18.50	48.30		
15.00	48.00		
4.50	49.50		
1.00	50.70		

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)
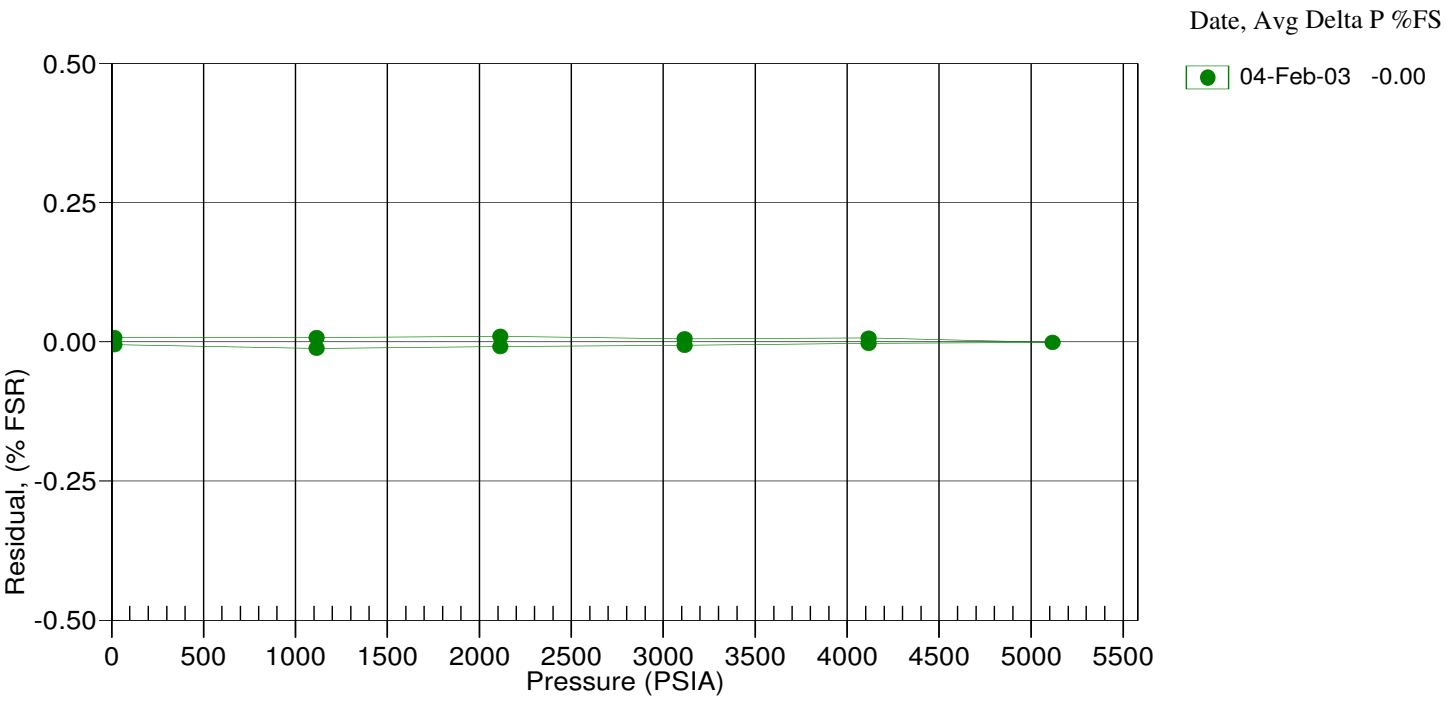
pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2