Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1972
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
rtca0 =  9.999843e-001
rtca1 =  1.796415e-006
rtca2 = -3.064622e-008
```

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9998	0.9999860	0.9999861	0.1
4.5000	0.9999920	0.9999918	-0.2
15.0000	1.0000040	1.0000044	0.4
18.5000	1.0000070	1.0000071	0.1
24.0000	1.0000100	1.0000098	-0.2
29.0000	1.0000110	1.0000106	-0.4
32.4999	1.0000100	1.0000103	0.3

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2
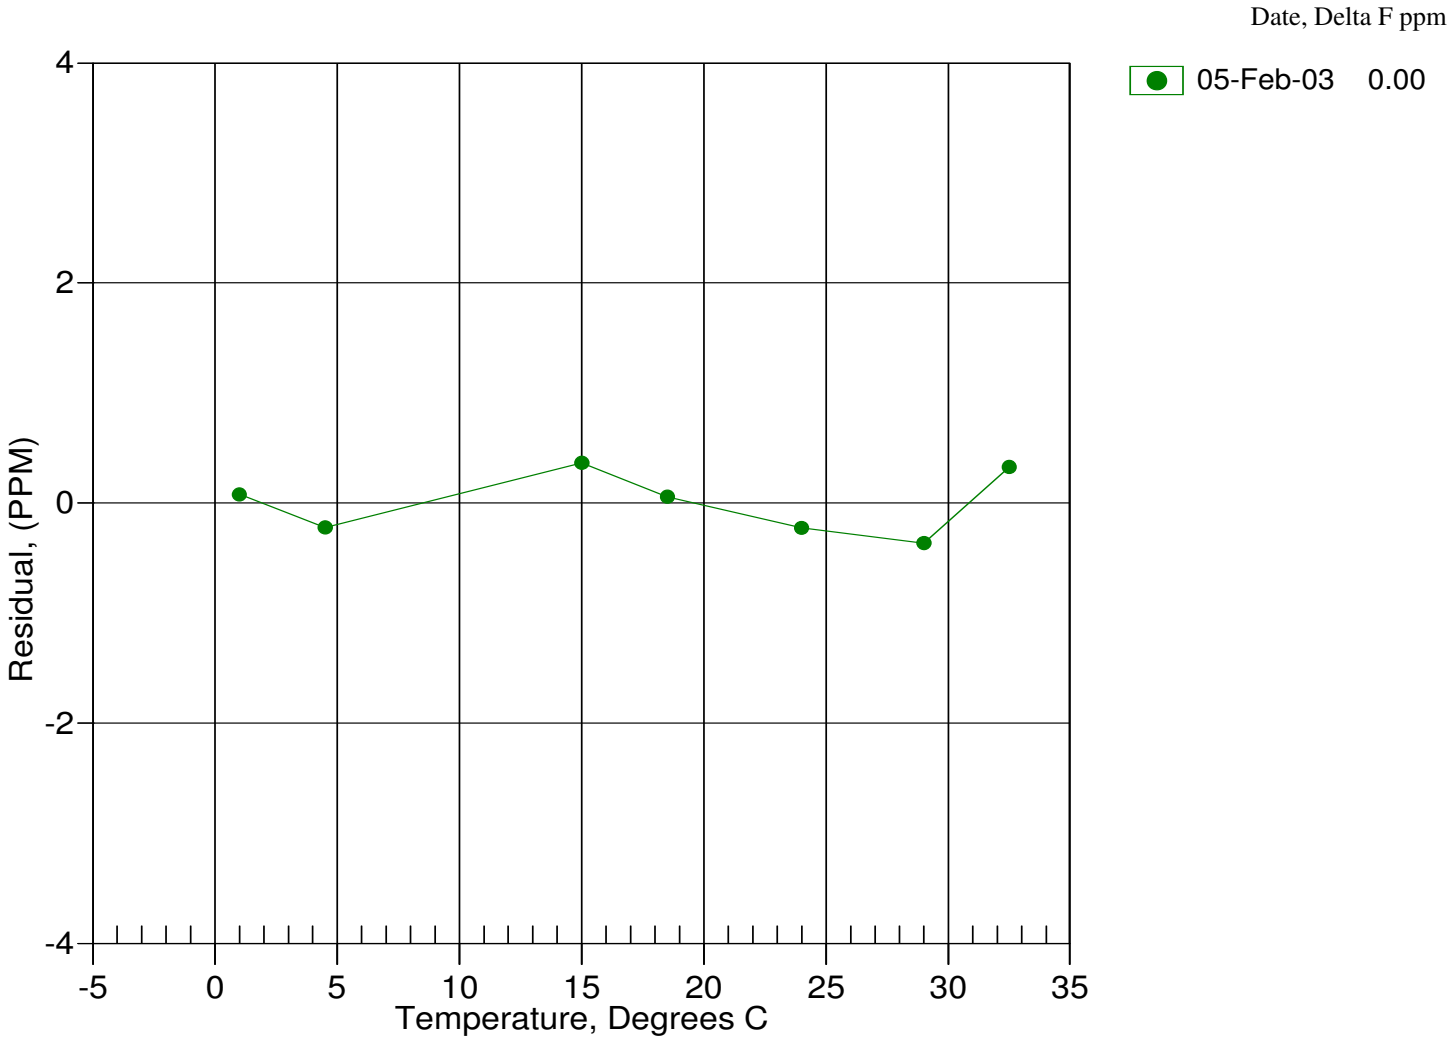
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6