Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1973
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999827e-001
rtca1 = 1.889127e-006
rtca2 = -3.506994e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9998	0.9999850	0.9999846	-0.4
4.5000	0.9999900	0.9999905	0.5
15.0000	1.0000030	1.0000032	0.2
18.5000	1.0000060	1.0000057	-0.3
24.0000	1.0000080	1.0000079	-0.1
29.0000	1.0000080	1.0000080	0.0
32.4999	1.0000070	1.0000071	0.1

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2
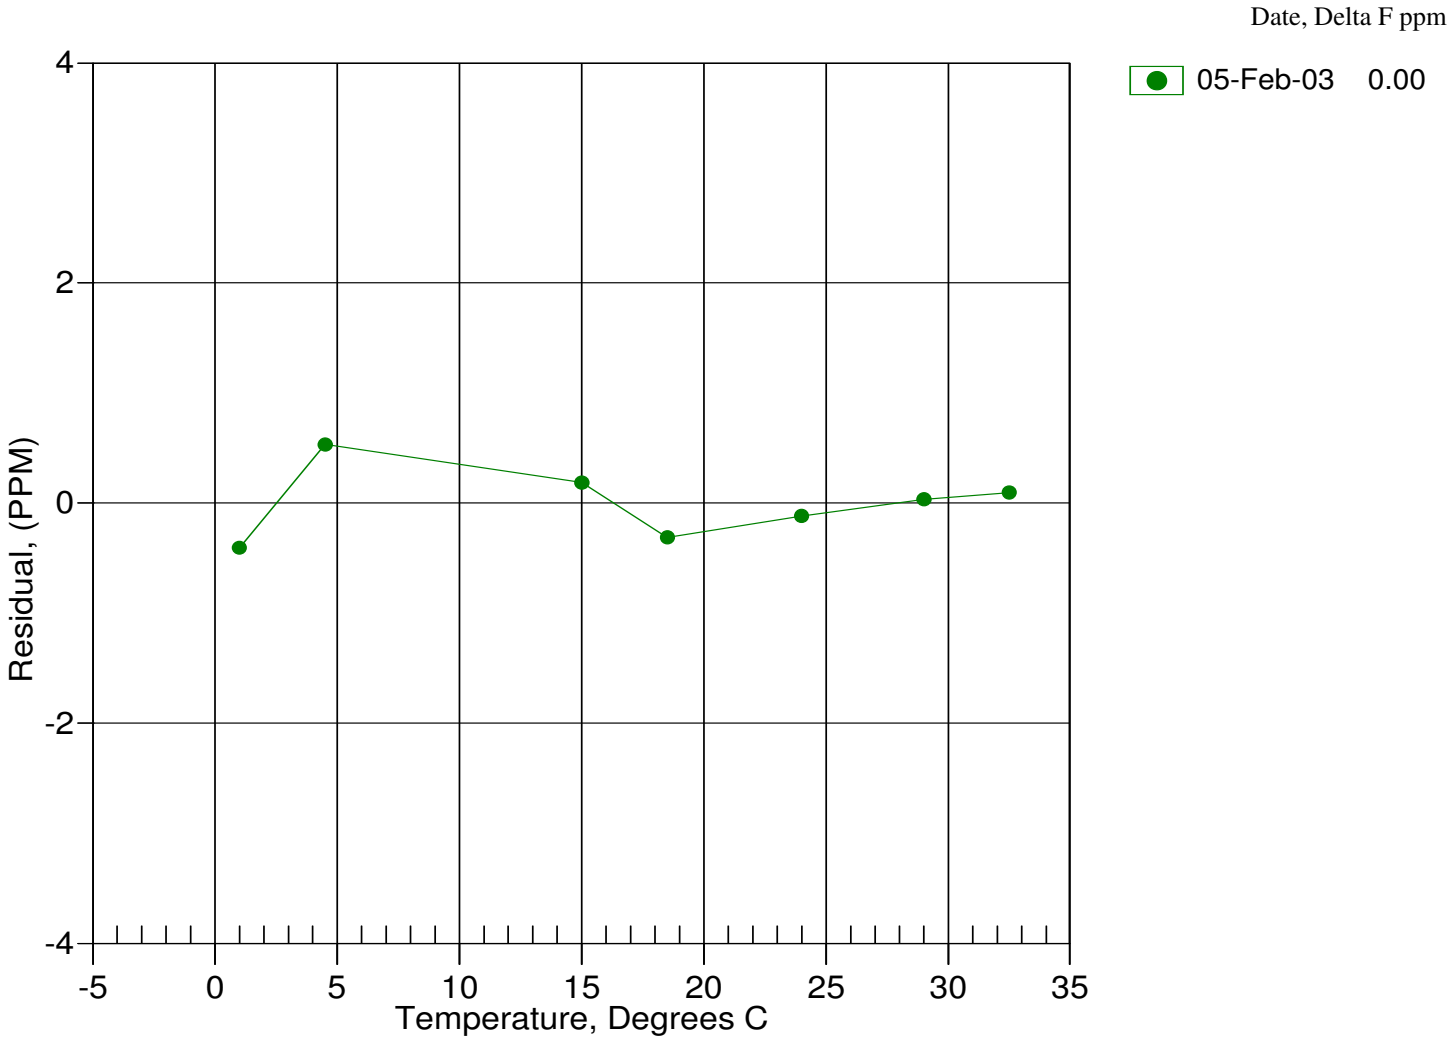
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6