# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 1974
CALIBRATION DATE: 06-Feb-03

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999813e-001
rtca1 = 1.809936e-006
rtca2 = -3.220971e-008

| BATH TEMP (ITS-90) | RTC FREQ (Hz) | COMPUTED FREQ (Hz) | RESIDUAL (PPM) |
|---|---|---|---|
| 1.0000 | 0.9999830 | 0.9999831 | 0.1 |
| 4.4999 | 0.9999890 | 0.9999888 | -0.2 |
| 15.0000 | 1.0000010 | 1.0000012 | 0.2 |
| 18.4999 | 1.0000040 | 1.0000038 | -0.2 |
| 24.0000 | 1.0000060 | 1.0000062 | 0.2 |
| 29.0000 | 1.0000070 | 1.0000067 | -0.3 |
| 32.5000 | 1.0000060 | 1.0000061 | 0.1 |

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * $t^2$
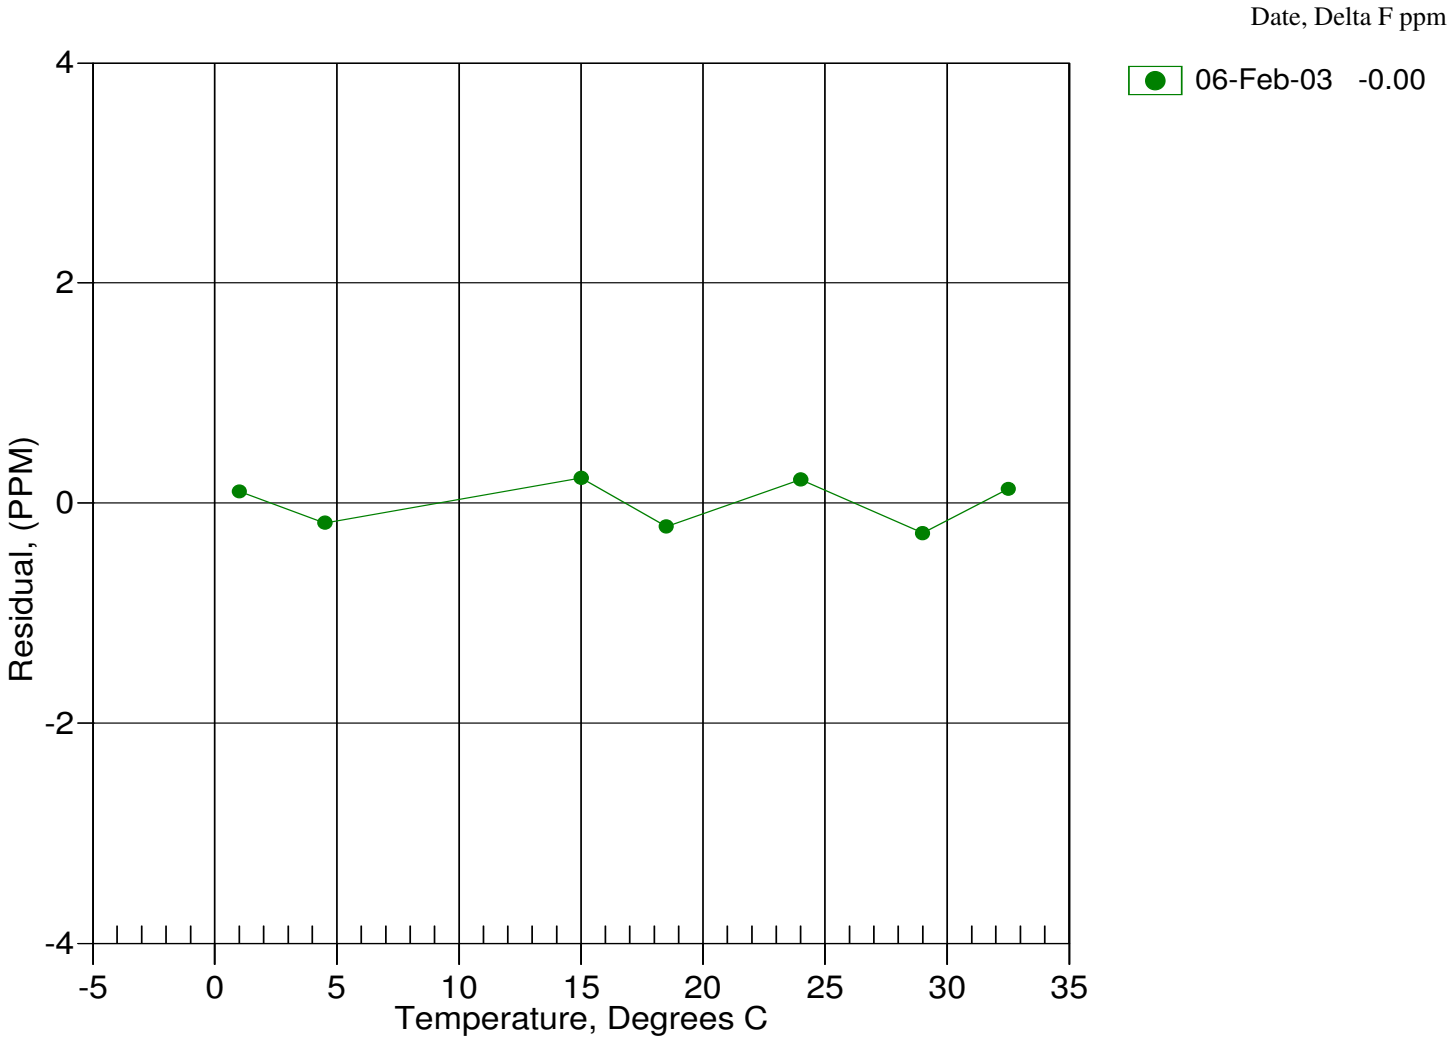
Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6