Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1973
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 2.191076e-005
a1 = 2.758196e-004
a2 = -2.313070e-006
a3 = 1.588685e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
0.9998	582824.3	0.9998	-0.0000
4.5000	499428.7	4.5000	0.0000
15.0000	320301.5	15.0000	0.0000
18.5000	277894.0	18.5000	-0.0000
24.0000	223597.5	23.9999	-0.0001
29.0000	184587.1	29.0001	0.0001
32.4999	161928.4	32.4998	-0.0001

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
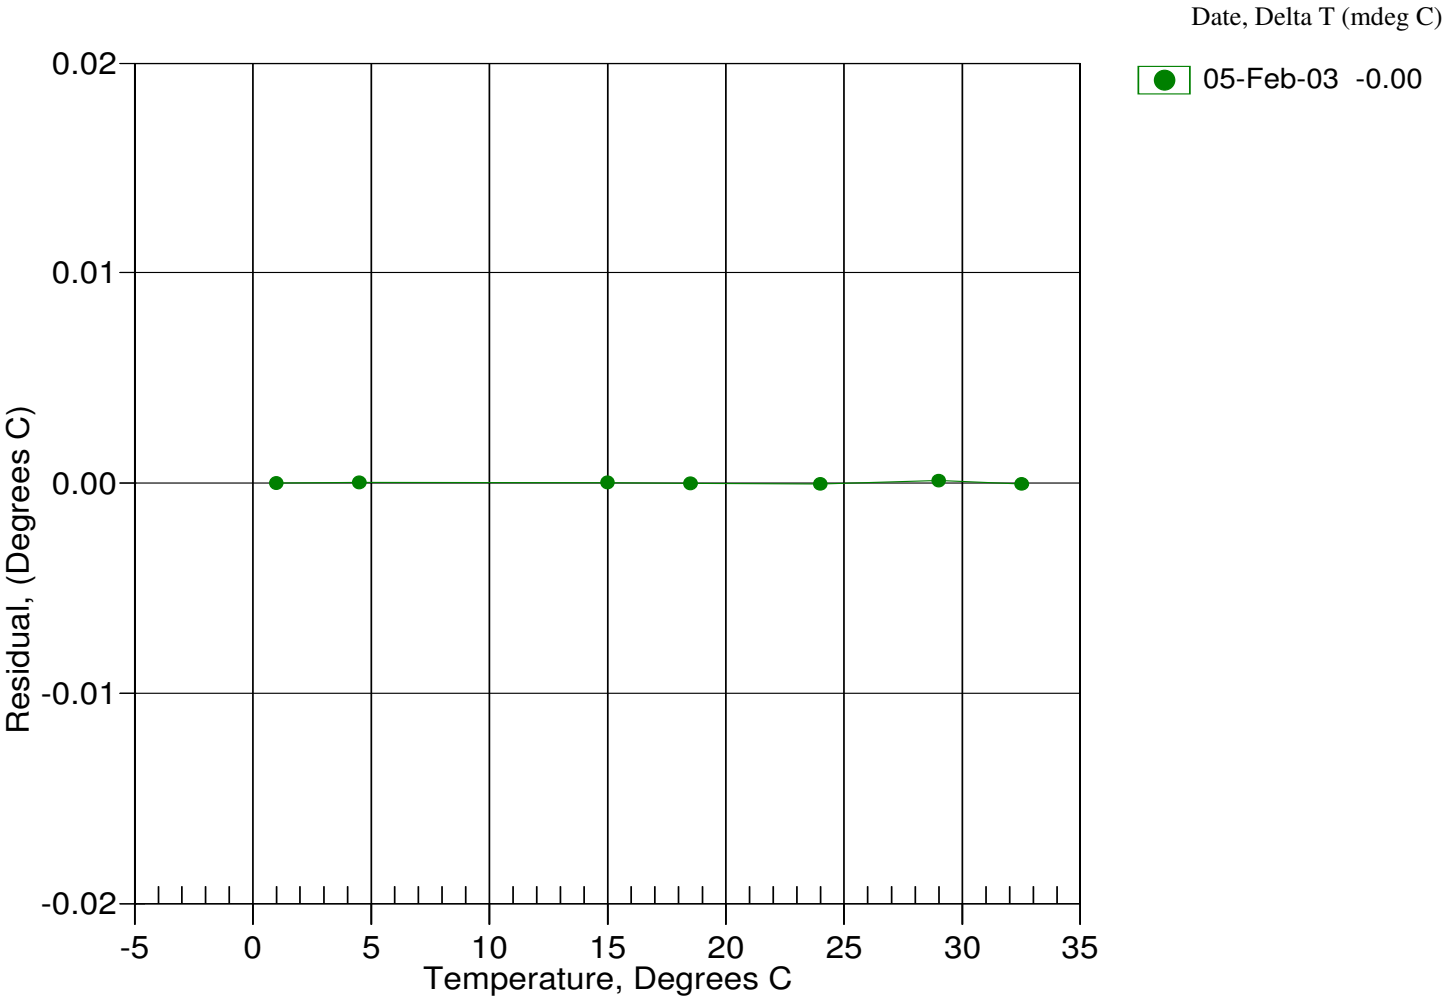
Residual = instrument temperature - bath temperature