# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 1974
CALIBRATION DATE: 06-Feb-03

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -6.623540e-005
a1 = 2.928518e-004
a2 = -3.668538e-006
a3 = 1.943400e-007

| BATH TEMP (ITS-90) | INSTRUMENT OUTPUT | INST TEMP (ITS-90) | RESIDUAL (ITS-90) |
|---|---|---|---|
| 1.0000 | 618904.5 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4.4999 | 530432.9 | 4.4998 | -0.0001 |
| 15.0000 | 340304.3 | 15.0000 | 0.0000 |
| 18.4999 | 295279.9 | 18.5000 | 0.0001 |
| 24.0000 | 237624.3 | 23.9999 | -0.0001 |
| 29.0000 | 196196.2 | 28.9999 | -0.0001 |
| 32.5000 | 172127.8 | 32.5001 | 0.0001 |

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)
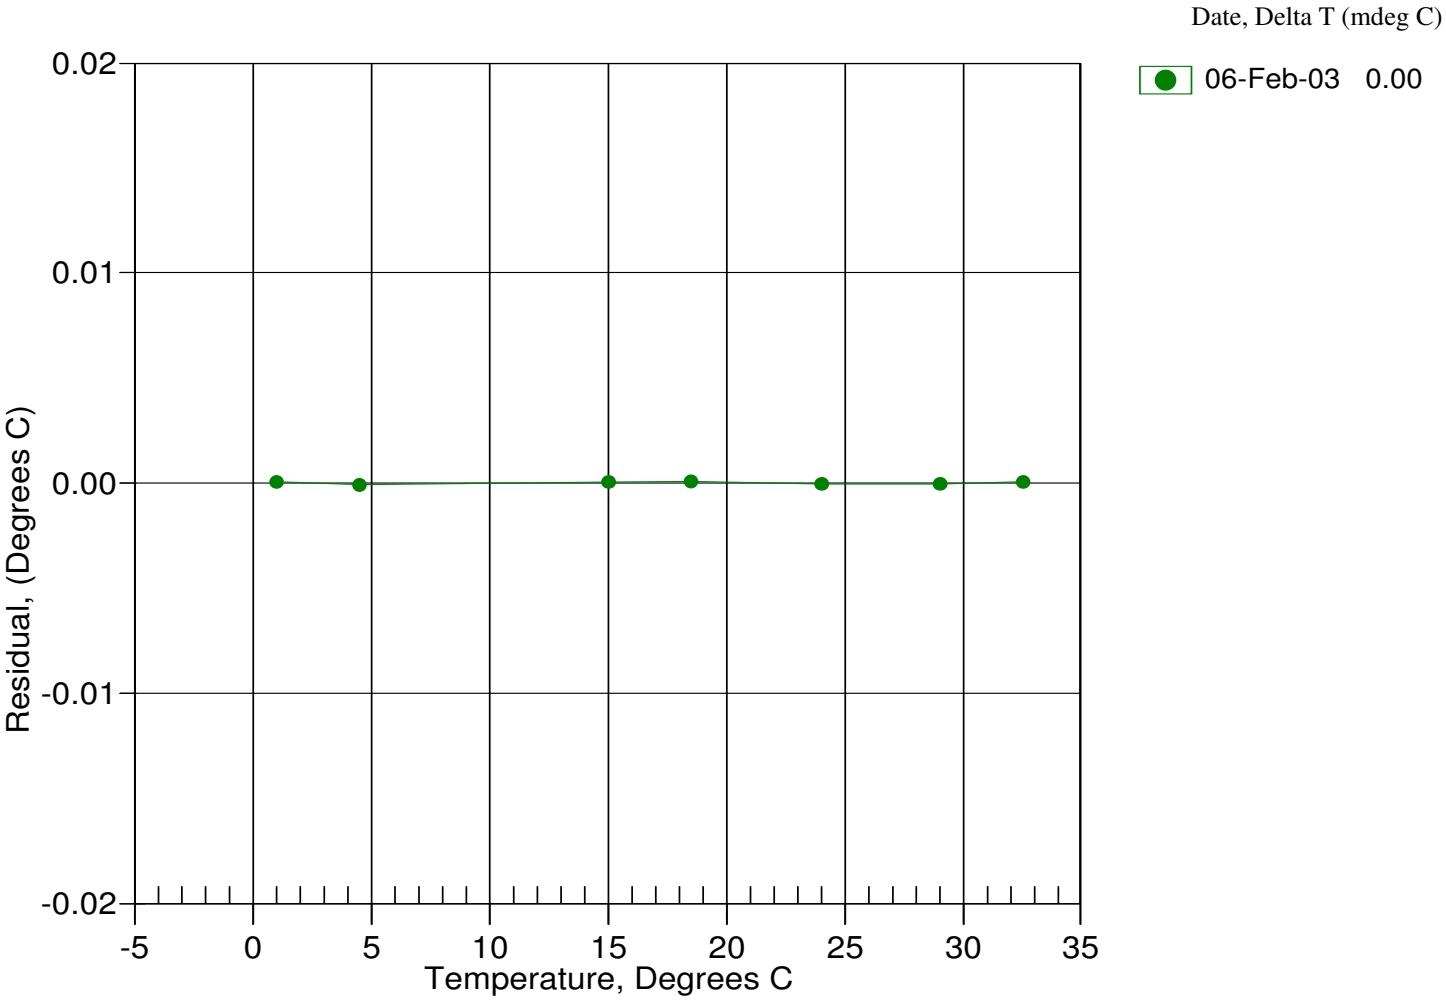
Residual = instrument temperature - bath temperature