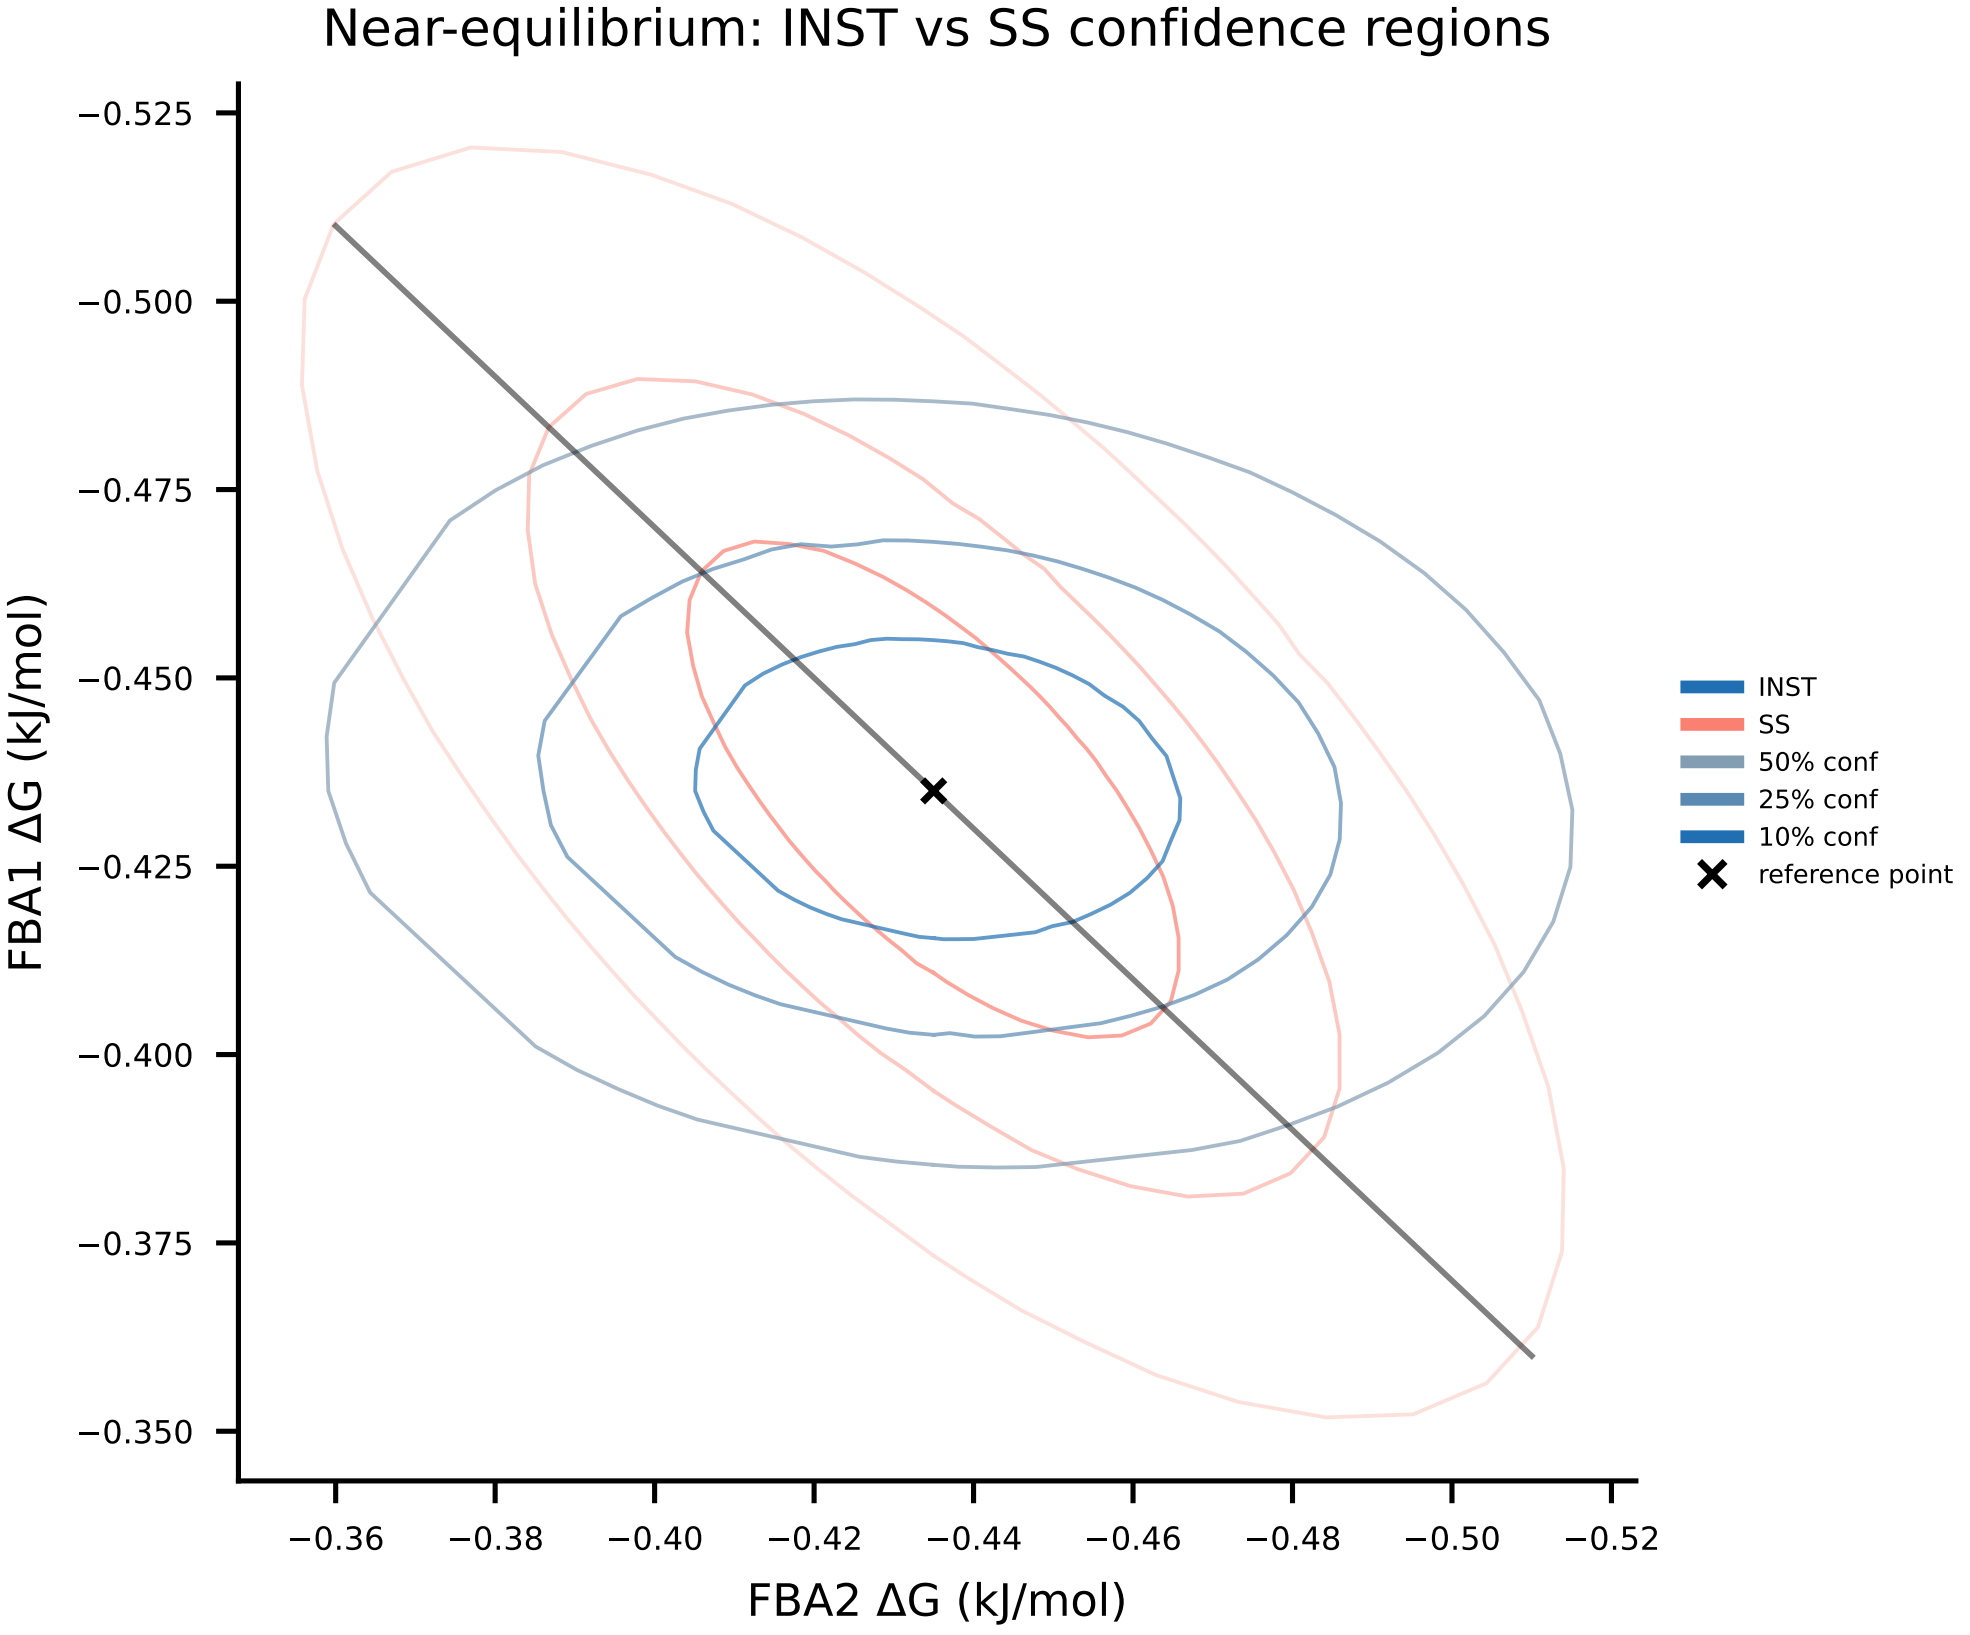
Near-equilibrium: INST vs SS confidence regions
FBA1 ΔG (kJ/mol)
−0.525
−0.500
−0.475
−0.450
−0.425
−0.400
−0.375
−0.350
FBA2 ΔG (kJ/mol)
−0.36
−0.38
−0.40
−0.42
−0.44
−0.46
−0.48
−0.50
−0.52
INST
SS
50% conf
25% conf
10% conf
reference point