DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ				
Số thứ tự	**Tên máy móc, thiết bị**	**Bộ phận**	**Số lượng**	**Tình trạng sử dụng**
1	Máy chà nhám	Gỗ	5	Bình thường
2	Máy ghép	Gỗ	1	Bình thường
3	Máy khoan	Gỗ	11	Bình thường
4	Máy CNC phay	Gỗ	7	Bình thường
5	Máy bào	Gỗ	5	Bình thường
6	Máy mài	Gỗ	1	Bình thường
7	Máy tiện	Gỗ	2	Bình thường
8	Máy tubi	Gỗ	3	Bình thường
9	Máy cắt	Gỗ	6	Bình thường
10	Máy nhám chổi	Gỗ	2	Bình thường
11	Máy in chữ	Gỗ	1	Bình thường
12	Máy ép	Gỗ	1	Bình thường
13	Máy hàn	Dây sắt	35	Bình thường
14	Máy CNC cắt	Dây sắt	6	Bình thường
15	Máy cắt	Dây sắt	11	Bình thường
16	Máy bẻ	Dây sắt	3	Bình thường
17	Máy mài	Dây sắt	3	Bình thường
18	Máy dập	Dây sắt	3	Bình thường
19	Máy ép	Nhựa	6	Bình thường
20	Máy trộn liệu	Nhựa	2	Bình thường
21	Máy xay liệu	Nhựa	2	Bình thường
22	Máy nước	Nhựa	1	Bình thường
23	Máy nhúng	Nhựa	1	Bình thường
24	Máy CNC phay	Khuôn	2	Bình thường
25	Máy bắn điện	Khuôn	1	Bình thường
26	Máy cắt dây	Khuôn	2	Bình thường
27	Máy tiện	Khuôn	2	Bình thường
28	Máy phay	Khuôn	2	Bình thường
29	Máy mài	Khuôn	1	Bình thường
30	Máy cắt liệu	Dập	2	Bình thường
31	Máy cuốn	Dập	4	Bình thường
32	Máy thủy lực	Dập	4	Bình thường
33	Máy dập	Dập	32	Bình thường
34	Máy mài	Đánh bóng	5	Bình thường
35	Máy dập	Đánh bóng	6	Bình thường
36	Máy cưa	Đánh bóng	1	Bình thường
37	Máy ép	Đánh bóng	2	Bình thường
38	Máy đánh bóng	Đánh bóng	4	Bình thường
39	Máy khắc logo	Đóng gói	3	Bình thường
40	Máy cắt túi	Đóng gói	3	Bình thường
41	Máy nóng	Đóng gói	2	Bình thường
42	Máy bắn dây	Đóng gói	2	Bình thường
43	Máy bắn tem	Đóng gói	5	Bình thường
44	Máy ép túi	Đóng gói	2	Bình thường
45	Máy ép tem	Đóng gói	1	Bình thường
46	Máy dán tem	Đóng gói	2	Bình thường
47	Máy dập	Đóng gói	4	Bình thường
48	Máy ráp kẹp	Đóng gói	1	Bình thường
49	Máy đai thùng	Đóng gói	1	Bình thường
50	Máy bắn ron	Đóng gói	1	Bình thường
Tổng số lượng máy móc, thiết bị: 215				

Vì triệu khách hàng Việt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
TRIEU GIA INSPECTION SERVICE TRADING CO.,LTD **(ĐK 583)**
Số 31/16A Đường 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 07 07 01 79 79 Email: kiemdinhtigi@gmail.com Website: kiemdinhtigi.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CALIBRATION CERTIFICATE

Số *(N°)* : 01276/CĐ25-TiGi

1. Tên phương tiện đo *(Object)* : **CÂN ĐIỆN TỬ** — Mã nhận dạng *(ID)* : N/A
2. Kiểu *(Type)* : ACS-JH7 — Số hiệu *(Serial N°)* : 2025050602
3. Nơi sản xuất *(Manufacturer)* : N/A — Năm sản xuất *(Year)* : N/A
4. Đặc trưng kỹ thuật *(Specifications)* :
   - Mức cân lớn nhất *(Max. capacity)* : 30000 g
   - Mức cân nhỏ nhất *(Min. capacity)* : 20 g
   - Giá trị độ chia *(Division)* : 1 g
5. Cơ sở sử dụng *(Customer)* : **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**
   Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
6. Nơi hiệu chuẩn *(Place of calibration)* : **Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**
7. Phương pháp thực hiện *(Method of calibration)* : **QTHC 01 - TiGi: Cân cấp chính xác I,II,III,IIII - Quy trình hiệu chuẩn**
   (Balance of class I,II,III,IIII - Calibration procedure)
8. Chuẩn được sử dụng *(Standards used)* :

Mã số *(ID)*	Tên chuẩn *(Description)*		Liên kết chuẩn *(Traceability)*	Hiệu lực *(Due date)*
TG-KL(08-16)	Bộ quả *(Set of weights)*	M1	ĐL CầnThơ	07-2025
TG-KL(07)	Bộ quả *(Set of weights)*	F2	SMEQ	07-2025

9. Môi trường hiệu chuẩn *(Calibration environment)* : (30 ± 5) °C (60 ± 20) %RH
10. Hiệu chỉnh *(Adjustment)* : ☒ Không *(No)* ☐ Có *(Yes)*
11. Kết quả *(Results)* : Xem kết quả trang sau *(See the results on the next page)*
12. Ngày hiệu chuẩn *(Date of calibration)* : 06/05/2025
13. Tem hiệu chuẩn *(Calibration label)* : TiGi-01276
14. Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recommended recalibration date)* : 06/05/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2025
(Date of issue)

TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG
(Head of Metrology)

Nguyễn Đăng Chương

GIÁM ĐỐC
(Director)

M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H. ★ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA ★ TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Lưu Trương Bảo

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty KĐ Triệu Gia.
This calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of KĐ Trieu Gia.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H - TP. THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN



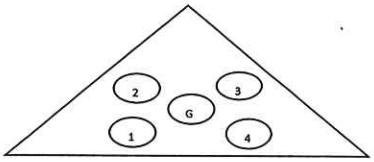
CALIBRATION RESULTS

Số *(N°)* : 01276/CĐ25-TiGi

1. Độ lặp lại *(Repeatability)* :

Mức cân *(Load)* , g	Độ lệch chuẩn *(Standard deviation of reading)* , g
15000	0,548
30000	0,548

2. Độ lệch tâm *(Eccentricity)* :

Mức cân *(Load)* , g	10000				
Vị trí đặt tải *(Load position)*	G	1	2	3	4
Sai lệch *(difference)* , g	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Lệch tâm lớn nhất, g *(Maximum difference)*	1,00				
Sơ đồ *(Sketch)* :	  				

3. Độ đúng *(Accuracy)* :

Mức cân *(Load)* g	Gía trị đọc mức cân *(Balance Reading)* g	Số hiệu chỉnh *(Correction)* g	Độ không đảm bảo đo *(Uncertainty)* g
20	20,0	0,0	1,40
1000	1000,0	0,0	1,40
5000	5000,0	0,0	1,60
10000	10000,0	0,0	2,00
15000	15000,0	0,0	2,60
20000	20000,0	0,0	3,20
25000	24999,0	1,0	3,80
30000	29998,0	2,0	4,50

- Độ không đảm bảo đo với hệ số phủ k = 2, mức tin cậy xấp xỉ 95%

(The uncertainty with coverage factor k = 2, at 95% confidence level)

- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
(This measuring instrument is not used for quantifying goods and services in trading, payment, safety assurance, communityhealth protection, environmental protection, inspection, inspection and assessment, law and in other public service activities)
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
(This measuring instrument is not to be used directly for the verification of group 2 measuring instruments)

Vì triệu khách hàng Việt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
TRIEU GIA INSPECTION SERVICE TRADING CO.,LTD **(ĐK 583)**
Số 31/16A Đường 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 07 07 01 79 79 Email: kiemdinhtigi@gmail.com Website: kiemdinhtigi.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CALIBRATION CERTIFICATE

Số *(N°)* : 01274/CB25-TiGi

1. Tên phương tiện đo *(Object)*	: **CÂN ĐIỆN TỬ**	Mã nhận dạng *(ID)*	: N/A
2. Kiểu *(Type)*	: XK3190-A12+E	Số hiệu *(Serial N°)*	: 2025040603
3. Nơi sản xuất *(Manufacturer)*	: N/A	Năm sản xuất *(Year)*	: 2023
4. Đặc trưng kỹ thuật *(Specifications)*	:		
	- Mức cân lớn nhất *(Max. capacity)*		: 2000 kg
	- Mức cân nhỏ nhất *(Min. capacity)*		: 10 kg
	- Giá trị độ chia *(Division)*		: 0,5 kg
5. Cơ sở sử dụng *(Customer)*	: **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM** Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương		
6. Nơi hiệu chuẩn (*Place of calibration*)	: **Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**		
7. Phương pháp thực hiện *(Method of calibration)*	: **QTHC 01 - TiGi: Cân cấp chính xác I,II,III,IIII - Quy trình hiệu chuẩn** (Balance of class I,II,III,IIII - Calibration procedure)		

8. Chuẩn được sử dụng *(Standards used)* :

Mã số *(ID)*	Tên chuẩn *(Description)*	Liên kết chuẩn *(Traceability)*	Hiệu lực *(Due date)*
TG-KL(08-16)	Bộ quả (*Set of weights)* M1	ĐL CầnThơ	07-2025

9. Môi trường hiệu chuẩn *(Calibration environment)* : (30± 5) °C (60 ± 20) %RH
10. Hiệu chỉnh *(Adjustment)* : ☒ Không *(No)* ☐ Có *(Yes)*
11. Kết quả *(Results)* : Xem kết quả trang sau *(See the results on the next page)*
12. Ngày hiệu chuẩn *(Date of calibration)* : 06/05/2025
13. Tem hiệu chuẩn *(Calibration label)* : TiGi-01274
14. Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recommended recalibration date)* : 06/05/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2025
(Date of issue)

TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG
(Head of Metrology)

Nguyễn Đăng Chương

GIÁM ĐỐC
(Director)

M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H ★ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA ★ TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Lưu Trương Bảo

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty KĐ Triệu Gia.
This calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of KĐ Trieu Gia.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H - TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

CALIBRATION RESULTS

Số *(N°)* : 01274/CB25-TiGi

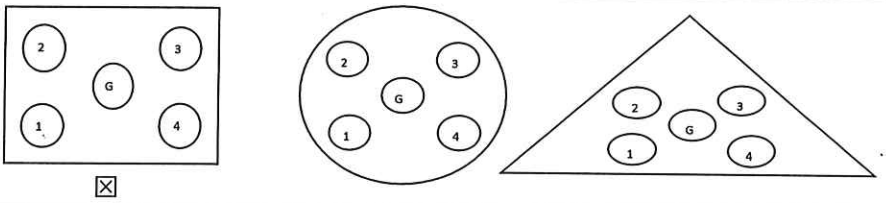
1. Độ lặp lại *(Repeatability)* :

Mức cân *(Load)* , kg	Độ lệch chuẩn *(Standard deviation of reading)* , kg
1000	0,274
2000	0,316

2. Độ lệch tâm *(Eccentricity)* :

Mức cân *(Load)* , kg	700				
Vị trí đặt tải *(Load position)*	G	1	2	3	4
Sai lệch *(difference)* , kg	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Lệch tâm lớn nhất, kg *(Maximum difference)*	1,00				

Sơ đồ *(Sketch)* :



☒

3. Độ đúng *(Accuracy)* :

Mức cân *(Load)* kg	Gía trị đọc mức cân *(Balance Reading)* kg	Số hiệu chỉnh *(Correction)* kg	Độ không đảm bảo đo *(Uncertainty)* kg
10,0	10,00	0,00	0,76
100,0	100,00	0,00	0,78
200,0	200,00	0,00	0,83
400,0	400,00	0,00	1,10
800,0	800,00	0,00	1,60
1200,0	1199,50	0,50	2,20
1600,0	1599,50	0,50	2,80
2000,0	1999,00	1,00	3,40

- Độ không đảm bảo đo với hệ số phủ k = 2, mức tin cậy xấp xỉ 95%

(The uncertainty with coverage factor k = 2, at 95% confidence level)

- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
(This measuring instrument is not used for quantifying goods and services in trading, payment, safety assurance, communityhealth protection, environmental protection, inspection, inspection and assessment, law and in other public service activities)
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
(This measuring instrument is not to be used directly for the verification of group 2 measuring instruments)

TiGi
Vì triệu khách hàng Việt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
TRIEU GIA INSPECTION SERVICE TRADING CO.,LTD **(ĐK 583)**
Số 31/16A Đường 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 07 07 01 79 79 Email: kiemdinhtigi@gmail.com Website: kiemdinhtigi.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CALIBRATION CERTIFICATE

Số *(N°)* : 01275/CĐ25-TiGi

1. Tên phương tiện đo *(Object)*	:	**CÂN ĐIỆN TỬ**	Mã nhận dạng *(ID)* :	N/A
2. Kiểu *(Type)*	:	UCA-N	Số hiệu *(Serial N°)* :	NV2304161
3. Nơi sản xuất *(Manufacturer)*	:	N/A	Năm sản xuất *(Year)* :	N/A
4. Đặc trưng kỹ thuật *(Specifications)*	:			
		- Mức cân lớn nhất *(Max. capacity)*	:	30000 g
		- Mức cân nhỏ nhất *(Min. capacity)*	:	20 g
		- Giá trị độ chia *(Division)*	:	1 g
5. Cơ sở sử dụng *(Customer)*	:	**CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM** Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương		
6. Nơi hiệu chuẩn *(Place of calibration)*	:	**Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**		
7. Phương pháp thực hiện *(Method of calibration)*	:	**QTHC 01 - TiGi: Cân cấp chính xác I,II,III,IIII - Quy trình hiệu chuẩn** (Balance of class I,II,III,IIII - Calibration procedure)		

8. Chuẩn được sử dụng *(Standards used)* :

Mã số *(ID)*	Tên chuẩn *(Description)*		Liên kết chuẩn *(Traceability)*	Hiệu lực *(Due date)*
TG-KL(08-16)	Bộ quả (*Set of weights*)	M1	ĐL CầnThơ	07-2025
TG-KL(07)	Bộ quả (*Set of weights*)	F2	SMEQ	07-2025

9. Môi trường hiệu chuẩn *(Calibration environment)* : (30 ± 5) °C (60 ± 20) %RH

10. Hiệu chỉnh *(Adjustment)* : ☒ Không *(No)* ☐ Có *(Yes)*

11. Kết quả *(Results)* : Xem kết quả trang sau *(See the results on the next page)*

12. Ngày hiệu chuẩn *(Date of calibration)* : 06/05/2025

13. Tem hiệu chuẩn *(Calibration label)* : TiGi-01275

14. Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recommended recalibration date)* : 06/05/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2025
(Date of issue)

TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG
(Head of Metrology)

Nguyễn Đăng Chương

GIÁM ĐỐC
(Director)

M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA - TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Lưu Trương Bảo

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty KĐ Triệu Gia.
This calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of KĐ Trieu Gia.

M.S.D.N: 0312991557 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRIỆU GIA
TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

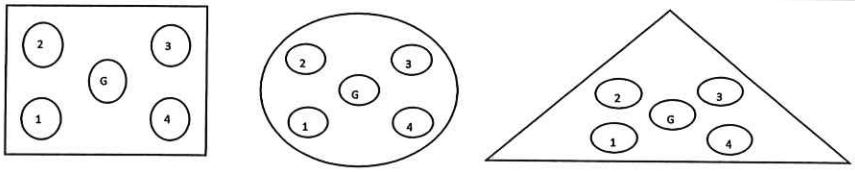
CALIBRATION RESULTS

Số *(N^o)* : 01275/CĐ25-TiGi

1. Độ lặp lại *(Repeatability)* :

Mức cân *(Load)* , g	Độ lệch chuẩn *(Standard deviation of reading)* , g
15000	0,516
30000	0,548

2. Độ lệch tâm *(Eccentricity)* :

Mức cân *(Load)* , g	10000				
Vị trí đặt tải *(Load position)*	G	1	2	3	4
Sai lệch *(difference)* , g	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Lệch tâm lớn nhất, g *(Maximum difference)*	1,00				
Sơ đồ *(Sketch)* :					

3. Độ đúng *(Accuracy)* :

Mức cân *(Load)* g	Gía trị đọc mức cân *(Balance Reading)* g	Số hiệu chỉnh *(Correction)* g	Độ không đảm bảo đo *(Uncertainty)* g
20	20,0	0,0	1,40
1000	1000,0	0,0	1,40
5000	5000,0	0,0	1,60
10000	10000,0	0,0	2,00
15000	15000,0	0,0	2,60
20000	20000,0	0,0	3,20
25000	24999,0	1,0	3,80
30000	29997,0	3,0	4,50

- Độ không đảm bảo đo với hệ số phủ k = 2, mức tin cậy xấp xỉ 95%

(The uncertainty with coverage factor k = 2, at 95% confidence level)

- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
(This measuring instrument is not used for quantifying goods and services in trading, payment, safety assurance, communityhealth protection, environmental protection, inspection, inspection and assessment, law and in other public service activities)
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
(This measuring instrument is not to be used directly for the verification of group 2 measuring instruments)

LTA VIET NAM

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)

Địa Chỉ: Số Nhà 18 TT33 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội

Địa Chỉ : 37/9 Đường Số 10, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, HCM

Phone: 0933.17.6699 Website: ltavietnam.com

Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ACCREDITED ISO/IEC 17025 LABORATORY

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Khách Hàng:	**CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**	**Số báo giá:**	**LTAVN_S07046**
Địa Chỉ:	**LÔ CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương**	**Người Phụ Trách:**	**Mr. Sơn**
Người Liên Hệ:		**Số Điện Thoại:**	**0389282789**
Số Điện Thoại:		**Ngày nghiệm thu:**	**30/05/2025**

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. LTA Việt Nam chúng tôi chuyên:

- Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, kiểm định - huấn luyện an toàn lao động.

- Sửa chữa - cho thuê máy đo 2D, 3D

- Phân phối thiết bị đo lường: Máy đo 2D,3D - hãng AUSKY, Máy đo độ cứng - hãng Laihua, thiết bị đo hãng Victor.....

- Đào tạo hiệu chuẩn nội bộ, đào tạo sử dụng thiết bị đo lường

- Thu mua thiết bị đo lường đã qua sử dụng

Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng biên bản nghiệm thu như sau:

STT	Tên Thiết Bị *(Model name)*	Số Lượng *(Qty)*	Số Seri *(Seri number)*	Chú ý *(Remark)*
1	Máy quét mã vạch	01		
2	Máy đo độ ẩm cầm tay	01		
3	Máy đo lực kéo nén cầm tay	01		
4	Thước cặp điện tử	02		
5				
6				
7				
8				

GHI CHÚ: Đã hiệu chuẩn và dán tem hiệu chuẩn.

THANH TOÁN:

Theo STK: CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

STK: 1103888888 tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh Hà Nội

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Nguyễn Trường An

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

Nguyễn Văn Sơn

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
VPHN: Số Nhà 46, Ngõ 262B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
LTA VPHCM: Số 25, Đường 27, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước. TP Thủ Đức
Phone: 0933.17.6699 Website: http://ltavietnam.com Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ACCREDITED ISO/IEC 17025 LABORATORY

BÁO GIÁ / *QUOTATION SHEET*

KHÁCH HÀNG *(TO)*:	CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**BÁO GIÁ** *(QUOTE NO)* :	LTAVN_S07046
ĐỊA CHỈ *(ADDRESS)*:	Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương	**NGÀY BÁO GIÁ** *(QUOTE DATE)*:	27/05/2025
NGƯỜI LIÊN HỆ *(CONTACT)*:		**NGƯỜI BÁO GIÁ** *(SALE BY)*:	Lý Diệu Linh
SỐ ĐIỆN THOẠI *(PHONE NUMBER)*:		**SỐ ĐIỆN THOẠI** *(PHONE NUMBER)*:	098.184.3088
Email:		**Email**:	dieulinhltavn@gmail.com

Cảm ơn Qúy khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng gửi tới Qúy khách hàng báo giá như sau:
(Thank you for your interest in our product/services. We would like to send our customers the following quotation)

STT	Sản phẩm / Dịch vụ	Mô tả chi tiết	Số lượng		Đơn giá	Số tiền	Ghi chú
1	[HC] Hiệu chuẩn	[HC] Hiệu chuẩn máy quét mã vạch	1,00	PC	600.000,00	600.000 ₫	
2	[HC] Hiệu chuẩn	[HC] Hiệu chuẩn máy đo độ ẩm cầm tay	1,00	PC	500.000,00	500.000 ₫	
3	[HC] Hiệu chuẩn	[HC] Hiệu chuẩn máy đo lực kéo nén cầm tay	1,00	PC	500.000,00	500.000 ₫	
4	[HC] Hiệu chuẩn	[HC] Hiệu chuẩn thước cặp điện tử	2,00	PC	250.000,00	500.000 ₫	

Tổng chưa thuế	2.100.000 ₫
Thuế	168.000 ₫
Tổng tiền	2.268.000 ₫

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(Account name: LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
STK: 1103888888 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB - Chi Nhánh Hà Nội
(Account number: 1103888888 Commercial joint stock bank ACB Ha Noi branch)

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
(ORDER CONFIRMATION)

HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION)

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC
Phạm Hữu Trường

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

***Kính gửi*: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

- Căn cứ báo giá số LTAVN_S07046 *ký ngày 27/05/2025 giữa Công ty TNHH Hiệu Chuẩn LTA Việt Nam và CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM về dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị.*

- Căn cứ vào biên bản nghiệm thu ký ngày 30 / 05 /2025

- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Theo báo giá, Công ty TNHH Hiệu chuẩn LTA Việt Nam đề nghị Quý Công ty thanh toán số tiền là: **2.268.000 đồng** *(Bằng chữ*: ***Hai triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng./.)***

Công ty chúng tôi đề nghị Quý Công ty thanh toán theo số tài khoản sau:

Công ty TNHH Hiệu Chuẩn LTA Việt Nam

Số Tài khoản: 1103888888

Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu ACB - Chi nhánh Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

M.S.D.N: 0108642725 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Trường

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 2025

序号 STT	器具名称 Tên thiết bị	生产厂商 Nhà sản xuất	Số lượng 总量	量具编号 Mã số thiết bị	Sổ chứng nhận	型号规格 Quy cách	校准周期 Chu kỳ hiệu chuẩn	下次检定时间 Thời gian kiểm định lần sau	送检计划 Kế hoạch đưa kiểm		备注 Ghi chú
									计划时间 Thời gian theo kế hoạch	实施时间 Thời gian thực hiện	
1	Thước cặp 150 mm	C-MART	1	500-196-30	BB23485250	150 mm	1 năm	2025年5月30日	2026年4月30日		
2	Thước cặp 150 mm	N/A	1	PXT0225-03	A24181985	150 mm	1 năm	2025年5月30日	2026年4月30日		
3	Máy đo lực kéo	FM-200N	1	PXT0225-05	2023012902		1 năm	2025年5月30日	2026年4月30日		
4	Máy đo độ ẩm	M70-D	1	7D6127			1 năm	2025年5月30日	2026年4月30日		
5	Máy quét mã vạch			HC66UB240600056			1 năm	2025年5月30日	2026年4月30日		
6	Cân điện tử	China	1	ACS-JH7	2025050602	30kg	1 năm	2025年5月6日	2026年4月6日		
7	Cân điện tử	China	1	UCA-N	NV2304161	30kg	1 năm	2025年5月6日	2026年4月6日		
8	Cân điện tử	China	1	XK3190-A12+E	2025050602	30kg	1 năm	2025年5月6日	2026年4月6日		
9											
10											

制表 Người lập biểu:

批准 Phê duyệt：

S.G.C.N:4620450000[illegible] CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM TP. THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

TOP WIN VIETNAM CO., LTD	**BIỂU MẪU** **KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ**	Mã số: BM.7.3 Lần ban hành: 01 Ngày BH: 04/01/2022 Trang: 1/1
	CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**TCVN ISO 9001:2015**

Mã thiết bị	Tên thiết bị	Hằng ngày	Hằng tuần	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Ghi chú
001	Máy cắt	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần
002	Máy dập	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần
003	Máy mài	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần
004	Máy phun	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần
005	Máy cưa	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần
006	Máy bào	KT	BT	KĐ												Kiểm định tần suất 12 tháng/ lần

Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2025
Phê duyệt

CÔNG TY TNHH BG TECH VIỆT NAM (ĐK 429)

BG TECH VIETNAM LIMITED COMPANY

Địa chỉ (add): Ninh Khánh, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên Tỉnh Bắc Giang.

Điện Thoại (Tel) 0204.360.3568

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số (No): BG250530-01

Tên đối tượng (Object): Máy quét mã vạch

Kiểu (Type): N/A

Số (Serial No.)/ Mã QL(Tag No): HC66UB240600056 / N/A

Nơi sản xuất (Manufacturer): N/A

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification):

Tham khảo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất / Refer to the manufacturer's specifications

Cơ sở sử dụng (Customer): CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ (Address): Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương

Phương pháp thực hiện (Method of calibration): Manufacturer Specification

Chuẩn được sử dụng (Standards used):

Chuẩn được liên kết đến hệ đơn vị quốc tế SI
(Standards are traceable to the internal system of unit SI)
Thiết bị đo nhiệt độ,độ ẩm(Humidity Probe)
Thiết bị được liên kết đến : Quatest 3
Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tới 31/01/2026
Thước kẹp
Thiết bị được liên kết đến : Chuẩn BGTECH (ĐK-429)
Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tới 31/01/2026

Kết quả (Results): Xem kết quả trang sau (Seeing results in the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibration recommended): 30/05/2026

Ngày 30 Tháng 05 Năm 2025

(Date of issue)

Trưởng phòng thí nghiệm	**THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC**
(Head of calibration Laboratory)	(Director)
Hoàng Thị Hường	**Lê Văn Thạch**

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY TNHH BG TECH VIỆT NAM

(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)
Số biên bản/Report No : BG250530-01

Nơi sản xuất (Manufacturer): N/A **Kiểu (Type):** N/A

Số (Serial No): HC66UB240600056 **Mã QL (Tag No):** N/A

Kết quả hiệu chuẩn / Results of Calibration.

Function *Chức năng*	**Gía trị chuẩn** *Standard Value*	**Đơn vị** *Unit*	**Giá trị đo** *TI Value*
Kiểm tra tiếng "Beep"	**On**	/	**On**
	OFF	/	**OFF**
Kiểm tra màn hình LCD	**On**	/	**On**
	OFF	/	**OFF**

2.Kiểm tra mã code

Function *Chức năng*	**Gía trị chuẩn** *Standard Value*	**Đơn vị** *Unit*	**Giá trị đo** *TI Value*
Kiểm tra giá trị	**123456789**	/	**123456789**
	ABCDEFGHI	/	**ABCDEFGHI**
	69886815278	/	**69886815278**
	AD67067NYD8	/	**AD67067NYD8**

Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.

Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

Độ không đảm bảo đo được báo cáo dựa trên độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2,00, cung cấp mức độ tin cậy khoảng 95%

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence of approximately 95 %

Môi trường hiệu chuẩn (Calibration environment):

Temperature (Nhiệt độ) : 22.1 °C

Humidity (Độ ẩm) : 45.8 % RH

Giá trị của thiết bị được kiểm tra. / Test Intrusment Value (TI Value).

☒ Dung sai : dựa trên thông số kĩ thuật của nhà sản xuất./ Tolerance : base on Manufacturer's Specifications.

☐ Dung sai : theo yêu cầu của khách hàng. / Tolerance according to customer's request.

Sai số = giá trị của thiết bị được hiệu chuẩn trừ cho giá trị chuẩn. / Error = TI Value - Standard Value.

Nhỏ nhất / Lớn nhất: Phạm vi mà giá trị đơn vị được kiểm tra phải nằm trong điều kiện này là Đạt.

Min / Max: The range of values that the Device is testing must be in this condition to Pass.

Tuyên bố Đạt hay Không Đạt./ Statements of Pass or Fail.

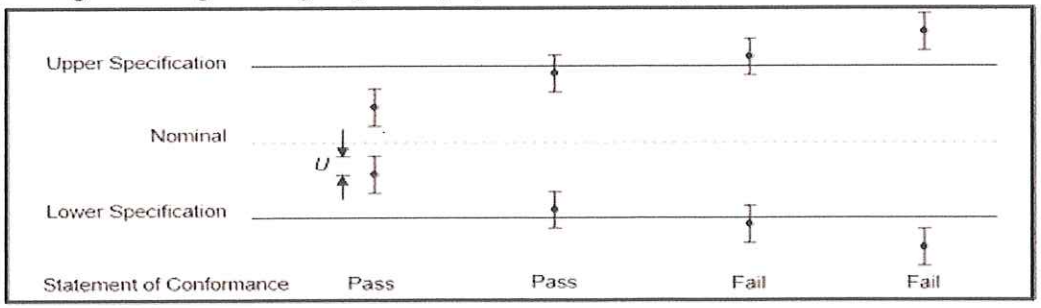
Độ không đảm bảo đo đã được tính đến khi xác định sự phù hợp với đặc tính kĩ thuật theo ILAC-G8:09/2019. /

The uncertainty of measurement has been taken into account when determining compliance with specification as per ILAC-G8:09/2019

Tình trạng tuân thủ các tiêu chí trong báo cáo là. / The status of compliance with the acceptance criteria is reported as:

ĐẠT - Giá trị đo trung bình nằm trong khoảng dung sai cho phép. / PASS - Average measured value is within tolerance.

KHÔNG ĐẠT - Giá trị đo trung bình nằm ngoài khoảng dung sai cho phép. / FAIL - The average measured value is out of tolerance.



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY TNHH BG TECH VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization)

LTA VIET NAM
ĐK 466

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
Địa Chỉ:Số Nhà 46, Ngõ 262B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0933.17.6699 **Website:** ltavietnam.com
Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ilac-MRA AOSC
VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số GCN(No.): **LTA.S07046-01**

Tên phương tiện đo *(Equipment name)* : Thước cặp điện tử *(Electronic Caliper)*
Kiểu *(Type)* : 500-196-30 **Số seri** *(Serial no)* : BB23485250
Nơi sản xuất *(Manufacturer)* : Mitutoyo - Japan
Thông số kỹ thuật *(Technical Specification)* : Phạm vi đo: (0 ~ 150) mm
Độ phân giải: 0,01 mm

Cơ sở sử dụng *(Customer used)* : **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

Địa chỉ *(Address)* : **Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương**

Phương pháp thực hiện *(Method of Calibration)* : LTAVN-PP03

Dưỡng chuẩn sử dụng *(Master used)* :

Tên thiết bị *(Equipment name)*	Kiểu *(Type)*	Số seri *(Serial)*	Cấp chính xác *(Accuracy)*	Nhà SX *(Maker)*	LK Chuẩn *(Traceability)*
Bộ kiểm Caliper	515-555	84736	Cấp 0	Mitutoyo	ĐLQĐ

Điều kiện môi trường *(Environmental Conditions)* :
Nhiệt độ *(Temperature)* : 21°C Độ ẩm *(Humidity)* : 40-60% RH
Địa điểm thực hiện *(Location of calibration)*: Hiện trường *(On site)*
Kết quả *(Results)* : Xem trang sau
Người hiệu chuẩn *(Calibration personal)* : Nguyễn Văn Sơn
Số tem hiệu chuẩn *(Label no)* : LTA.S07046-01
Ngày hiệu chuẩn *(Date of Cal.)* : 30/05/2025
Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recalibration Recommended)* : 30/05/2026

Hà Nội, ngày*(date)* 30 tháng*(month)* 05 năm*(year)* 2025

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of Calibration Laboratory)

NGUYỄN VĂN SƠN

Giám Đốc
(Director)

M.S.D.N:0108642725-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM HỮU TRƯỜNG

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration result)

VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

Số GCN(No.): LTA.S07046-01

Sai số thiết bị *(Instrumental error)* (mm)

Độ chính xác *(Accuracy)*: ±0,02mm

Khoảng *(Range)*	**Giá trị chỉ thị mỏ đo trong** *(Inducated Value)*	**Kết quả sai số mỏ đo trong** *(External measurement mean error result)*	**Giá trị chỉ thị mỏ đo ngoài** *(Inducated Value)*	**Kết quả sai số mỏ đo ngoài** *(Internal measurement mean error result)*
10	10,00	0,00	10,00	0,00
50	50,00	0,00	50,00	0,00
100	100,00	0,00	100,00	0,00
150	150,00	0,00	150,00	0,00

Giấy chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị ở trên đã được hiệu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 theo các thủ tục tham chiếu.

(This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Standard System Requirement of ISO/IEC 17025:2017, in accordance with referenced procedures)

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ k=2.

(The expanded uncertainly is calculated with confidence level at 95% and coverage factor k=2)

LTA VIỆT NAM

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

LTA VIET NAM
ĐK 466

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
Địa Chỉ:Số Nhà 46, Ngõ 262B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0933.17.6699 **Website:** ltavietnam.com
Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ilac-MRA AOSC
VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số GCN(No.): **LTA.S07046-02**

Tên phương tiện đo *(Equipment name)* : Thước cặp điện tử *(Electronic Caliper)*
Kiểu *(Type)* : 500-196-30 **Số seri** *(Serial no)* : A24181985
Nơi sản xuất *(Manufacturer)* : Mitutoyo - Japan
Thông số kỹ thuật *(Technical Specification)* : Phạm vi đo: (0 ~ 150) mm
Độ phân giải: 0,01 mm

Cơ sở sử dụng *(Customer used)* : **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

Địa chỉ *(Address)* : **Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương**

Phương pháp thực hiện *(Method of Calibration)* : LTAVN-PP03

Dưỡng chuẩn sử dụng *(Master used)* :

Tên thiết bị *(Equipment name)*	Kiểu *(Type)*	Số seri *(Serial)*	Cấp chính xác *(Accuracy)*	Nhà SX *(Maker)*	LK Chuẩn *(Traceability)*
Bộ kiểm Caliper	515-555	84736	Cấp 0	Mitutoyo	ĐLQĐ

Điều kiện môi trường *(Environmental Conditions)* :
Nhiệt độ *(Temperature)* : 21°C Độ ẩm *(Humidity)* : 40-60% RH
Địa điểm thực hiện *(Location of calibration)*: Hiện trường *(On site)*
Kết quả *(Results)* : Xem trang sau
Người hiệu chuẩn *(Calibration personal)* : Nguyễn Văn Sơn
Số tem hiệu chuẩn *(Label no)* : LTA.S07046-02
Ngày hiệu chuẩn *(Date of Cal.)* : 30/05/2025
Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recalibration Recommended)* : 30/05/2026

Hà Nội, ngày*(date)* 30 tháng*(month)* 05 năm*(year)* 2025

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of Calibration Laboratory)

NGUYỄN VĂN SƠN

Giám Đốc
(Director)

M.S.D.N:0108642725-C.T.T.N.H.H. CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM HỮU TRƯỜNG

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration result)

VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

Số GCN(No.): LTA.S07046-02

Sai số thiết bị *(Instrumental error)* (mm)

Độ chính xác *(Accuracy):* ±0,02mm

Khoảng *(Range)*	**Giá trị chỉ thị mỏ đo trong** *(Inducated Value)*	**Kết quả sai số mỏ đo trong** *(External measurement mean error result)*	**Giá trị chỉ thị mỏ đo ngoài** *(Inducated Value)*	**Kết quả sai số mỏ đo ngoài** *(Internal measurement mean error result)*
10	10,00	0,00	10,00	0,00
50	50,00	0,00	50,00	0,00
100	100,00	0,00	100,00	0,00
150	150,00	0,00	150,00	0,00

Giấy chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị ở trên đã được hiệu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 theo các thủ tục tham chiếu.

(This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Standard System Requirement of ISO/IEC 17025:2017, in accordance with referenced procedures)

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ k=2.

(The expanded uncertainly is calculated with confidence level at 95% and coverage factor k=2)

LTA VIET NAM

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

LTA VIET NAM
ĐK 466

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
Địa Chỉ:Số Nhà 46, Ngõ 262B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0933.17.6699 **Website:** ltavietnam.com
Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ilac-MRA AOSC
VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số GCN(No.)**: LTA.S07046-03**

Tên phương tiện đo *(Equipment name)* : Máy đo lực kéo*(Push/pull tester)*

Kiểu *(Type)* : FM-200N **Số seri** *(Serial no)* : 2023012902

Nơi sản xuất *(Manufacturer)* : YTEC

Thông số kỹ thuật *(Technical Specification)* : Phạm vi đo: 0 ~ 20 kgf

Cơ sở sử dụng *(Customer used)* : **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

Địa chỉ *(Address)*: **Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương**

Phương pháp thực hiện *(Method of Calibration)* : LTAVN-PP47

Dưỡng chuẩn sử dụng *(Master used)* :

Tên thiết bị *(Equipment name)*	Kiểu *(Type)*	Cấp chính xác *(Accuracy)*	Nhà SX *(Maker)*	LK Chuẩn *(Traceability)*
Bộ quả cân F1	Trụ tròn	Cấp 1	Thụy Sỹ	ĐLQĐ

Điều kiện môi trường *(Environmental Conditions)* :

Nhiệt độ *(Temperature)* : 21°C Độ ẩm *(Humidity)* : 40-60% RH

Địa điểm thực hiện *(Location of calibration)* : Hiện trường *(On site)*

Kết quả *(Results)* : Xem trang sau

Người hiệu chuẩn *(Calibration personal)* : Nguyễn Văn Sơn

Số tem hiệu chuẩn *(Label no)* : LTA.S07046-03

Ngày hiệu chuẩn *(Date of Cal.)*: 30/05/2025

Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recalibration Recommended)* : 30/05/2026

Hà Nội, ngày*(date)* 30 tháng*(month)* 05 năm*(year)* 2025

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of Calibration Laboratory)

NGUYỄN VĂN SƠN

Giám Đốc
(Director)

M.S.D.N: 0108642725 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM HỮU TRƯỜNG

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration result)

VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

Số GCN(No.): LTA.S07046-03

Sai số thiết bị *(Instrumental error)*

STT *(No.)*	**Khoảng** *(Range)*	**Giá trị chỉ thị** *(Inducated Value)*	**Số hiệu chính** *(Corected Value)*	**Độ chính xác** *(Accuracy)*
Lực nén/ *Force push* (Kgf)				
1	**1,0**	1,0	0,0	**±0,5%**
2	**2,0**	2,0	0,0	**±0,5%**
3	**5,0**	5,0	0,0	**±0,5%**
4	**10,0**	10,0	0,0	**±0,5%**
5	**15,0**	15,0	0,0	**±0,5%**
6	**20,0**	20,0	0,0	**±0,5%**

Giấy chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị ở trên đã được hiệu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 theo các thủ tục tham chiếu.

(This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Standard System Requirement of ISO/IEC 17025:2017, in accordance with referenced procedures)

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ k=2.

(The expanded uncertainly is calculated with confidence level at 95% and coverage factor k=2)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

LTA VIET NAM
ĐK 466

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
(LTA VIET NAM CALIBRATION CO., LTD)
Địa Chỉ:Số Nhà 46, Ngõ 262B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0933.17.6699 **Website:** ltavietnam.com
Email: hieuchuanltavn@gmail.com

ilac-MRA AOSC
VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số GCN(No.)**: LTA.S07046-04**

Tên phương tiện đo *(Equipment name)* : Máy đo độ ẩm *(Moisture meter)*

Kiểu *(Type)* : M70-D **Số seri** *(Serial no)* : 7D6127

Nơi sản xuất *(Manufacturer)* : RIXEN

Thông số kỹ thuật *(Technical Specification)* : Độ ẩm : 5,5% ~ 99,9%

Cơ sở sử dụng *(Customer used)* : **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

Địa chỉ *(Address)*: **Lô CN1, Ô Số 1 Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương**

Phương pháp thực hiện *(Method of Calibration)* : LTAVN-PP01

Dưỡng chuẩn sử dụng *(Master used)* :

Tên thiết bị *(Equipment name)*	Kiểu *(Type)*	Cấp chính xác *(Accuracy)*	Nhà SX *(Maker)*	LK Chuẩn *(Traceability)*
Tủ vi khí hậu	LRH-100S	0,1°C 0,5%RH	Kenton	ĐLQĐ

Điều kiện môi trường *(Environmental Conditions)* :

Nhiệt độ *(Temperature)* : 21°C Độ ẩm *(Humidity)* : 40-60% RH

Địa điểm thực hiện *(Location of calibration)* : Phòng thí nghiệm LTA VIET NAM *(Lab of LTA VIET NAM)*

Kết quả *(Results)* : Xem trang sau

Người hiệu chuẩn *(Calibration personal)* : Nguyễn Văn Sơn

Số tem hiệu chuẩn *(Label no)* : LTA.S07046-04

Ngày hiệu chuẩn *(Date of Cal.)* : 30/05/2025

Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo *(Recalibration Recommended)* : 30/05/2026

Hà Nội, ngày*(date)* 30 tháng*(month)* 05 năm*(year)* 2025

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of Calibration Laboratory)

NGUYỄN VĂN SƠN

Giám Đốc
(Director)

M.S.D.N:0108642725-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẠM HỮU TRƯỜNG

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproducted except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration result)

VLAC 1.0403
ISO/IEC 17025:2017

Số GCN(No.): LTA.S07046-04

Sai số thiết bị *(Instrumental error)*

STT *(No)*	**Khoảng** *(Range)*	**Giá trị chỉ thị** *(Inducated Value)*	**Số hiệu chỉnh** *(Corected Value)*	**Độ chính xác** *(Accuracy)*
Độ ẩm/ *Humidity* (%)				
1	**10,0**	10,0	0,0	**±1%**
2	**20,0**	20,1	0,1	**±1%**
3	**40,0**	40,2	0,2	**±1%**
3	**60,0**	60,2	0,2	**±1%**

Giấy chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị ở trên đã được hiệu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 theo các thủ tục tham chiếu.

(This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Standard System Requirement of ISO/IEC 17025:2017, in accordance with referenced procedures)

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ k=2.

(The expanded uncertainly is calculated with confidence level at 95% and coverage factor k=2)

LTA VIET NAM

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của LTA VIỆT NAM
(This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of LTA VIỆT NAM)