Auswertebericht Kalibrierreihe

Quinoline Yellow · loujaune1.txt · 417 nm · erstellt 30.10.2026

Kennwerte

Stufen	9
Steigung a	35.353 L/mol
Achsenabschnitt b	0,0108
Bestimmtheitsmaß R^2	0,99986
Reststandardabweichung s_y	0,00768
RMSE Absorbanz	0,00677
RMSE Konzentration	$1{,}92 \cdot 10^{-7}$ mol/L
Nachweisgrenze (3,3·s_y/a)	$7{,}17 \cdot 10^{-7}$ mol/L
Bestimmungsgrenze (10·s_y/a)	$2{,}17 \cdot 10^{-6}$ mol/L

Befunde der Plausibilitätsprüfung (6)

Warnung	Linearität: Kurve flacht ab (Sättigung?): Krümmung -0.0163 Absorbanz
Warnung	Sättigung (Spektrum 8): A = 1.556 über Warngrenze 1.5 - Linearität in diesem Bereich prüfen, ggf. verdünnen
Warnung	Sättigung (Spektrum 9): A = 1.769 über Warngrenze 1.5 - Linearität in diesem Bereich prüfen, ggf. verdünnen
Warnung	Sättigung (Spektrum 10): A = 1.882 über Warngrenze 1.5 - Linearität in diesem Bereich prüfen, ggf. verdünnen
Hinweis	Drift: Bereich 720-750 nm nicht gemessen - Drift nicht prüfbar
Hinweis	Zuordnung (Spektrum 10): Spektrum ohne Konzentrationsangabe - nicht ausgewertet

Kein schwerer Fehler gefunden. 4 Warnungen bitte prüfen, bevor das Ergebnis verwendet wird.

Bewertung und Freigabe erfolgen durch die verantwortliche Person, nicht durch dieses Programm.
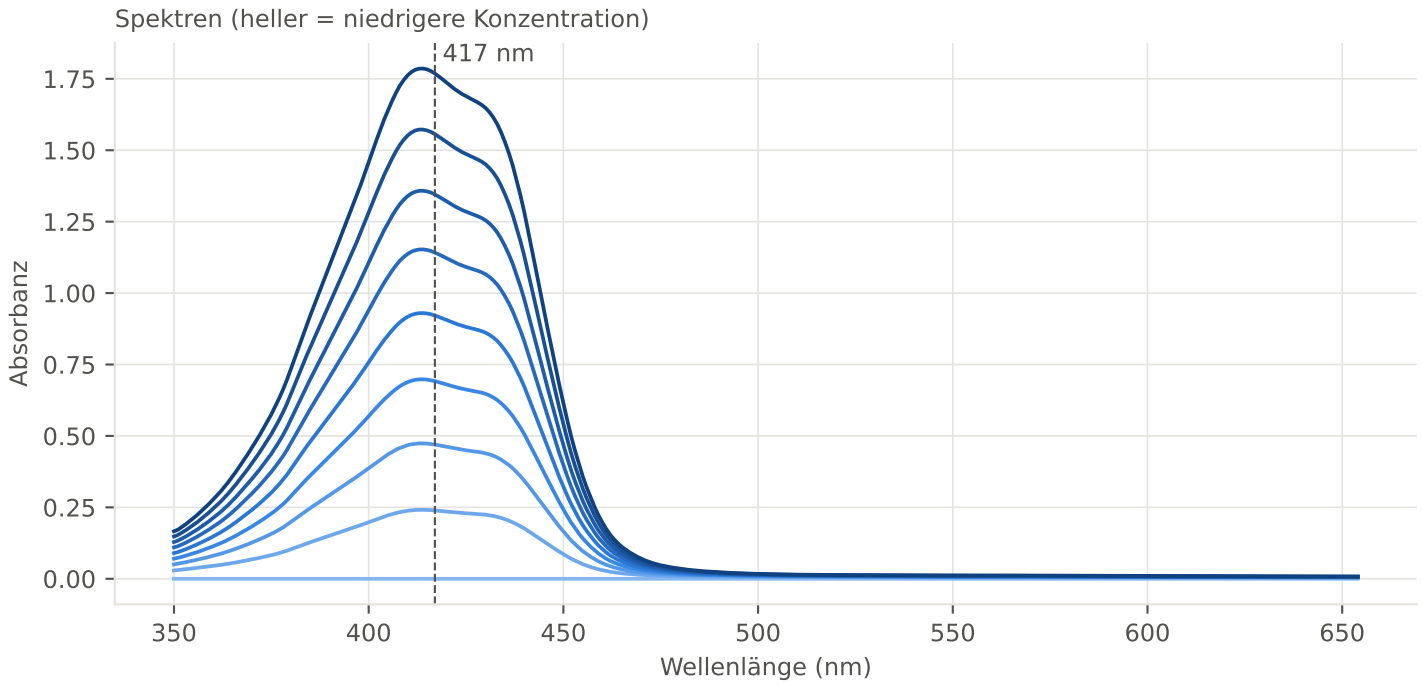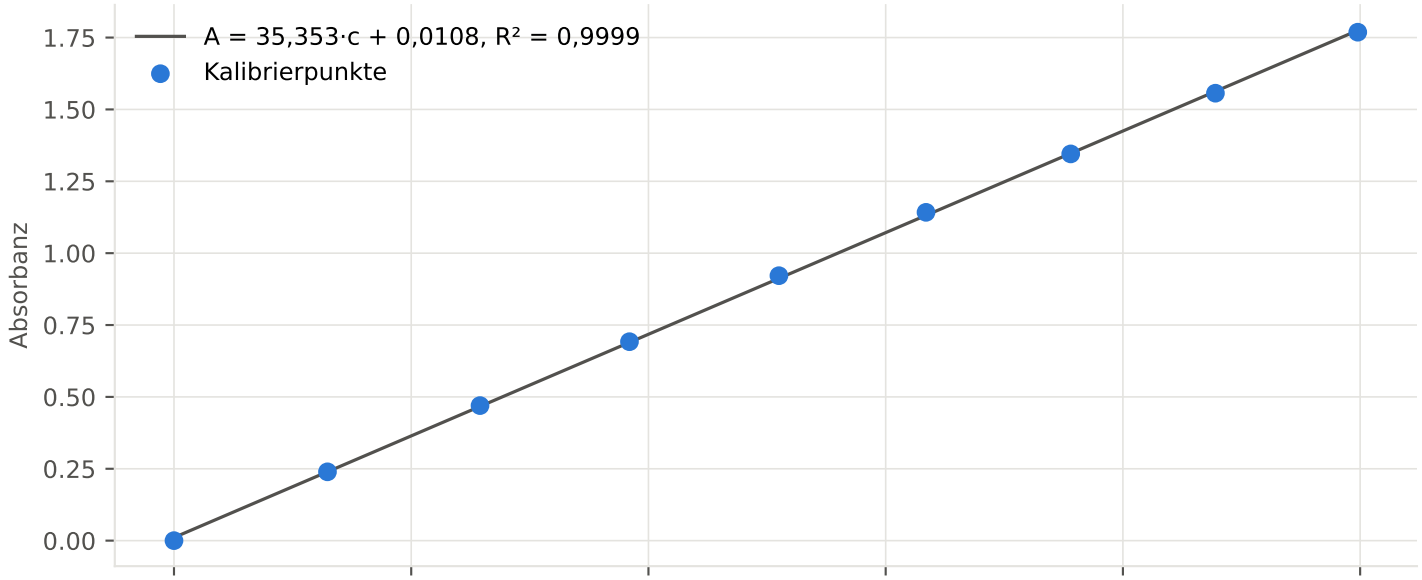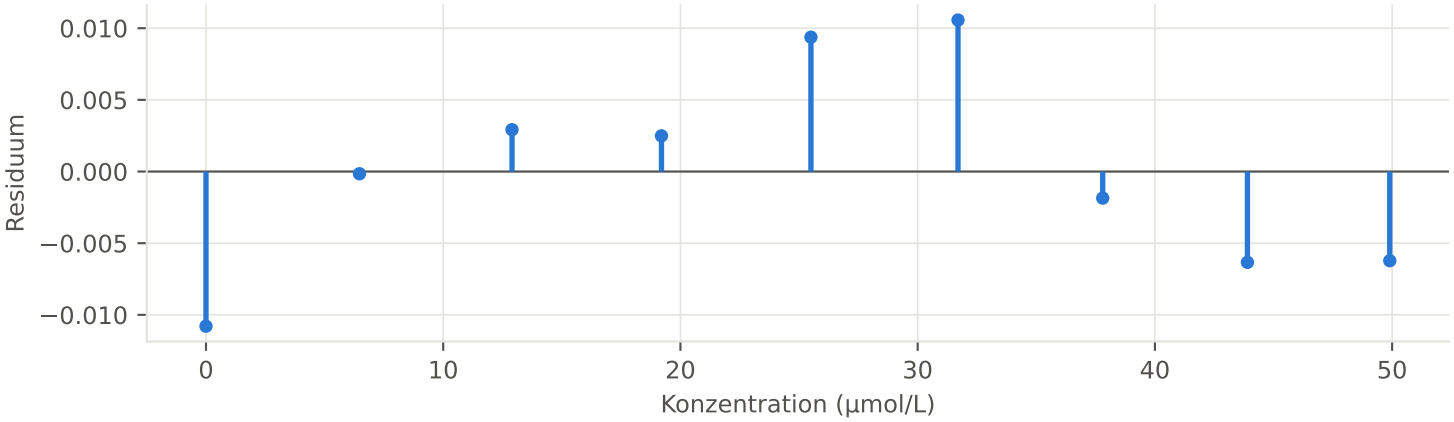
Spektren, Kalibriergerade, Residuen