Auswertebericht Kalibrierreihe

Fast Green FCF · louvert2.txt · 626 nm · erstellt 30.10.2026

Kennwerte

Stufen	9
Steigung a	52.496 L/mol
Achsenabschnitt b	0,00186
Bestimmtheitsmaß R^2	0,99988
Reststandardabweichung s_y	0,00222
RMSE Absorbanz	0,00196
RMSE Konzentration	$3{,}72 \cdot 10^{-8}$ mol/L
Nachweisgrenze (3,3·s_y/a)	$1{,}39 \cdot 10^{-7}$ mol/L
Bestimmungsgrenze (10·s_y/a)	$4{,}22 \cdot 10^{-7}$ mol/L

Befunde der Plausibilitätsprüfung (0)

Keine Auffälligkeiten.

Keine Auffälligkeiten gefunden.

Bewertung und Freigabe erfolgen durch die verantwortliche Person, nicht durch dieses Programm.
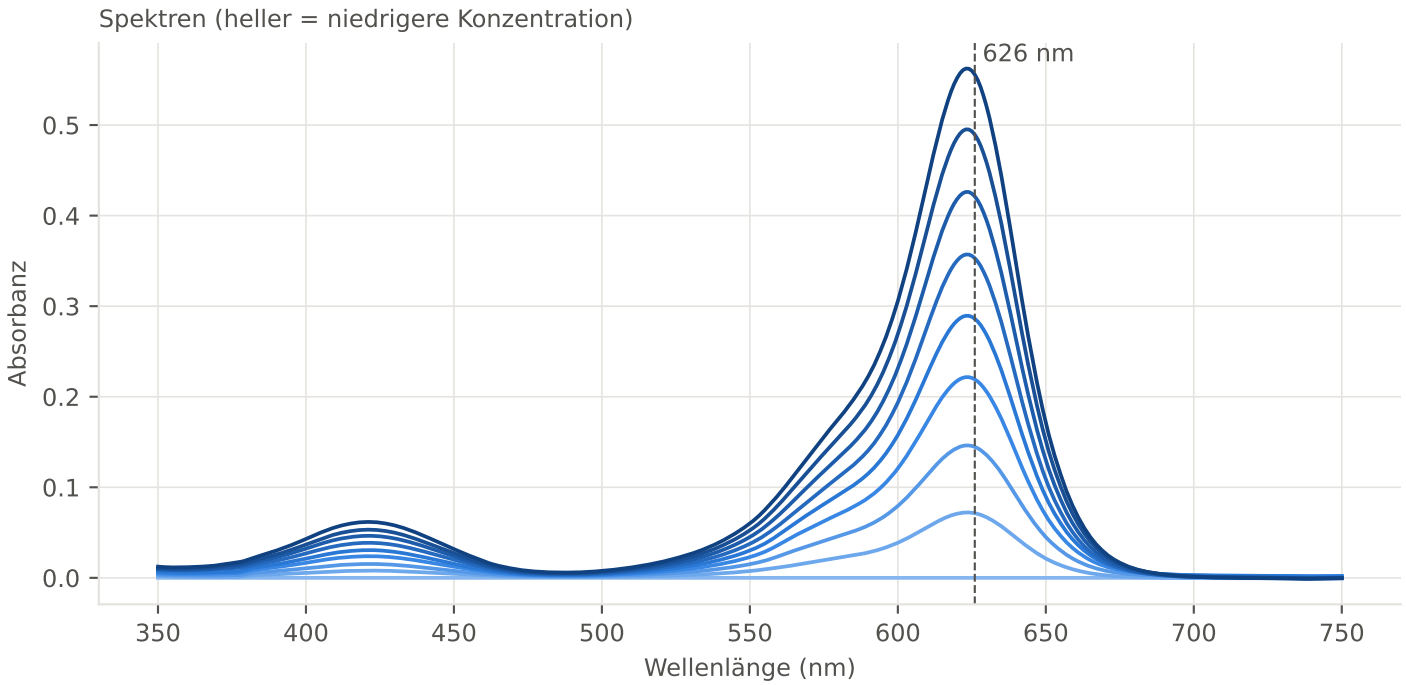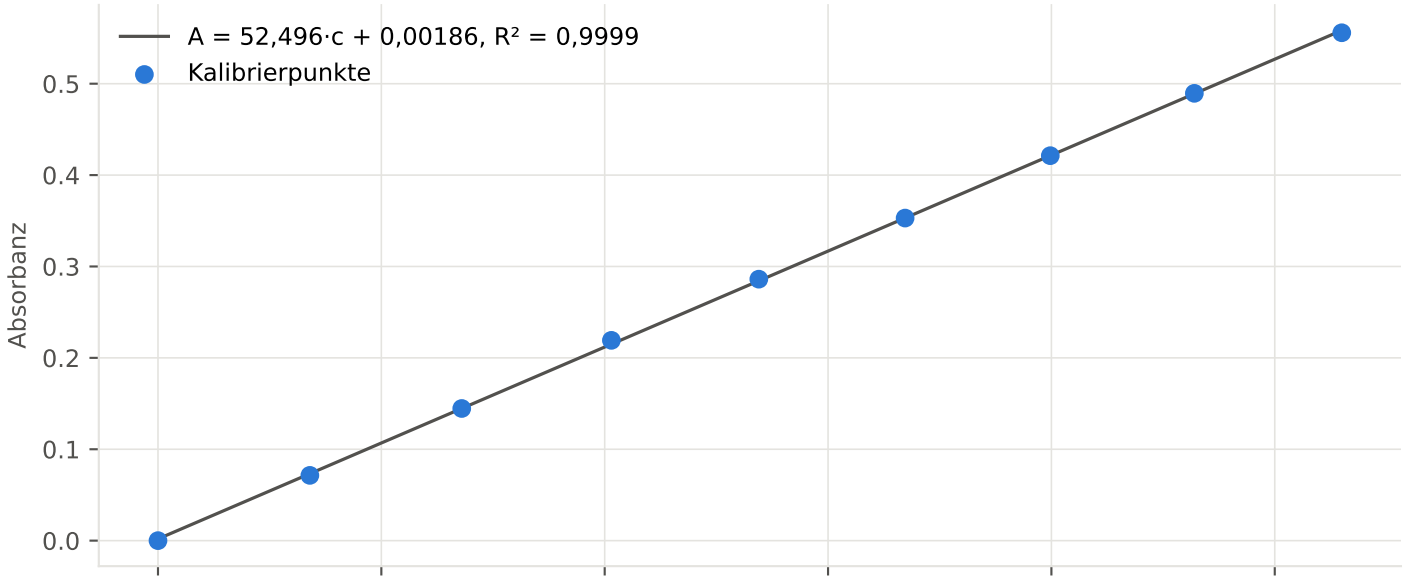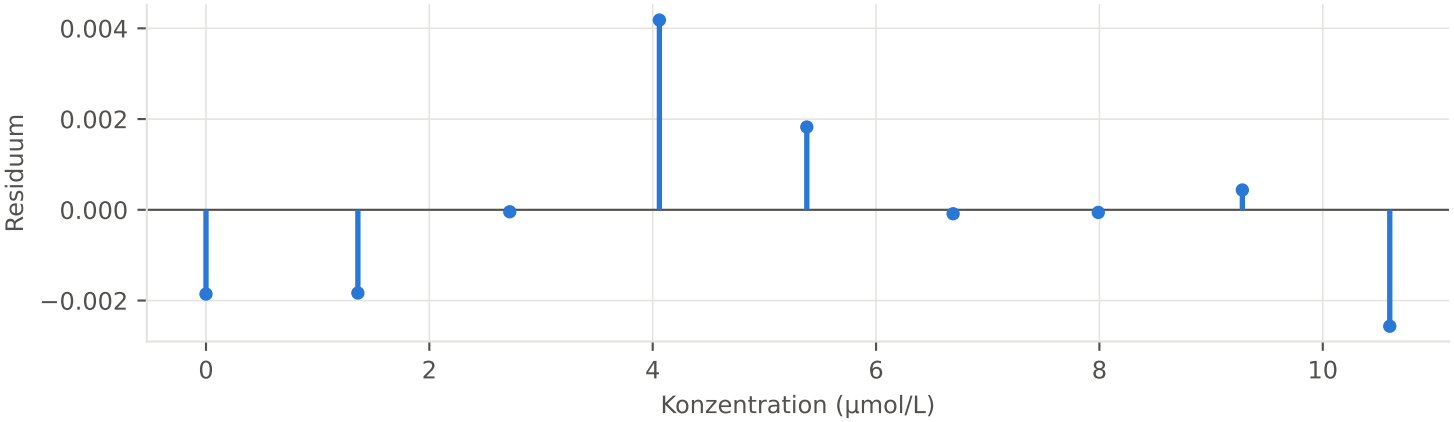
Spektren, Kalibriergerade, Residuen