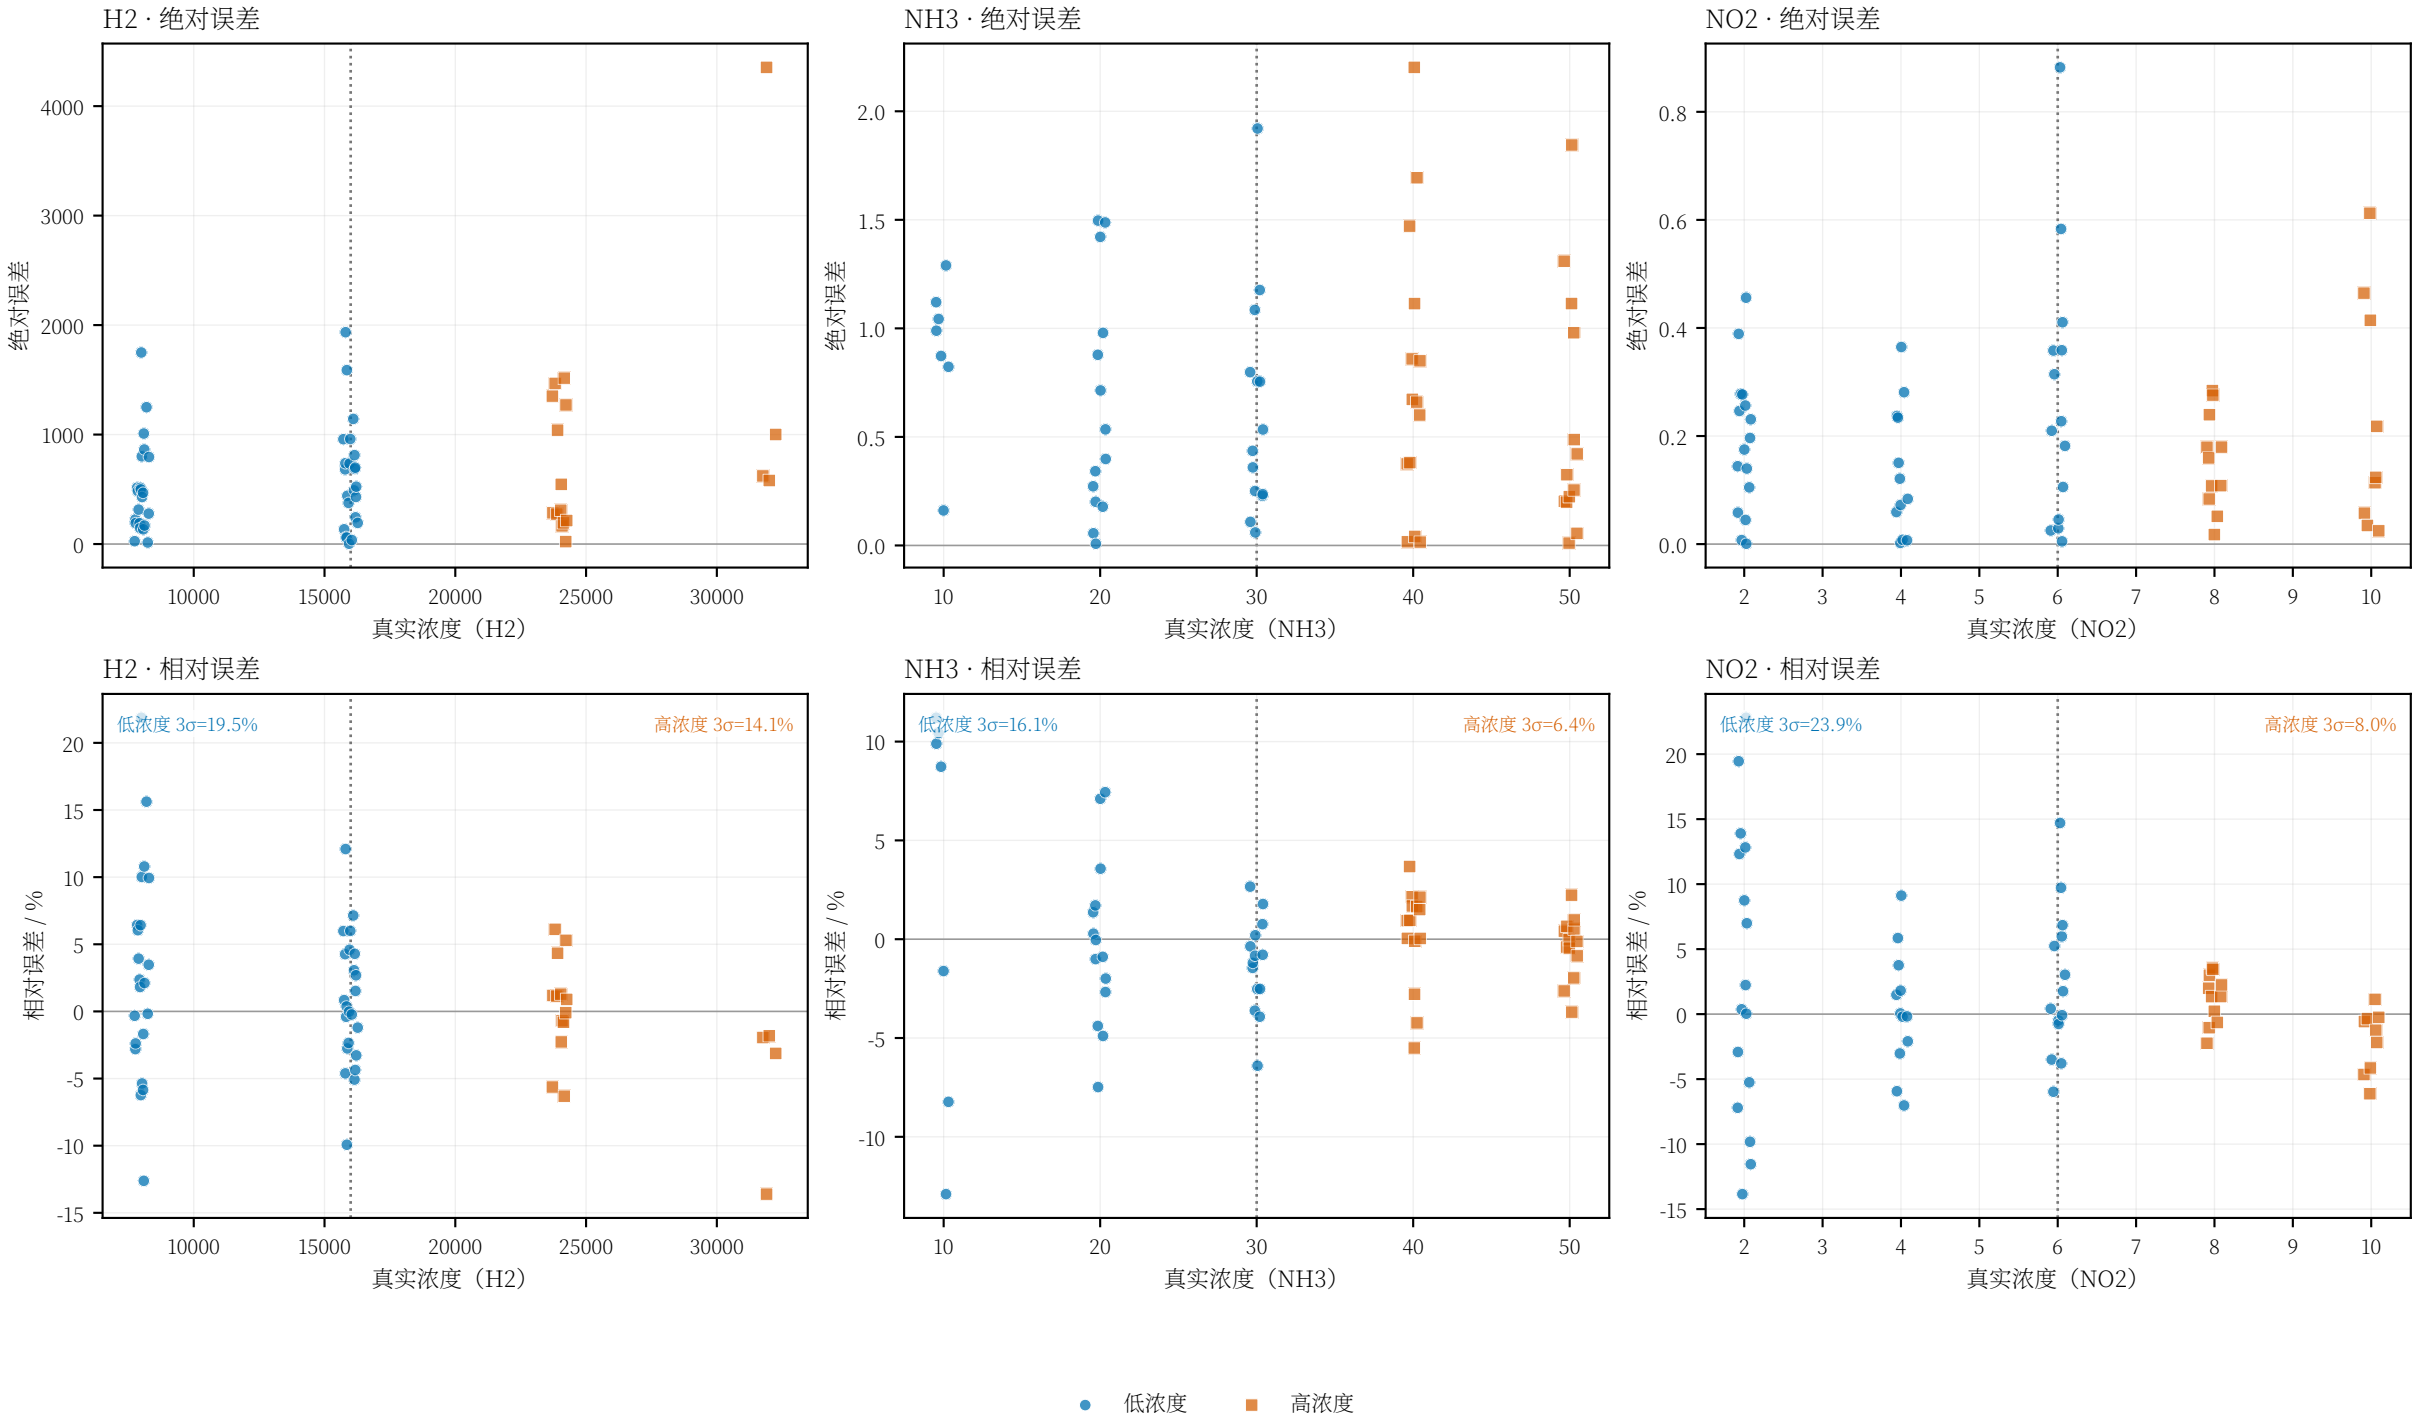
当前方案：绝对误差与相对误差随真实浓度的变化（62 点）
H2 · 绝对误差
NH3 · 绝对误差
NO2 · 绝对误差
绝对误差
真实浓度（H2）
真实浓度（NH3）
真实浓度（NO2）
H2 · 相对误差
NH3 · 相对误差
NO2 · 相对误差
相对误差 / %
低浓度 3σ=19.5%
高浓度 3σ=14.1%
低浓度 3σ=16.1%
高浓度 3σ=6.4%
低浓度 3σ=23.9%
高浓度 3σ=8.0%
低浓度
高浓度