



Certificado de Calibración **MLL-063-2026**

Orden de Trabajo :
M-REG-367

Laboratorio de Longitud y Ángulo

Fecha de Emisión :
2026-01-30

1.- Información del solicitante

Página 1 de 3

Nombre o Razon Social : SUN FIRE S.A.C.
Dirección : Pj. Jose Sanchez Lagomarcino Nro. 1745 Chacra Rios - Lima Lima, Perú.

2.- Información del Equipo

Descripción : MEDIDOR DE ESPESOR DIGITAL
Marca : YOWEXA
Modelo : EC-900
Serie : KU-00001-467 (*)
Identificación : NO INDICA
Rango de Medición : 0 μ m A 5000 μ m / 0 A 196,85 mils
Resolución : 0,1 / 1 μ m ; 0,001 / 0,01 mils

Los resultados del certificado son válidos sólo para el equipo o instrumento calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas aplicables al producto.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales y/o internacionales, los cuales realizan las unidades de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

3.- Fecha de Calibración : 2026-01-30

4.- Lugar de Calibración : Laboratorio de Longitud y Ángulo
METROMECANICA S.A.C.

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización escrita previa de METROMECANICA S.A.C.

5.- Método de Calibración

Procedimiento para la calibración de medidores de espesores por ultrasonido-DM-INACAL - Edición1- Setiembre 2019.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de METROMECANICA S.A.C.

6.- Condiciones Ambientales

Temperatura	Humedad
20,8 °C a 20,2 °C	65,9 % H.R a 64,7 % H.R.

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones se recomienda calibrar sus equipos o instrumentos a intervalos apropiados.



Certificado de Calibración **MLL-063-2026**

Laboratorio de Longitud y Ángulo

Página 2 de 3

7.- Trazabilidad

Código/ Serie	Equipo o Instrumento Patrón	Certificado de Calibración
45034541	Micrometro Digital	TC-18250-2024/DM-INACAL


8.- Resultados de Calibración

Medición de Espesores

Lámina Patrón (μm)	Lámina Patrón (mils)	Valor Leído Equipo (mils)	Corrección (mils)	Error Máximo Permitido $\pm$ (mils)	Incertidumbre (mils)
50,90	2,004	1,971	0,033	0,079	0,012
125,09	4,925	4,919	0,006	0,138	0,010
248,41	9,780	9,874	-0,094	0,237	0,023
485,49	19,114	19,13	-0,02	0,422	0,01
969,28	38,161	38,06	0,10	0,801	0,02

(**) Puntos de medición que superan la tolerancia del fabricante.

* Tolerancia establecida en las especificaciones del fabricante

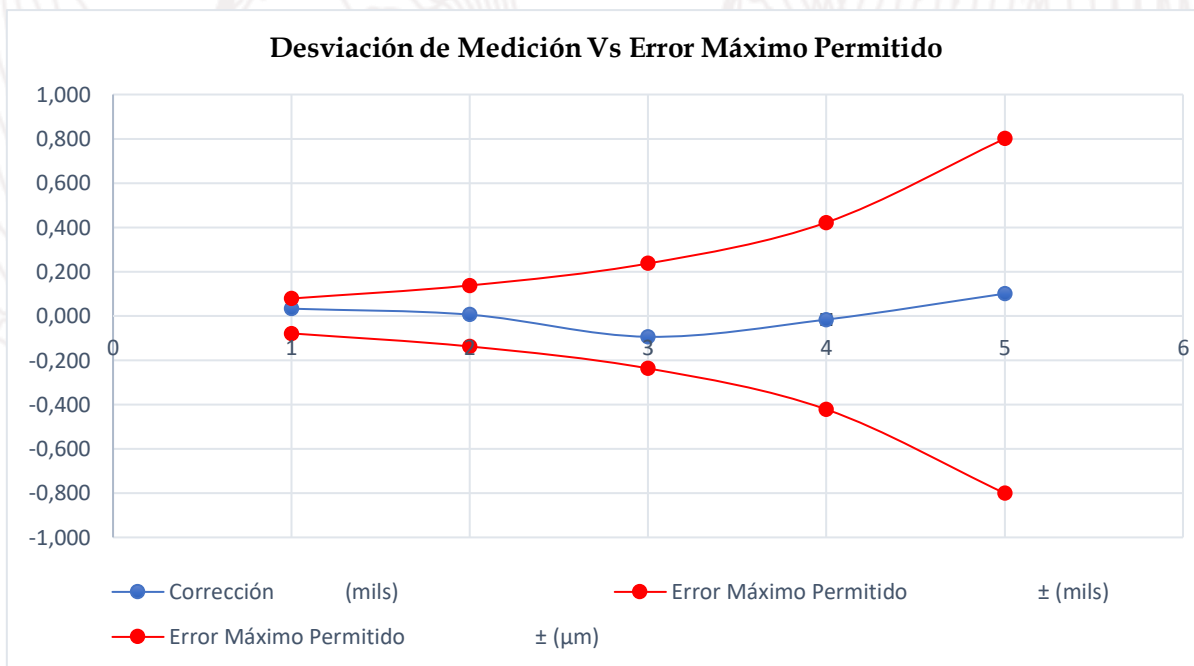



Certificado de Calibración **MLL-063-2026**

Laboratorio de Longitud y Ángulo

Página 3 de 3

La incertidumbre expandida de la medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura $k=2$, con una probabilidad de cobertura del 95% para una distribución normal.

9.- Observaciones y Recomendaciones

- * (*) Identificación hallada en la superficie del equipo.
- * Revisar periódicamente la hermeticidad del equipo y su operatividad .
- * Se colocó en la superficie del equipo una etiqueta autoadhesiva con la indicación de 'CALIBRADO', identificada con el código MLL-063-2026.

Fin del Documento