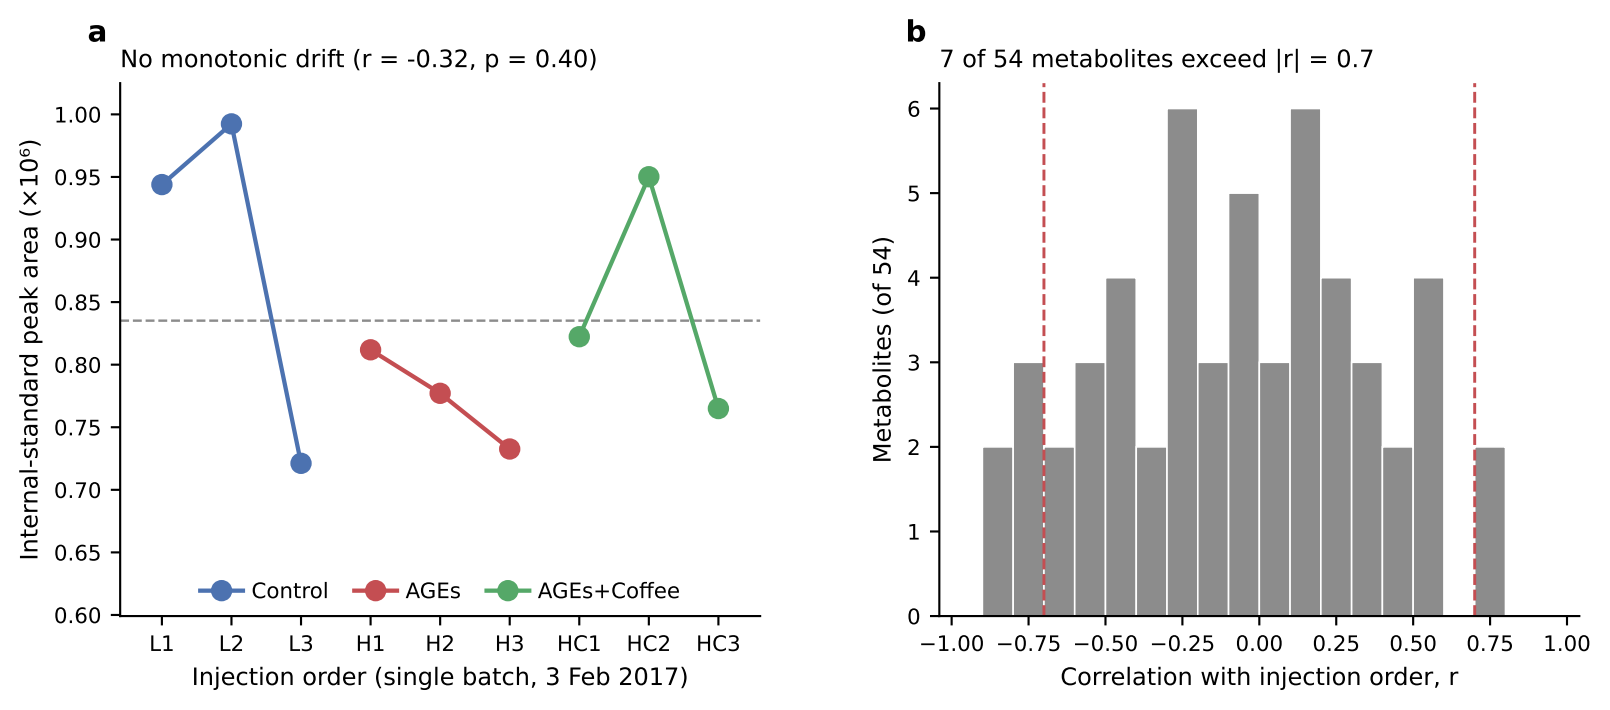
a
No monotonic drift (r = -0.32, p = 0.40)
Internal-standard peak area (×10⁶)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
Control
AGEs
AGEs+Coffee
L1
L2
L3
H1
H2
H3
HC1
HC2
HC3
Injection order (single batch, 3 Feb 2017)
b
7 of 54 metabolites exceed |r| = 0.7
Metabolites (of 54)
6
5
4
3
2
1
0
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Correlation with injection order, r