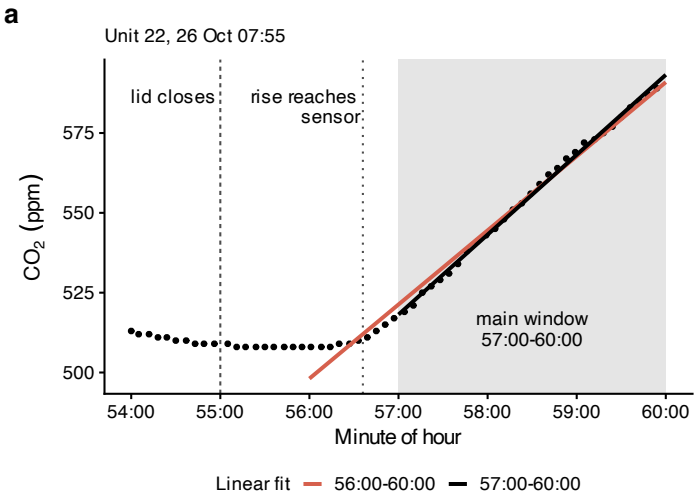

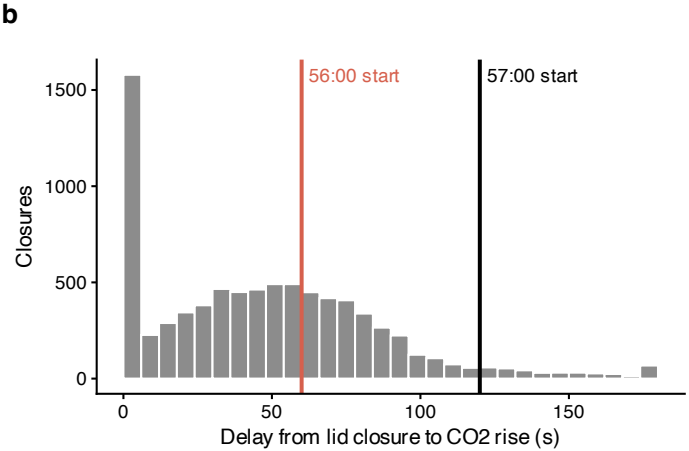

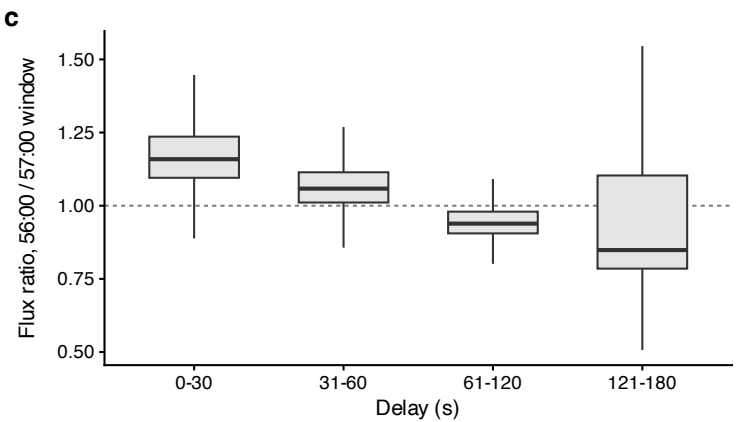

d

	56:00-60:00	**57:00-60:00 (main)**
Offset vs autochamber	+2.9%	-0.3%
r, hourly means	0.80	0.72
r, daily means	0.85	0.85
Diel amplitude (autochamber 26%)	43%	25%