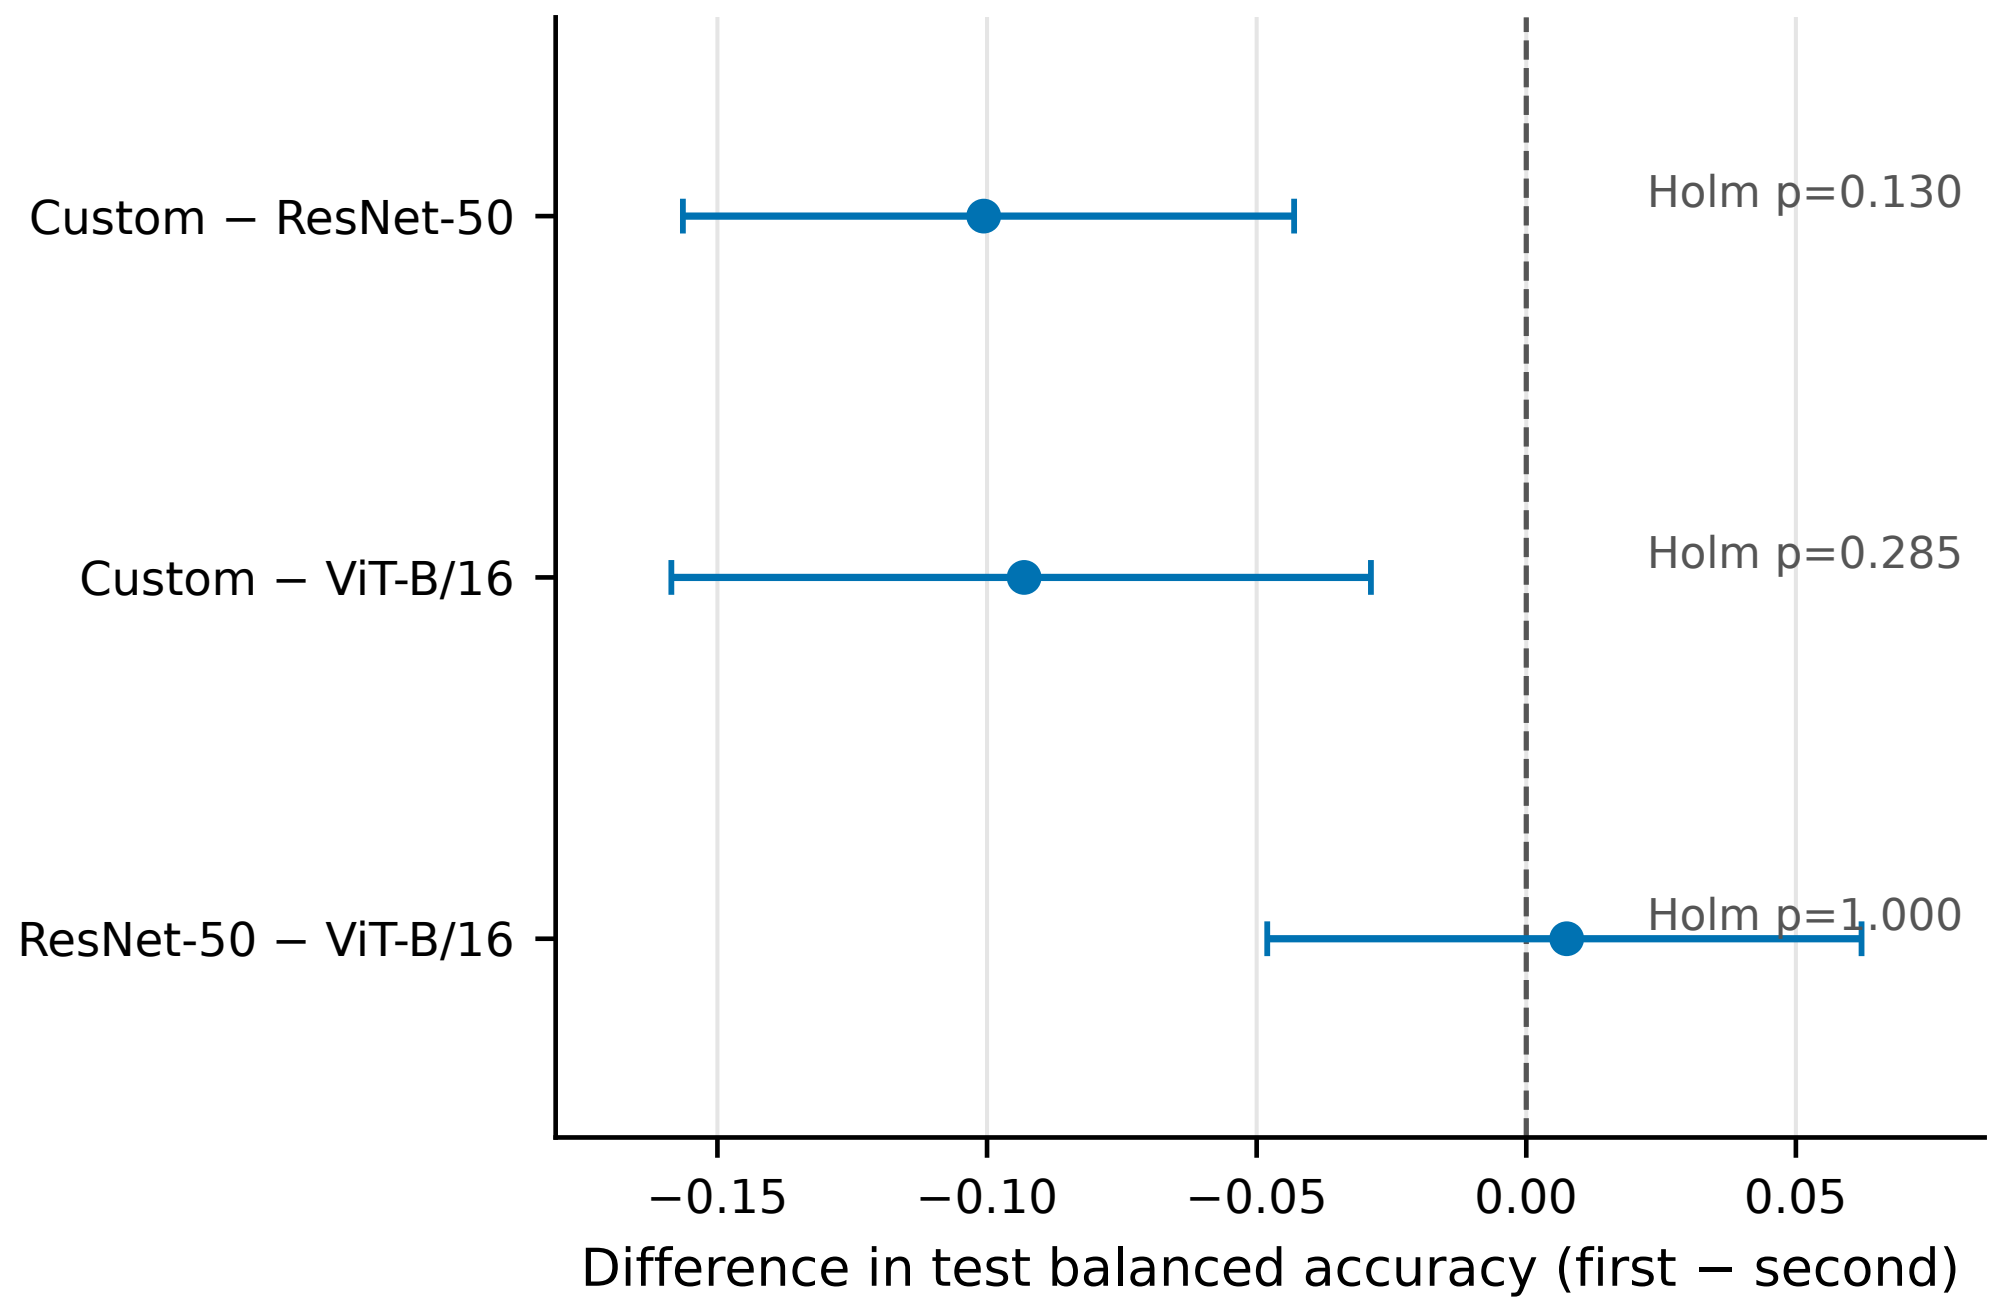
Custom − ResNet-50
Custom − ViT-B/16
ResNet-50 − ViT-B/16
Holm p=0.130
Holm p=0.285
Holm p=1.000
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
Difference in test balanced accuracy (first − second)