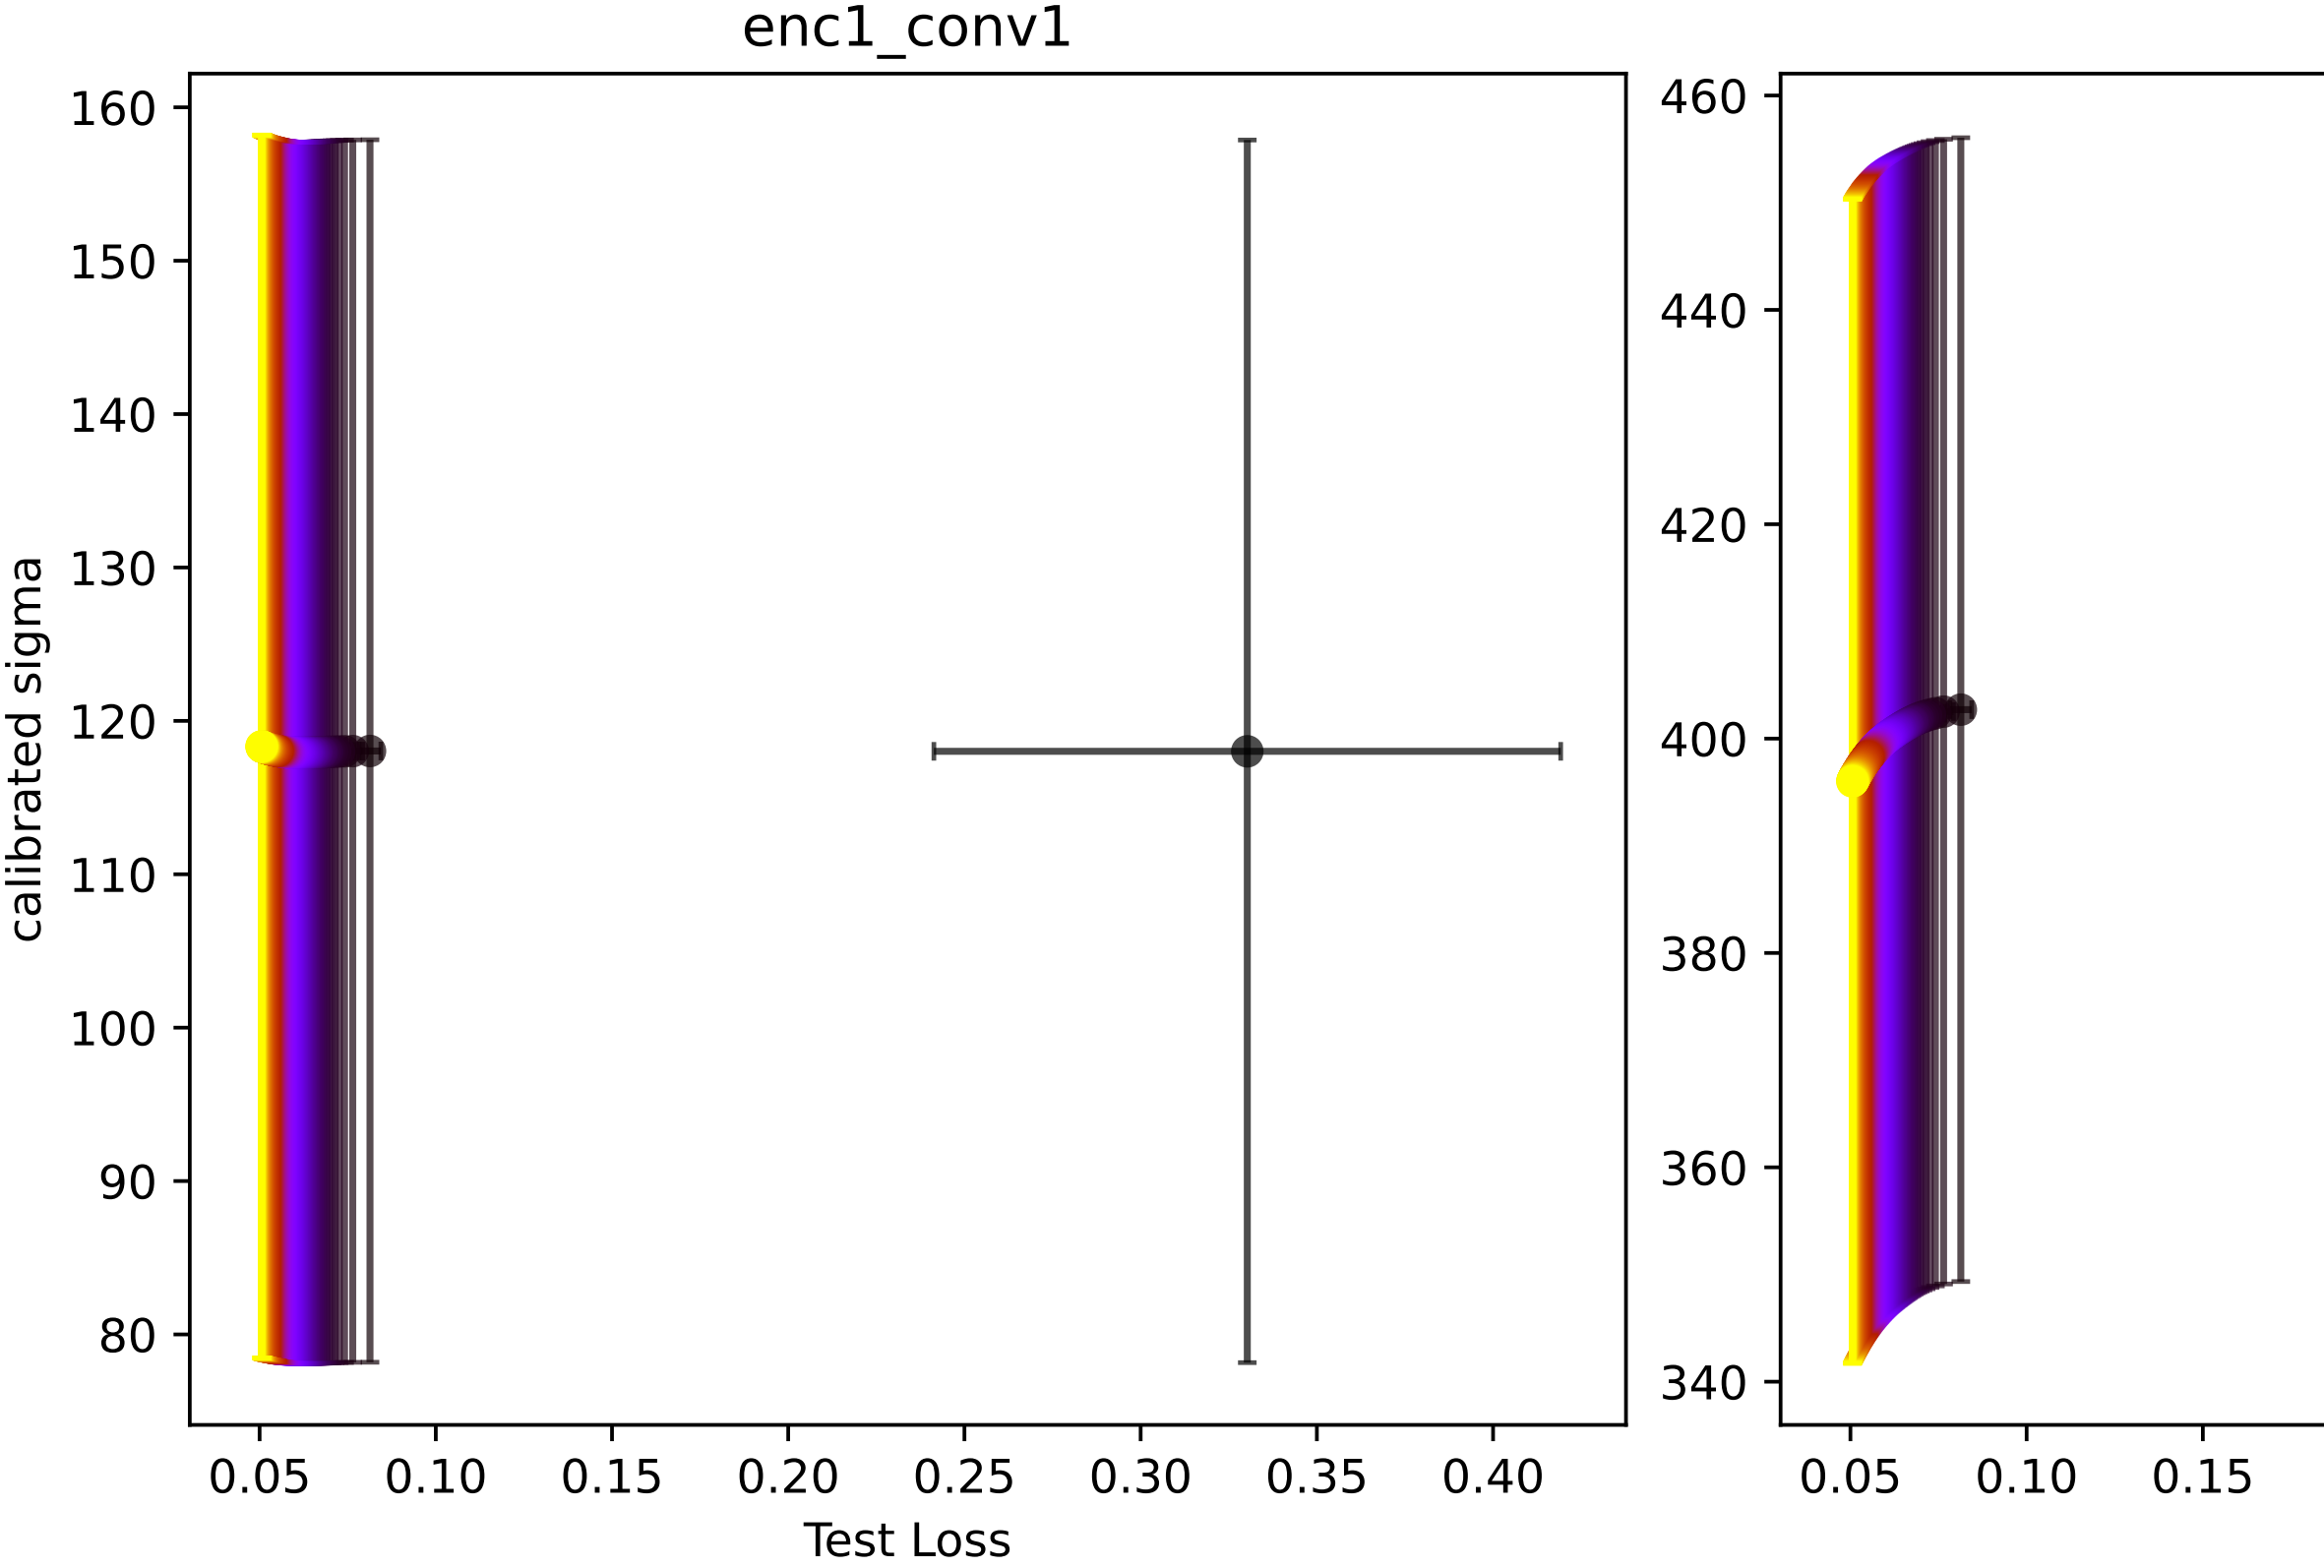
enc1_conv1
calibrated sigma
160
150
140
130
120
110
100
90
80
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
460
440
420
400
380
360
340
0.05
0.10
0.15

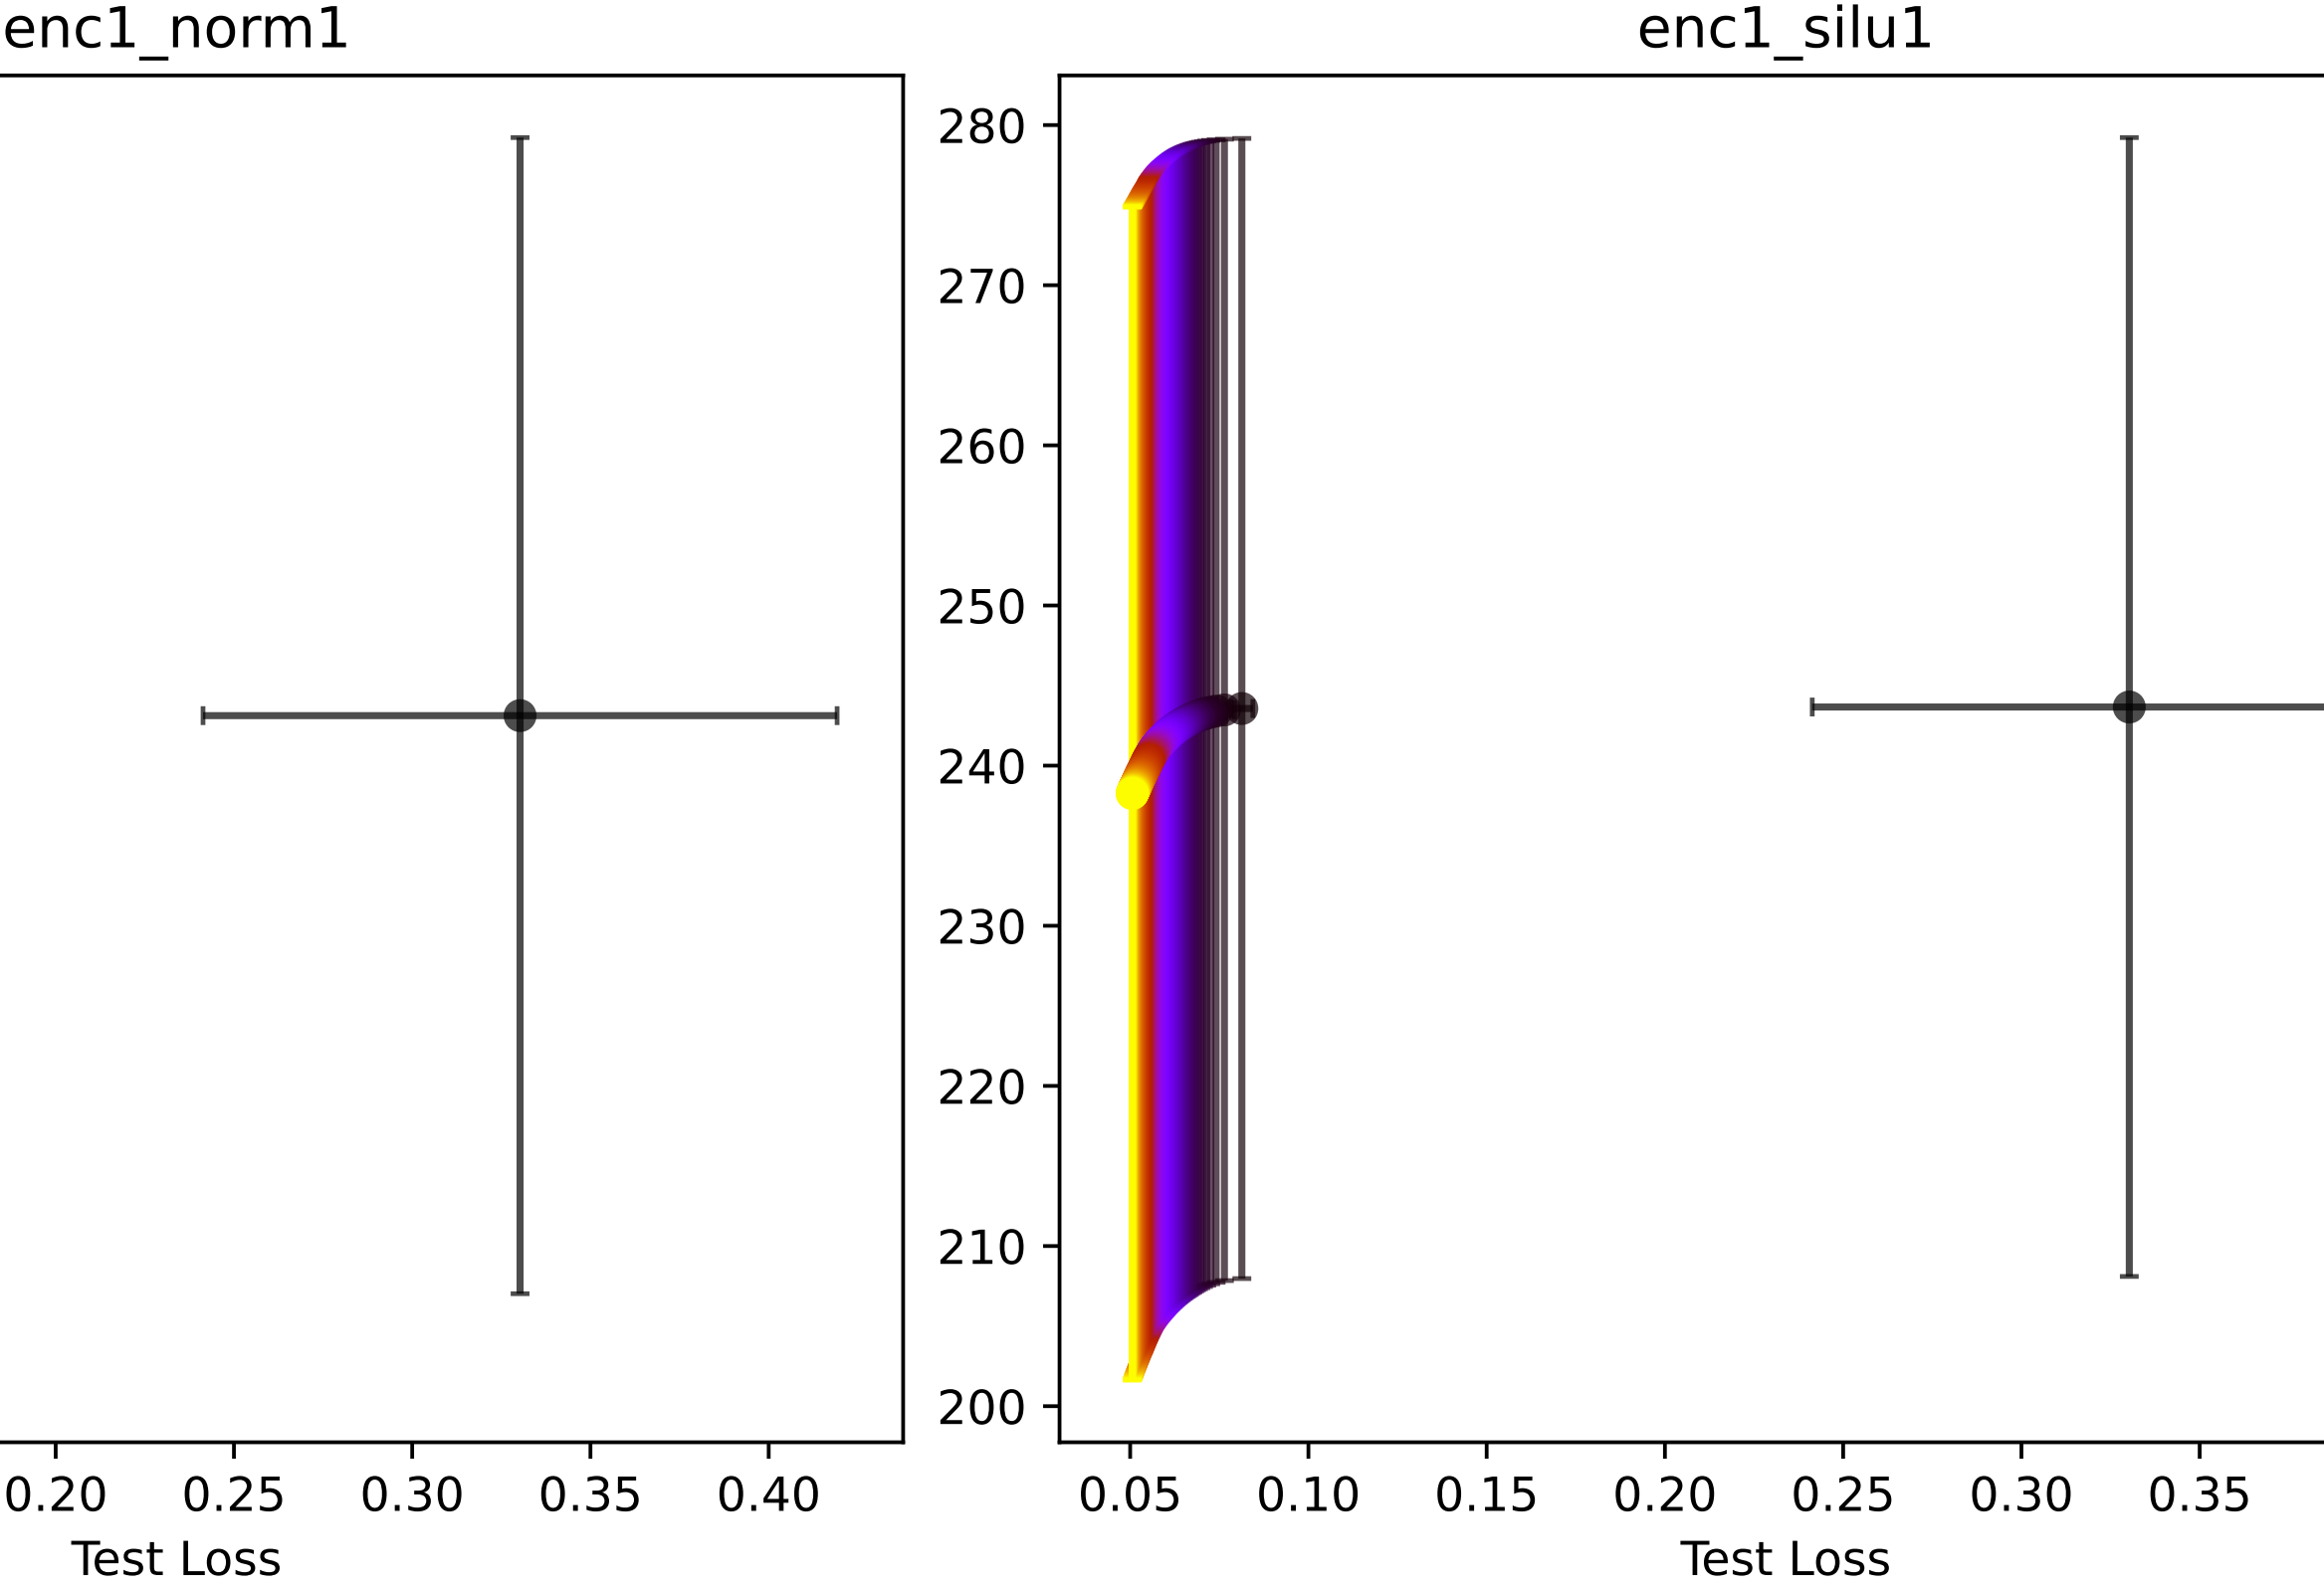
enc1_norm1
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
enc1_silu1
280
270
260
250
240
230
220
210
200
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

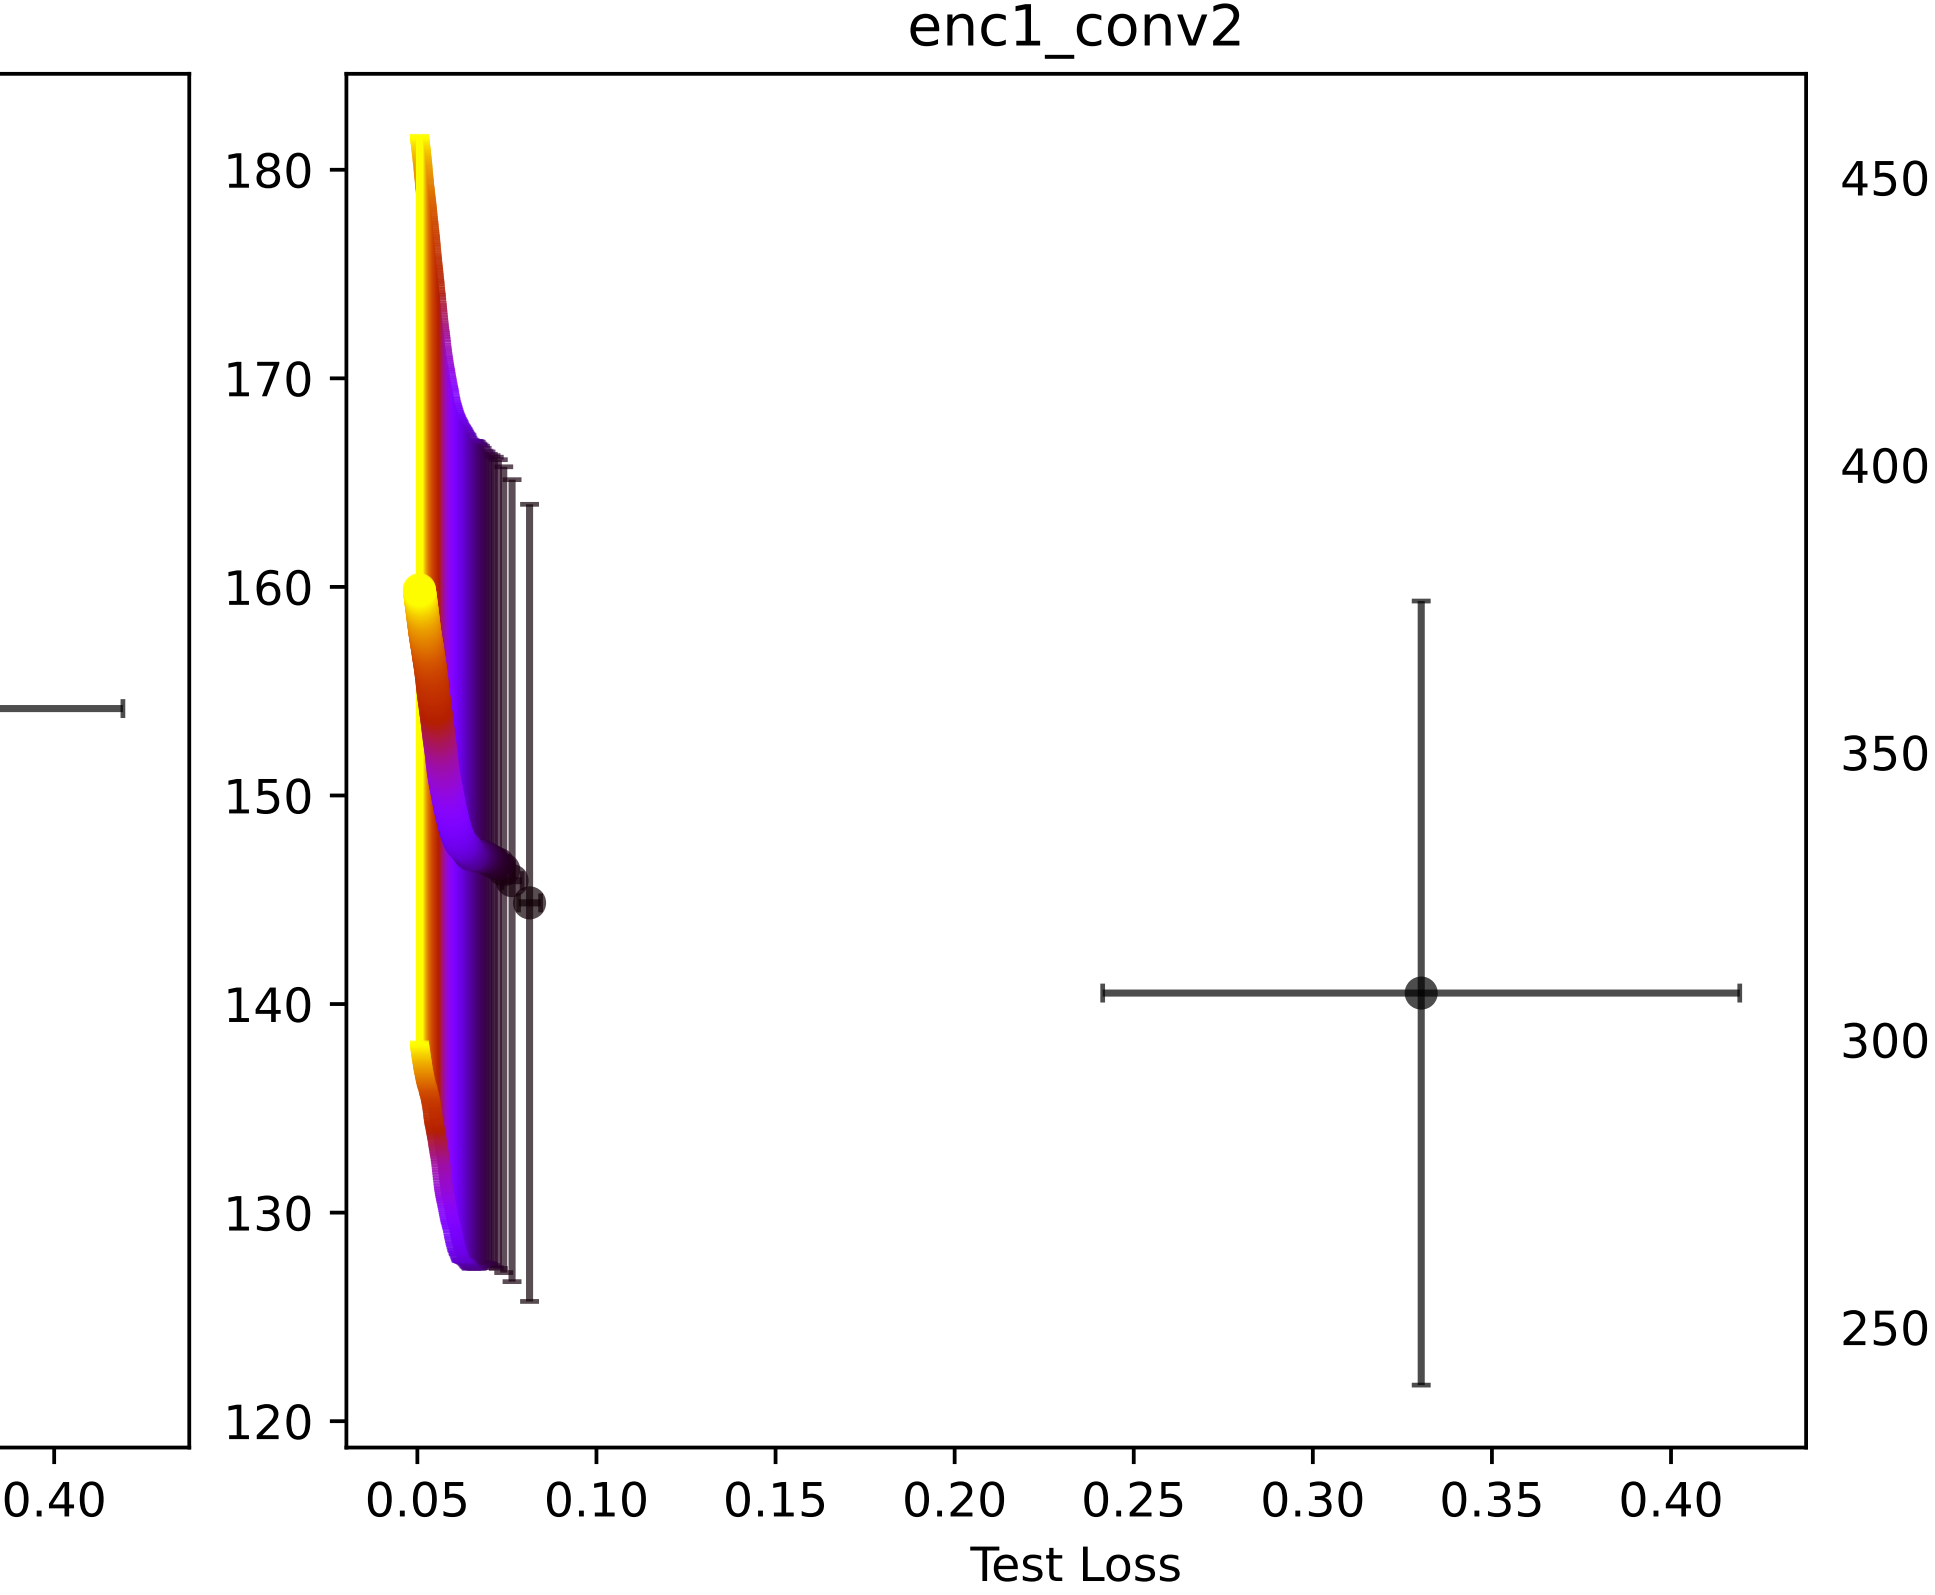
0.40
enc1_conv2
180
170
160
150
140
130
120
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
450
400
350
300
250

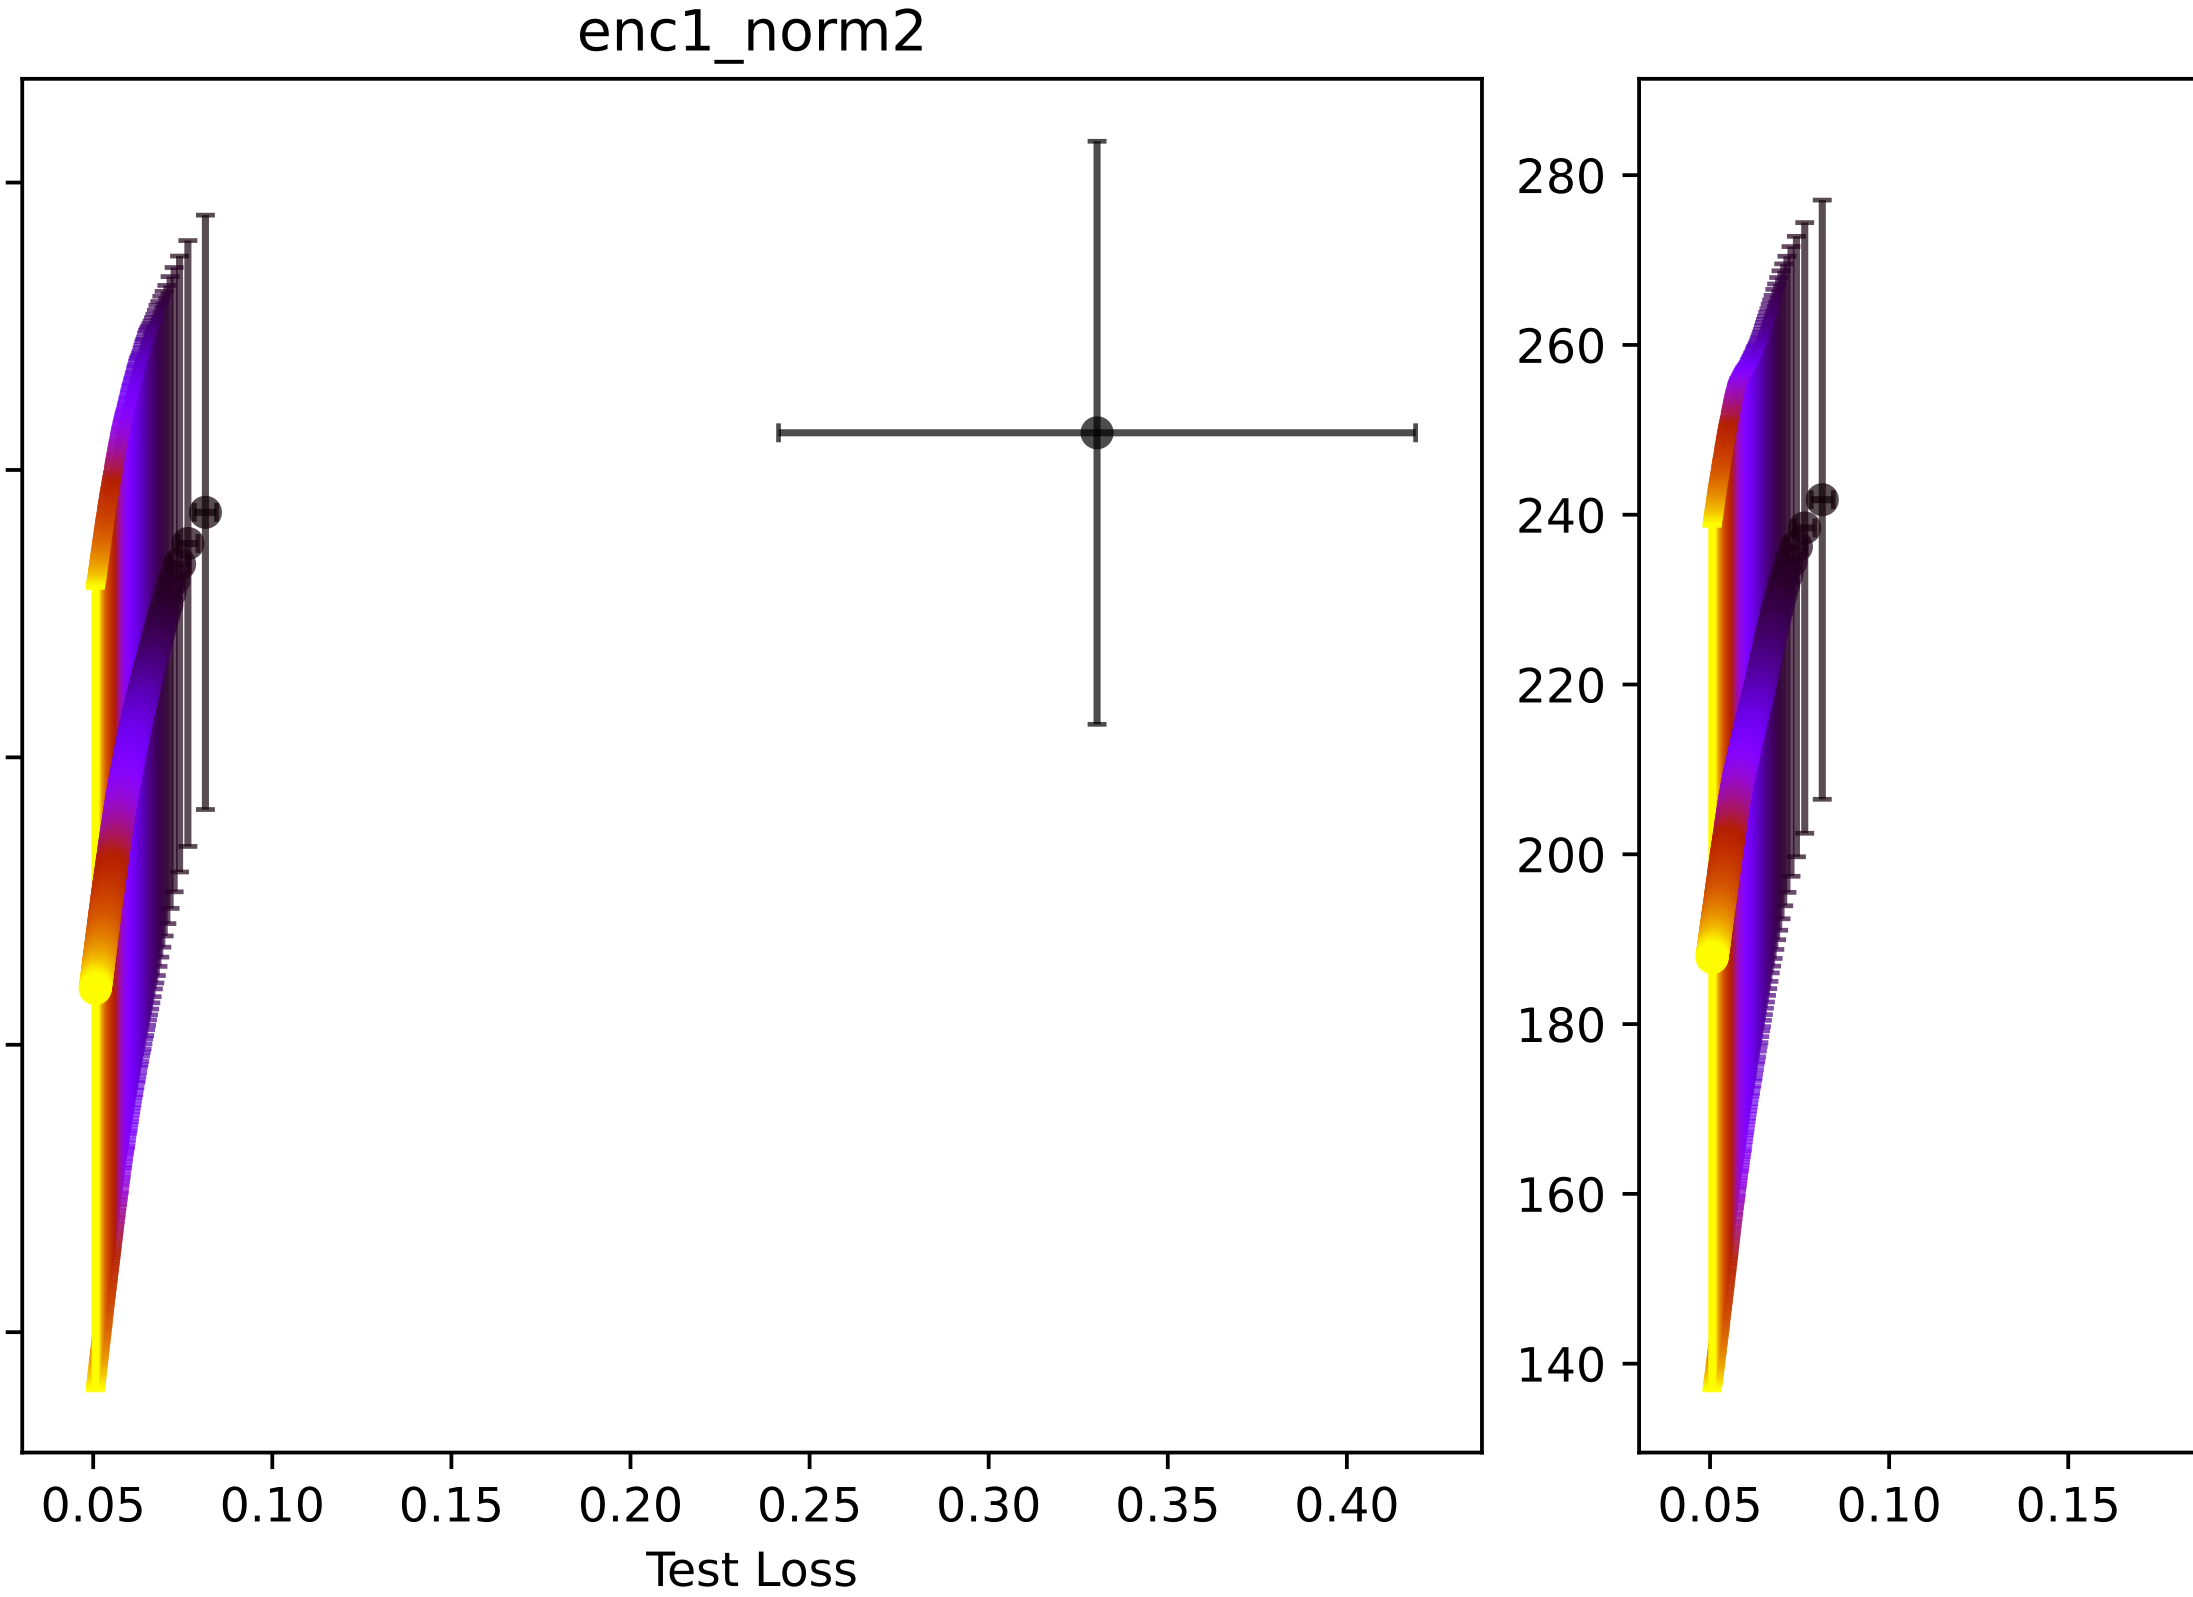
enc1_norm2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
280
260
240
220
200
180
160
140
0.05
0.10
0.15

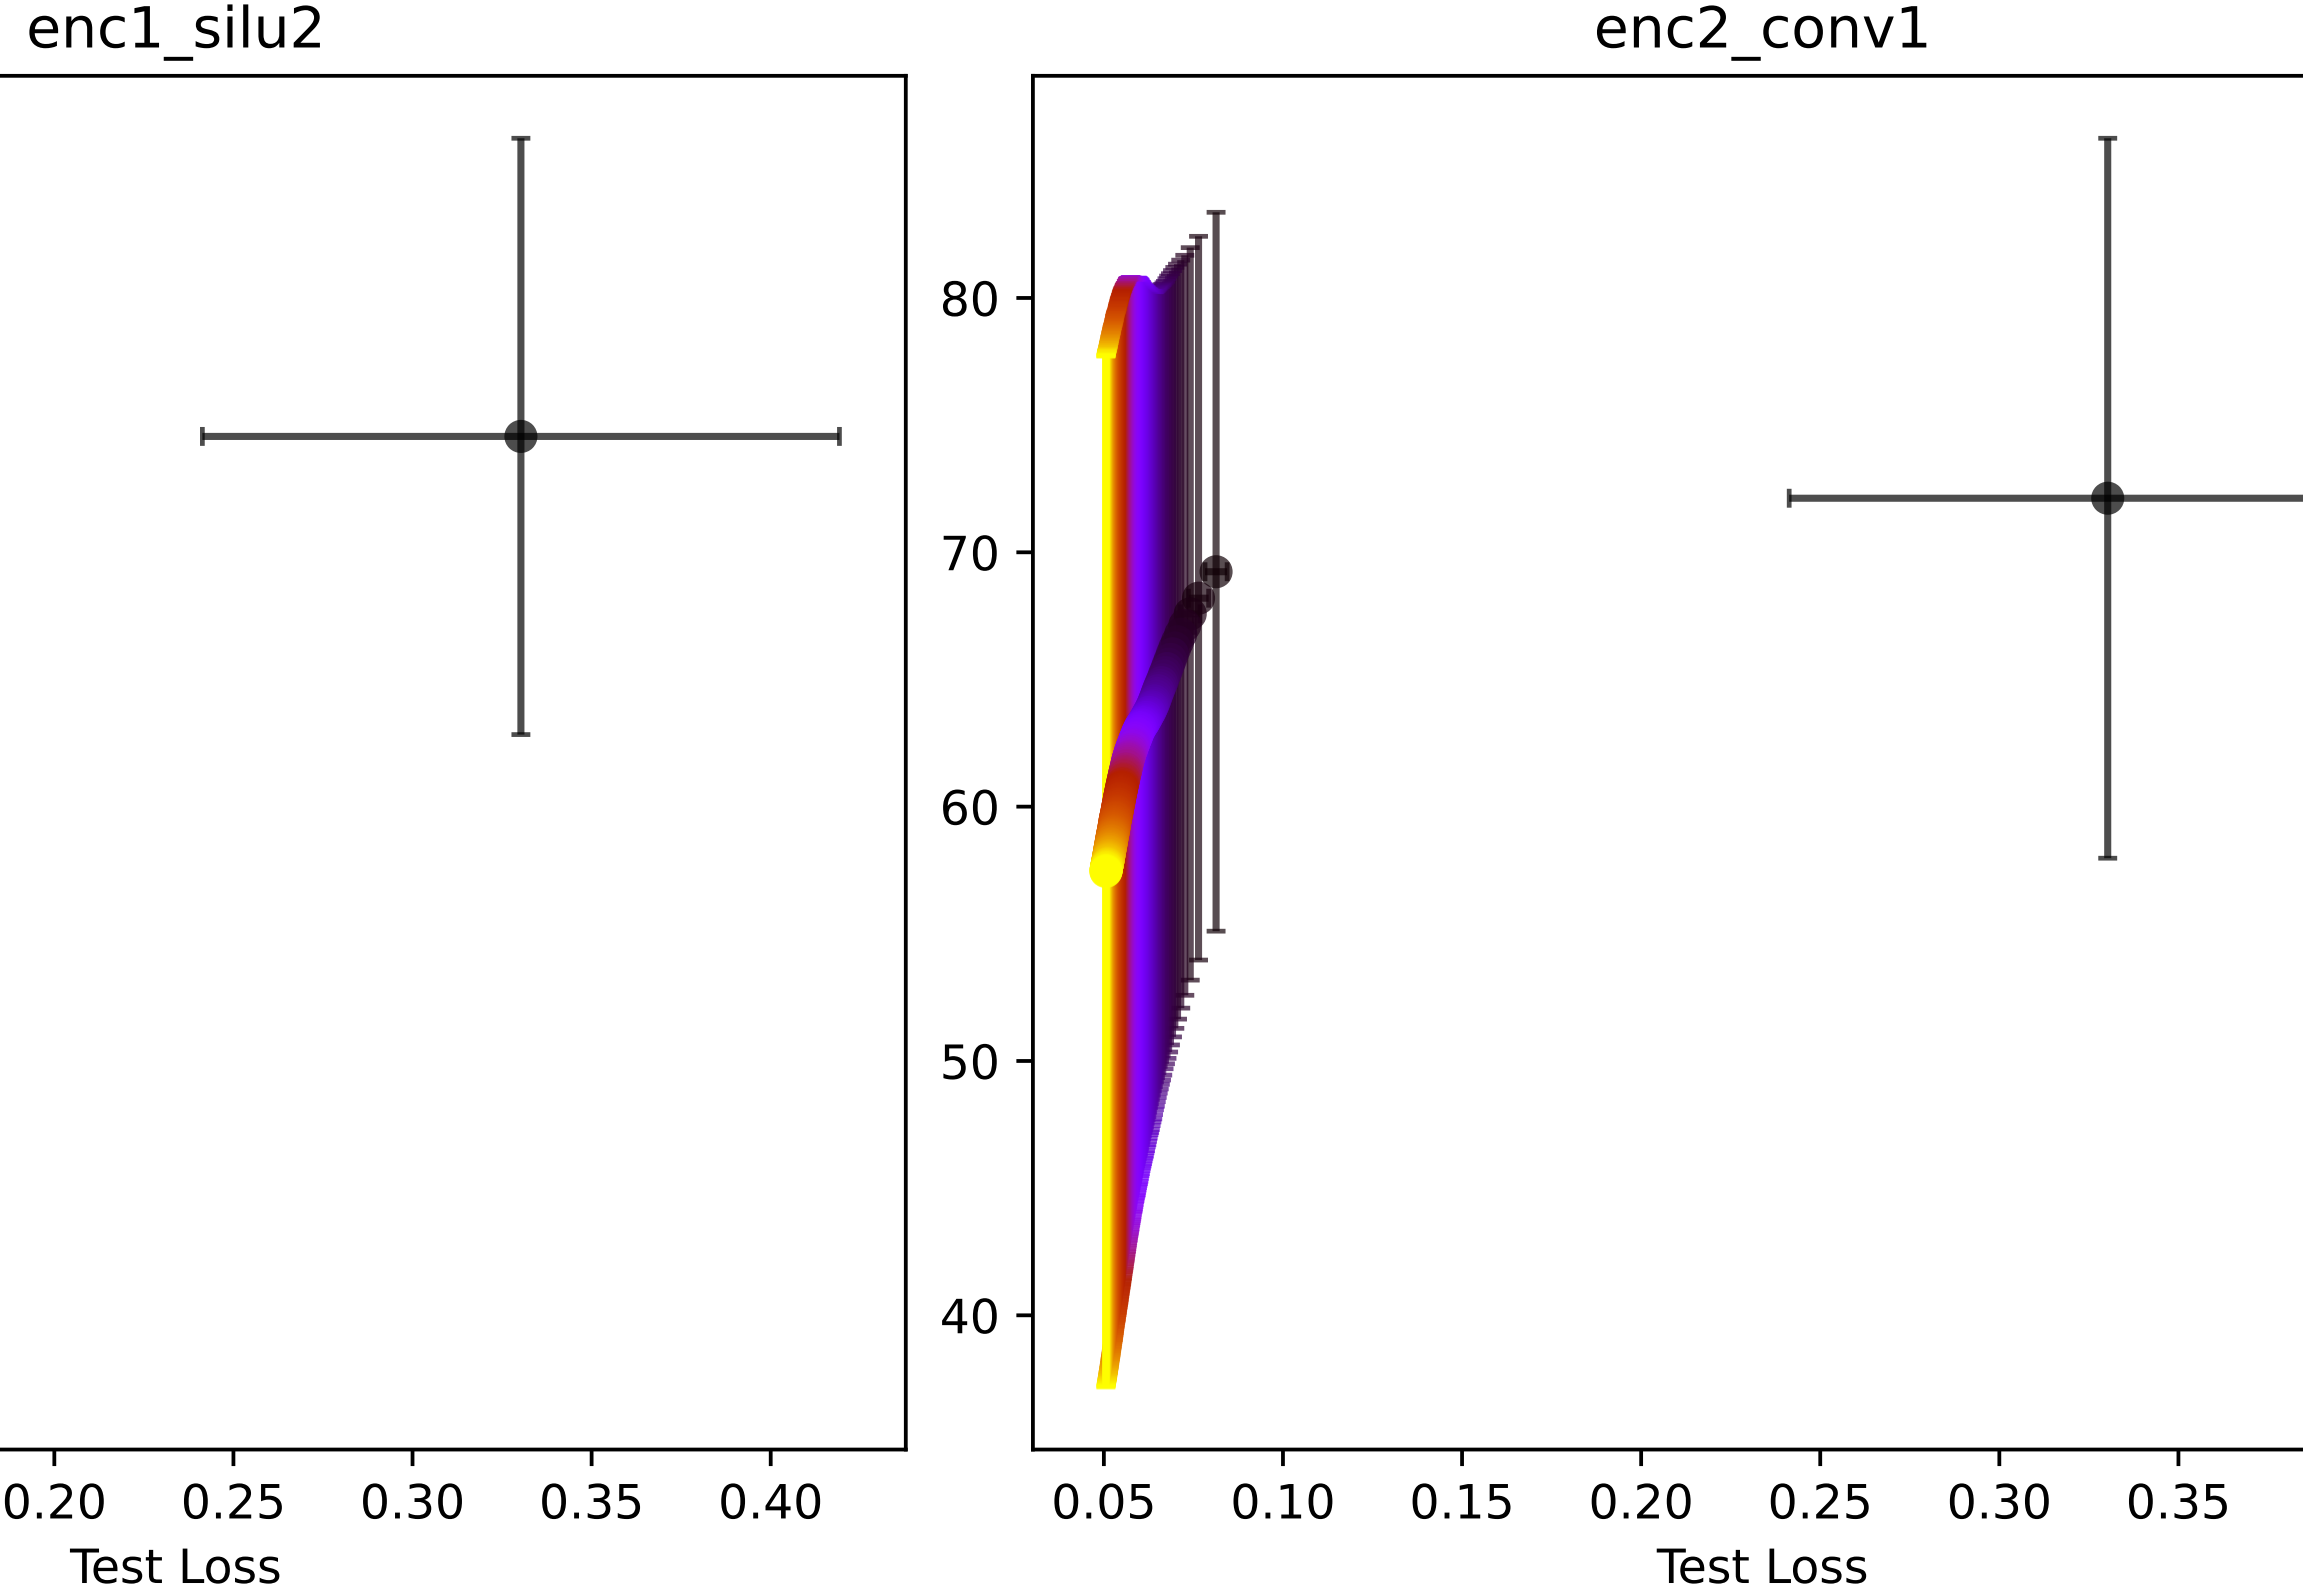
enc1_silu2
enc2_conv1
80
70
60
50
40
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

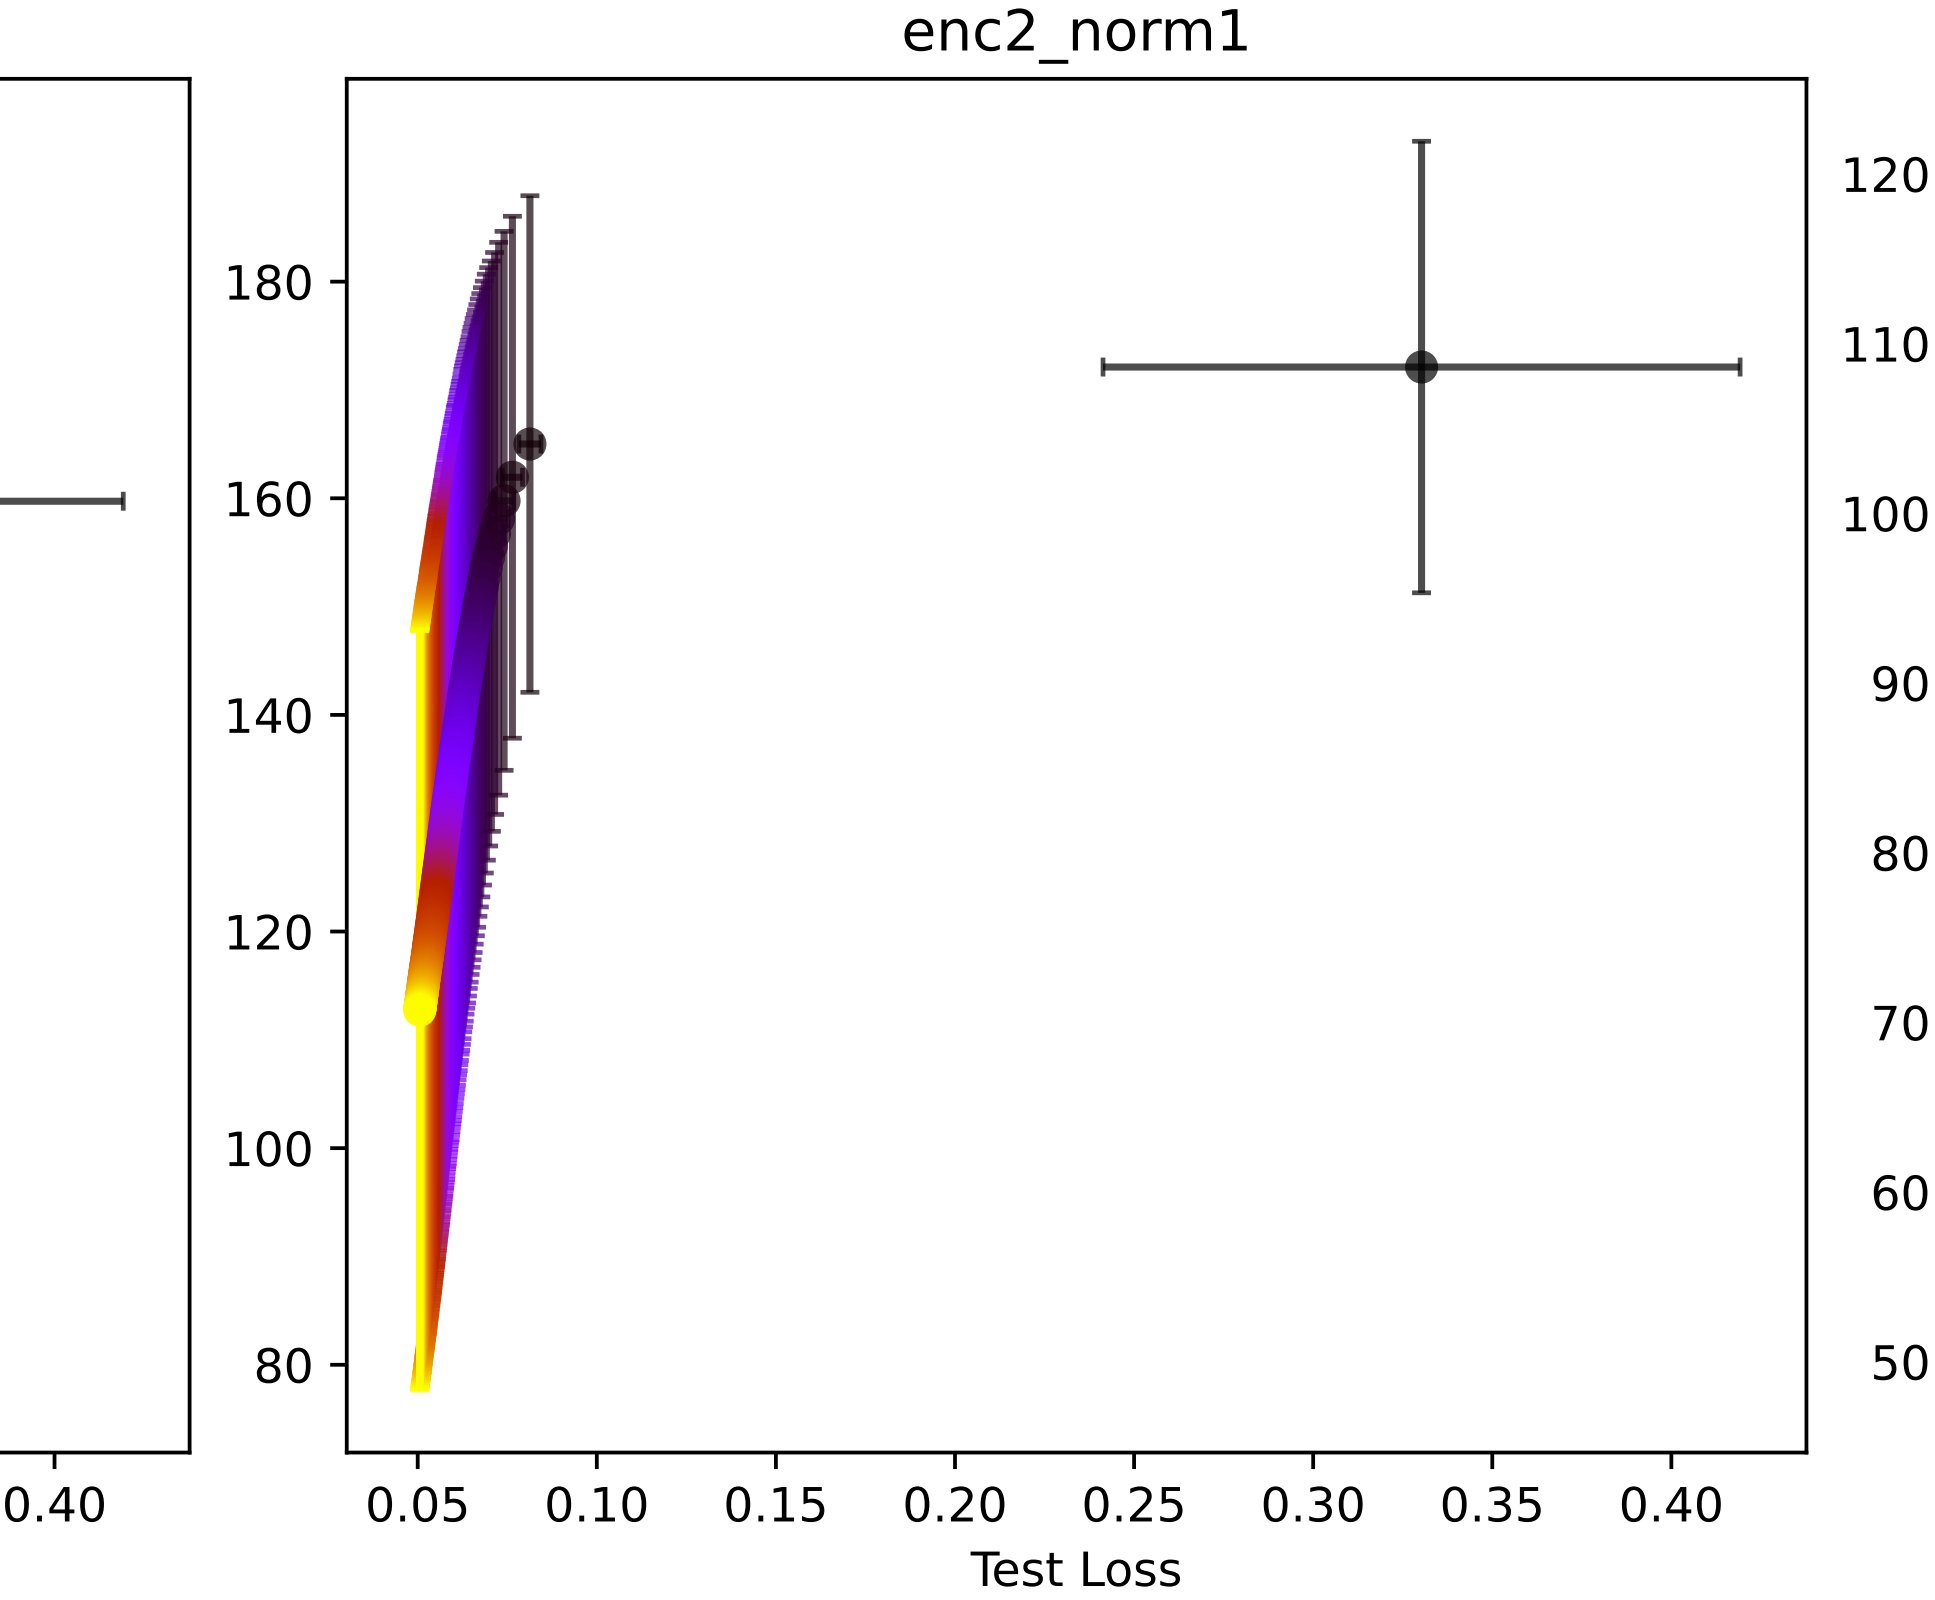
enc2_norm1
180
160
140
120
100
80
120
110
100
90
80
70
60
50
0.40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss

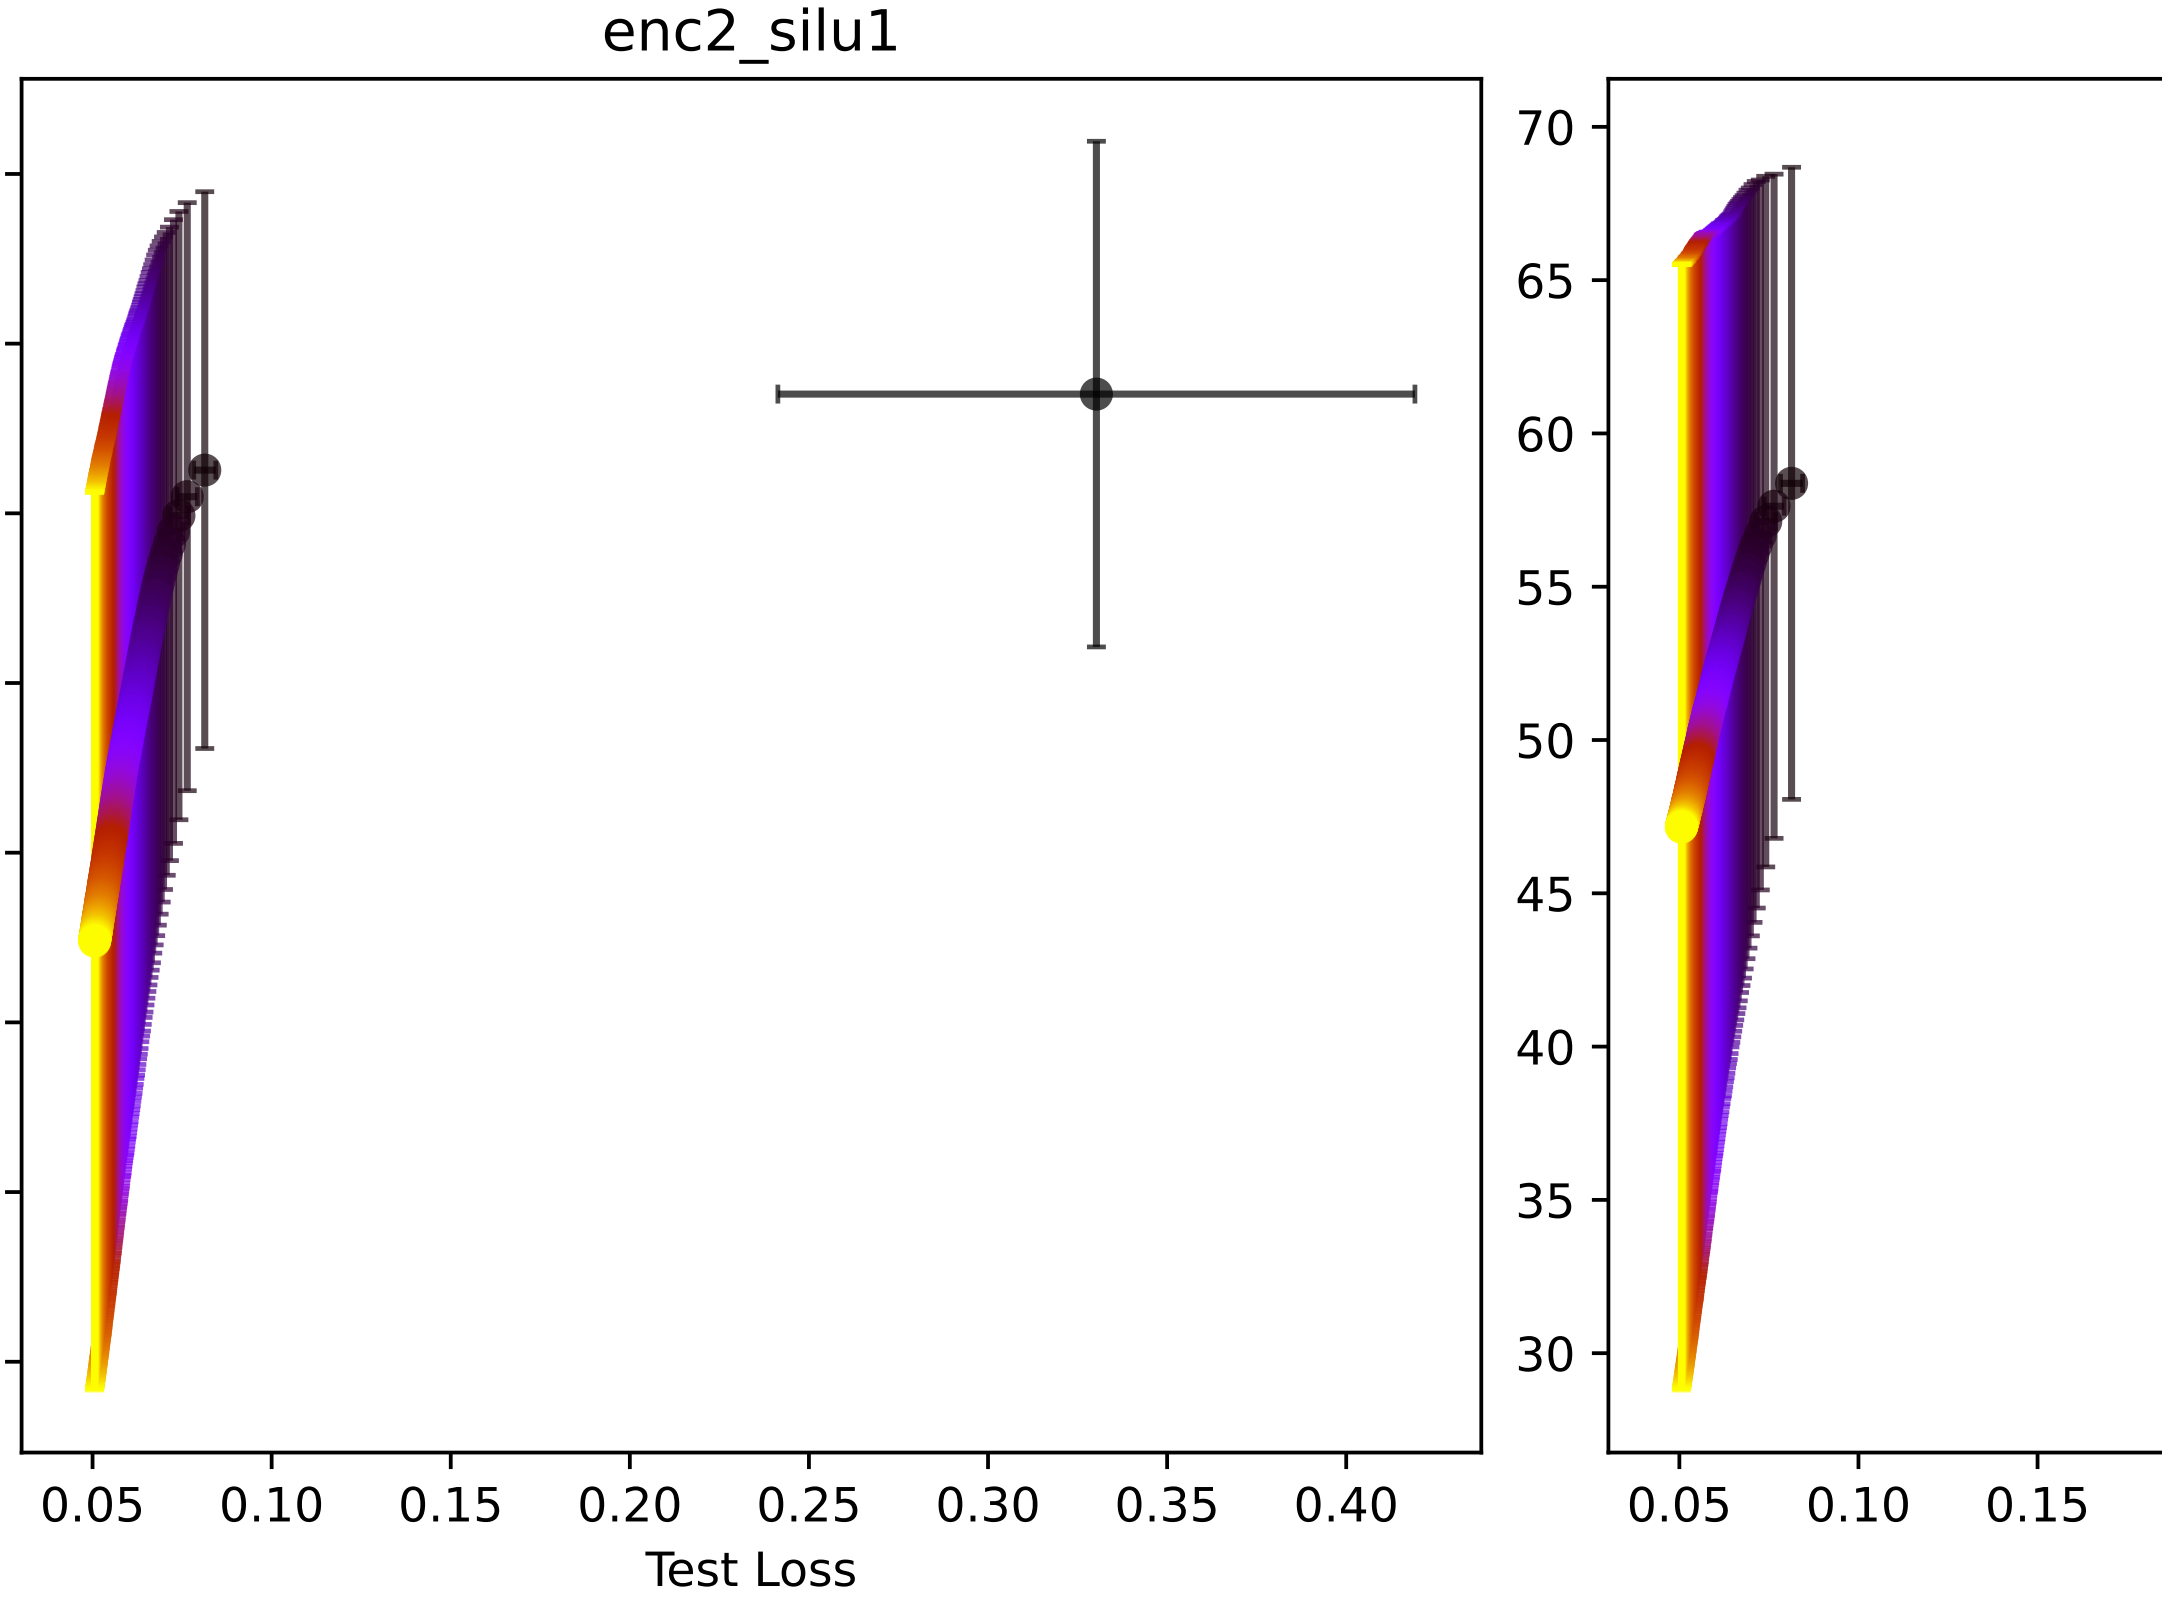
enc2_silu1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
70
65
60
55
50
45
40
35
30
0.05
0.10
0.15

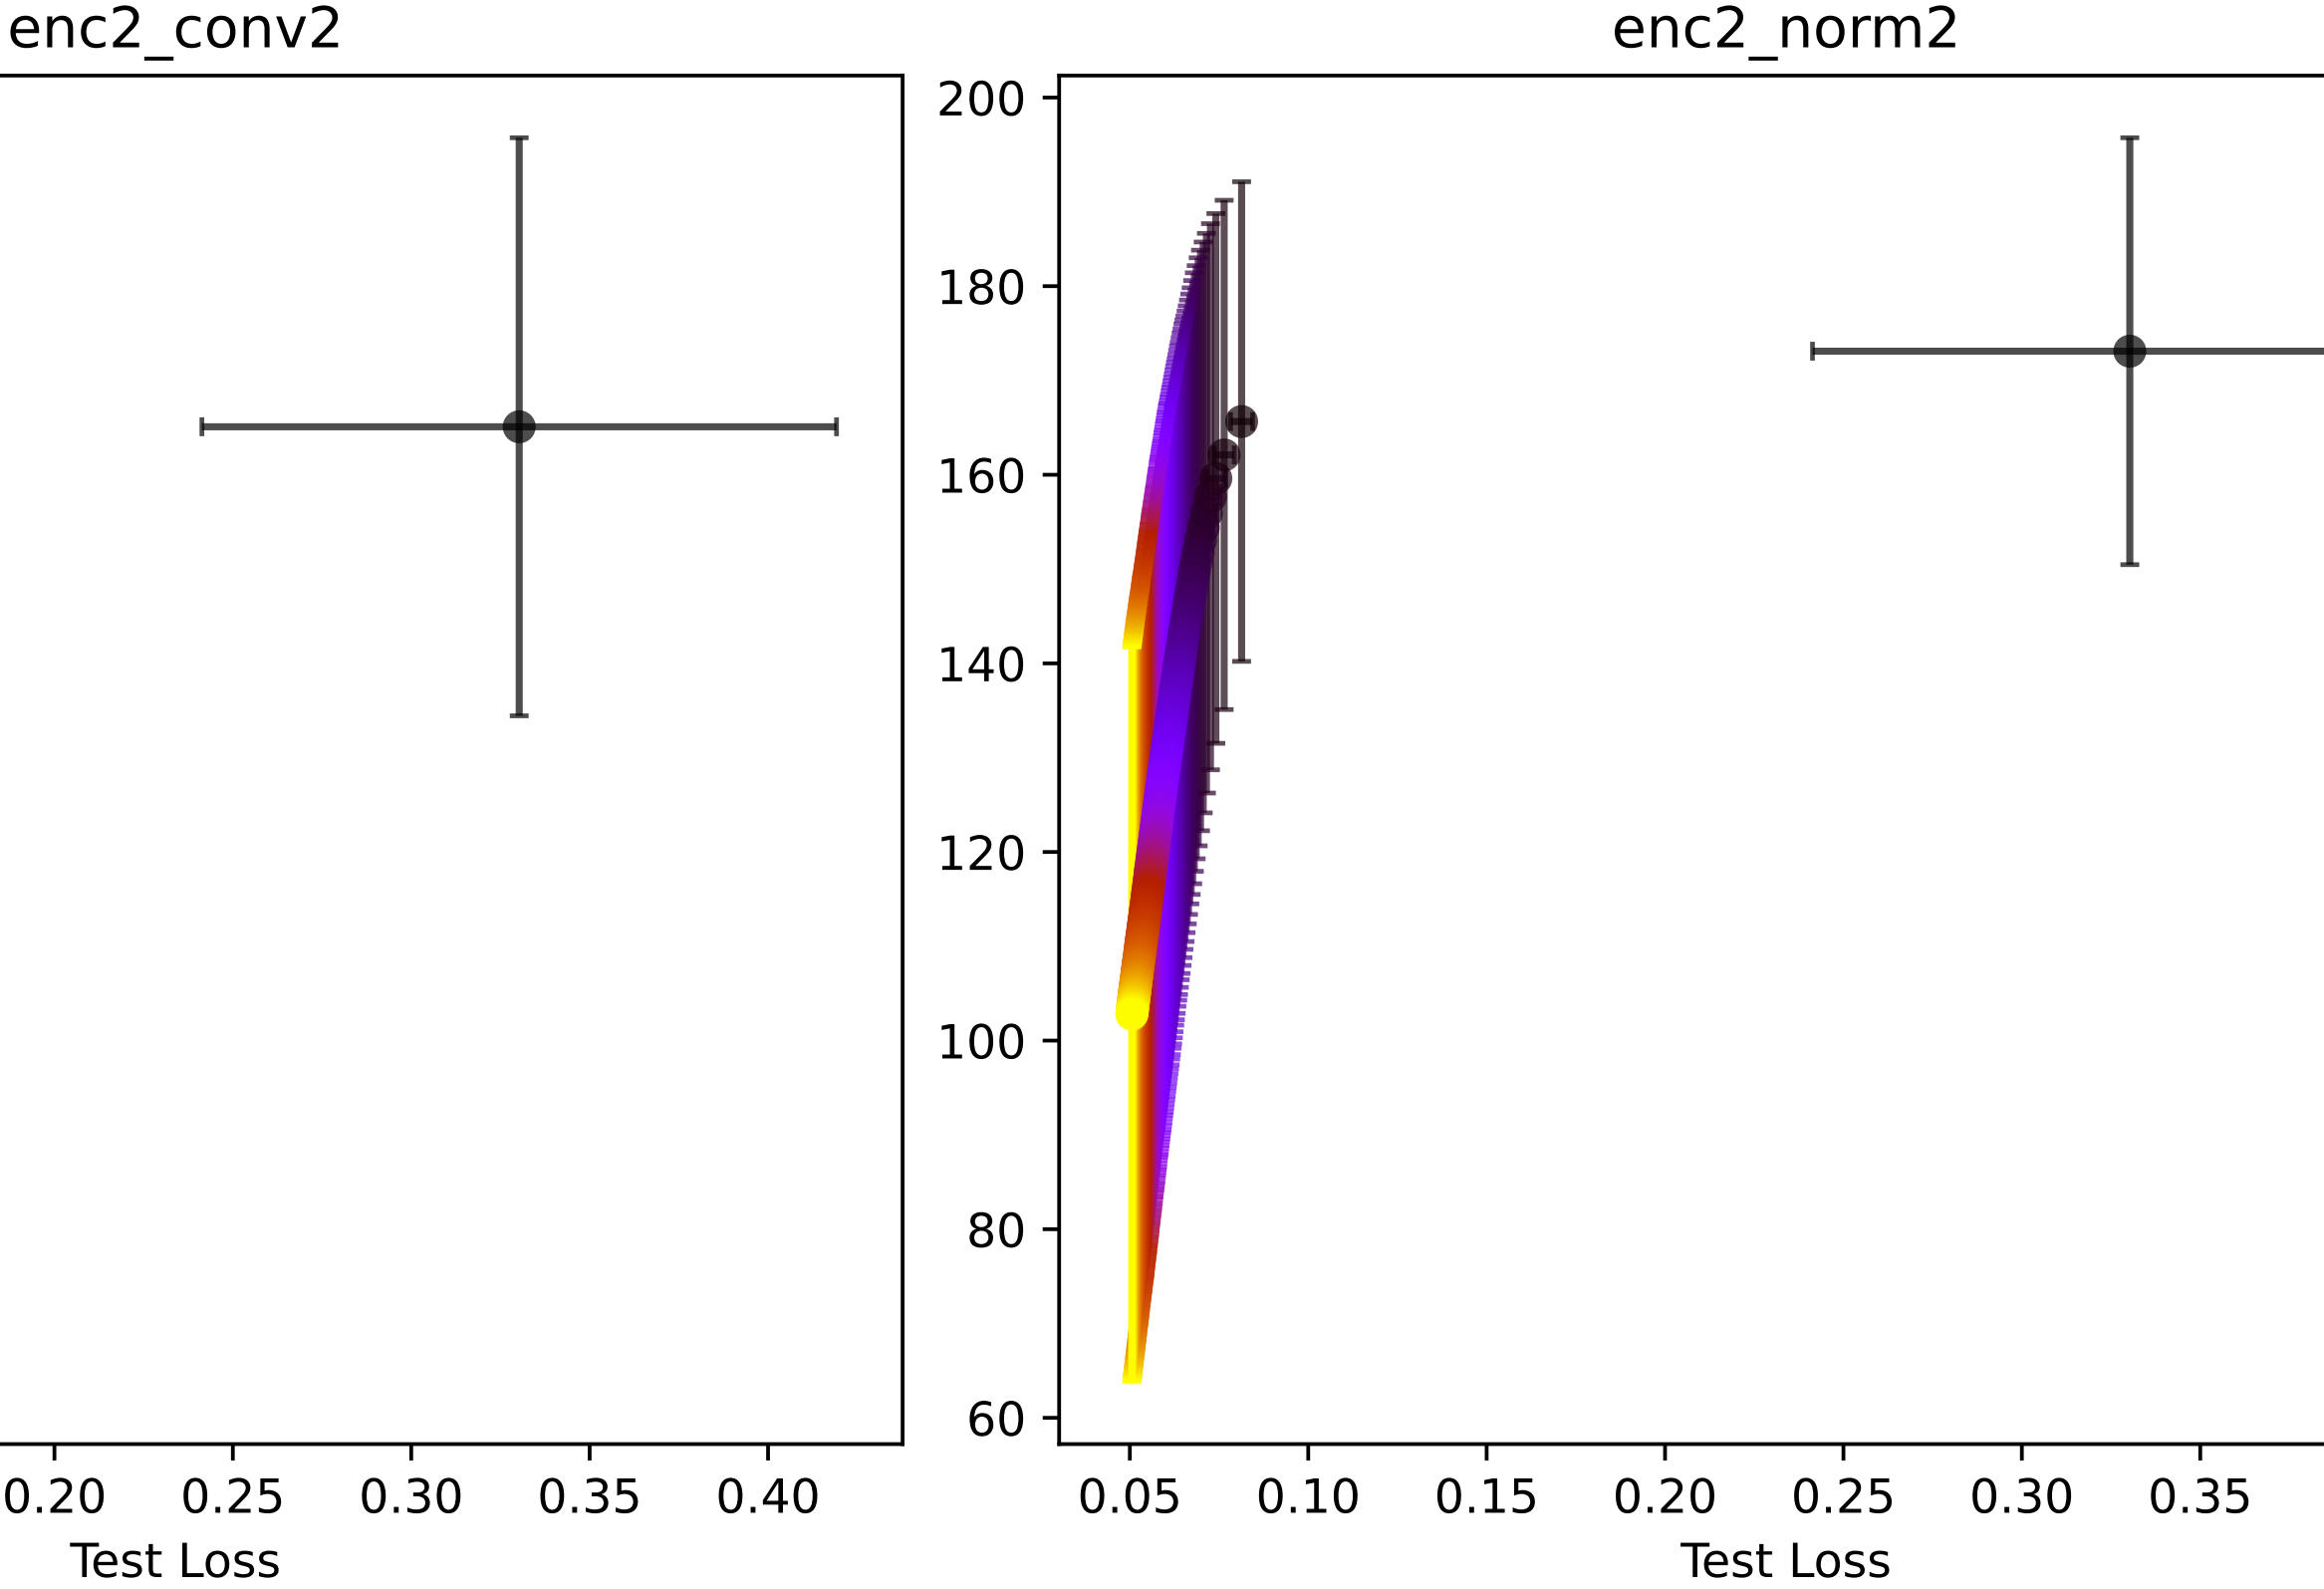
enc2_conv2
enc2_norm2
200
180
160
140
120
100
80
60
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss
Test Loss

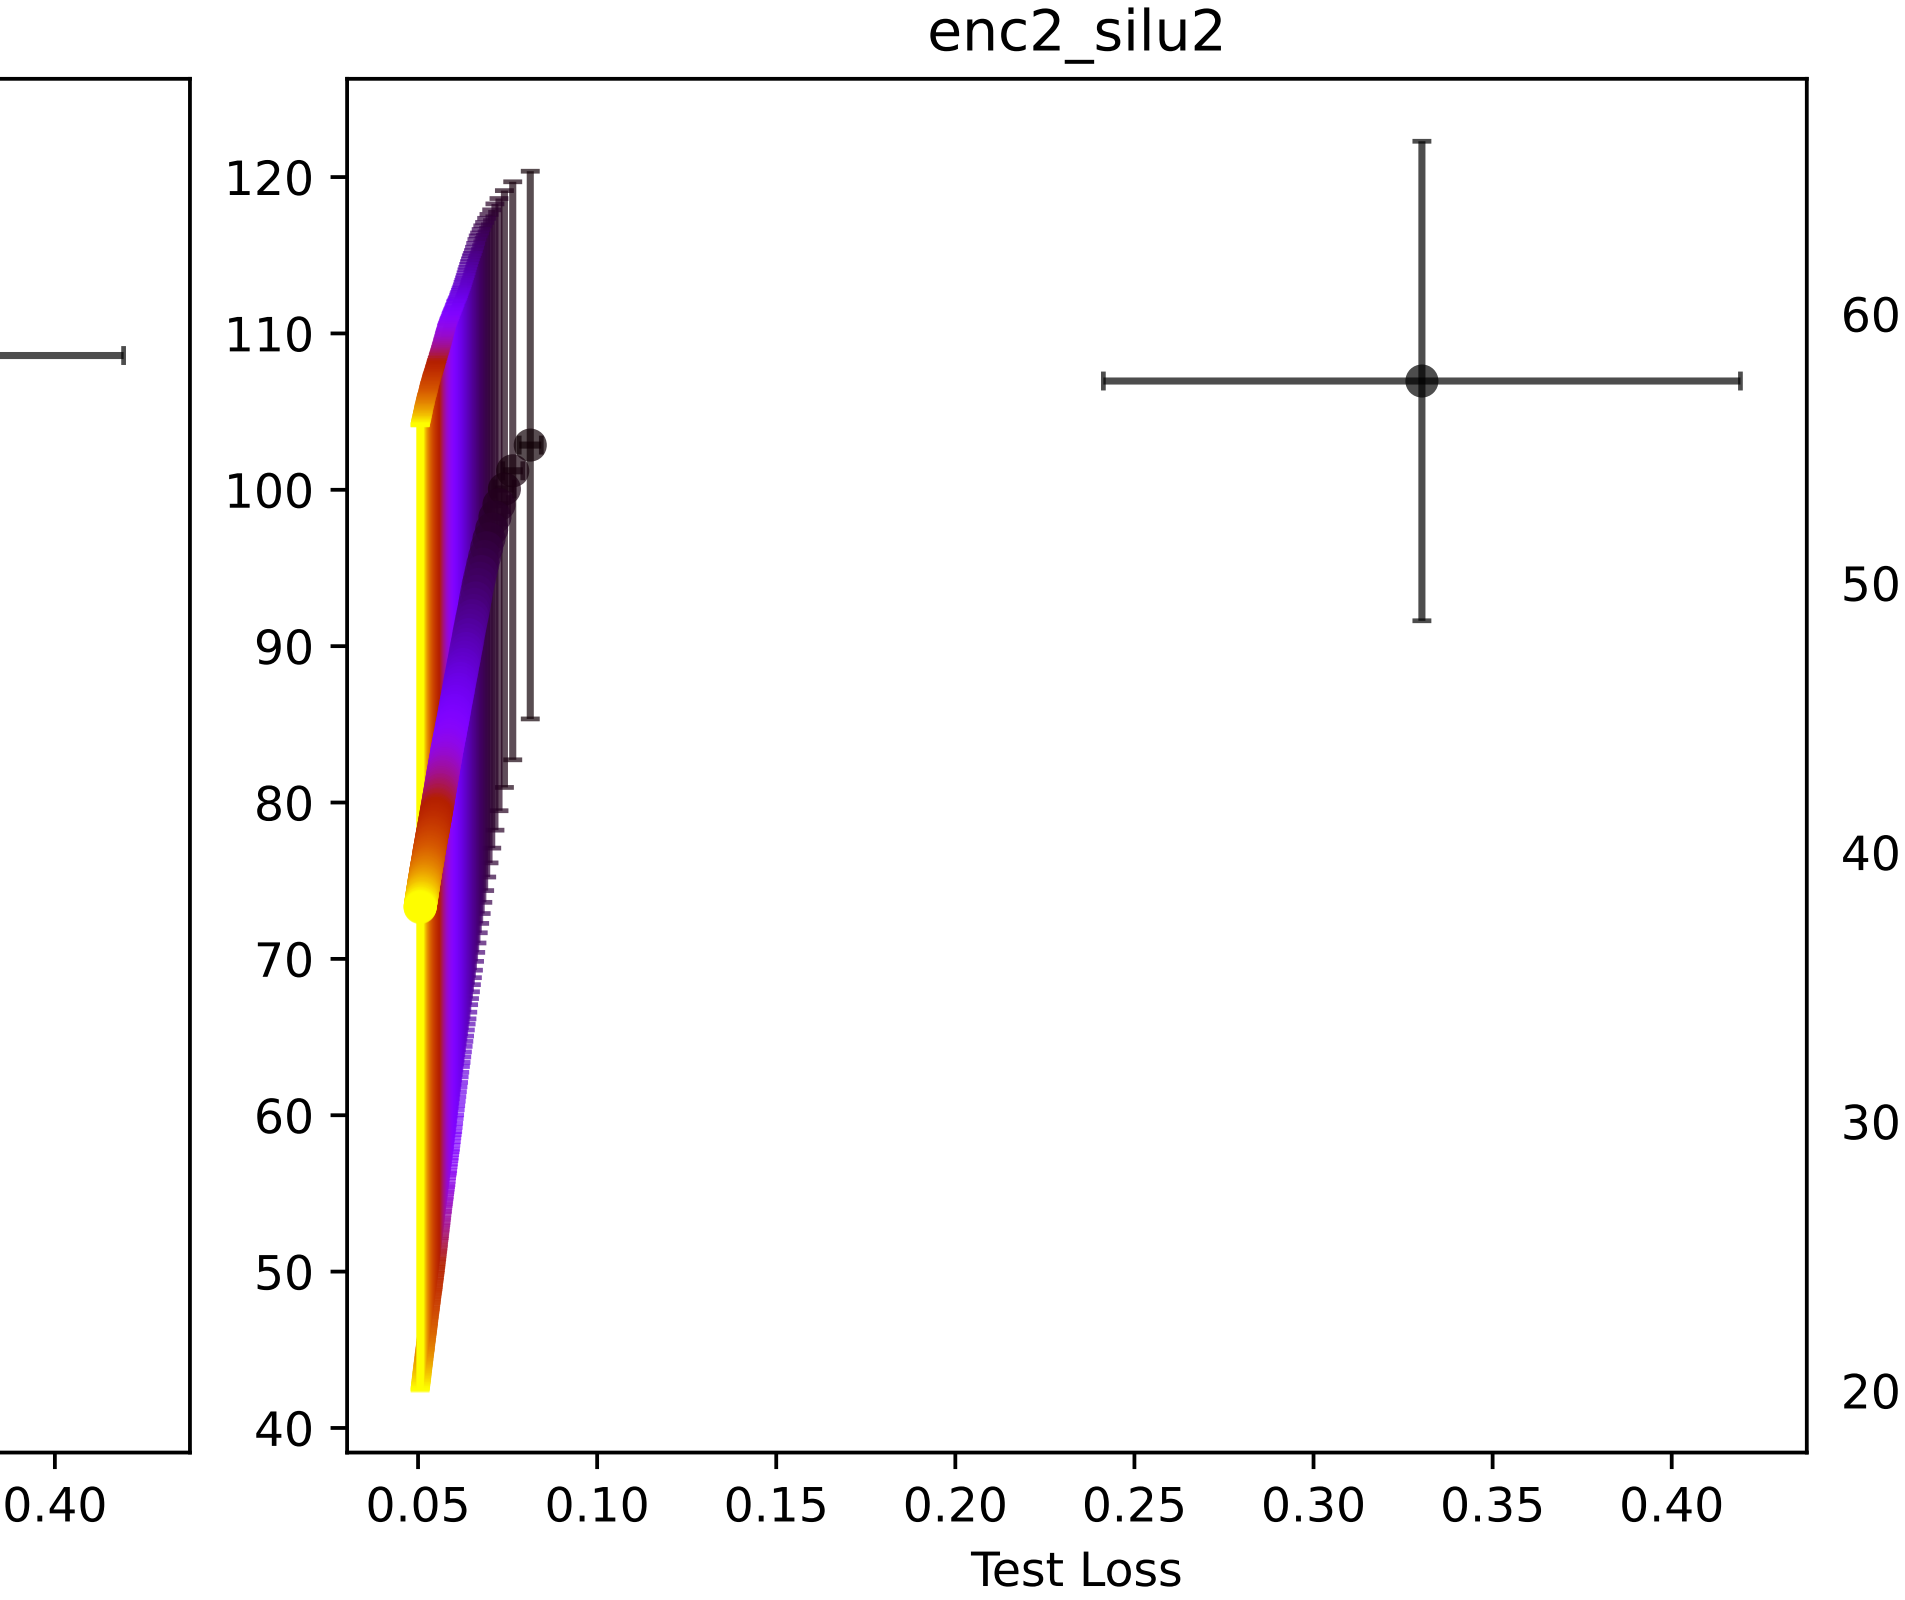
enc2_silu2
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
60
50
40
30
20
0.40

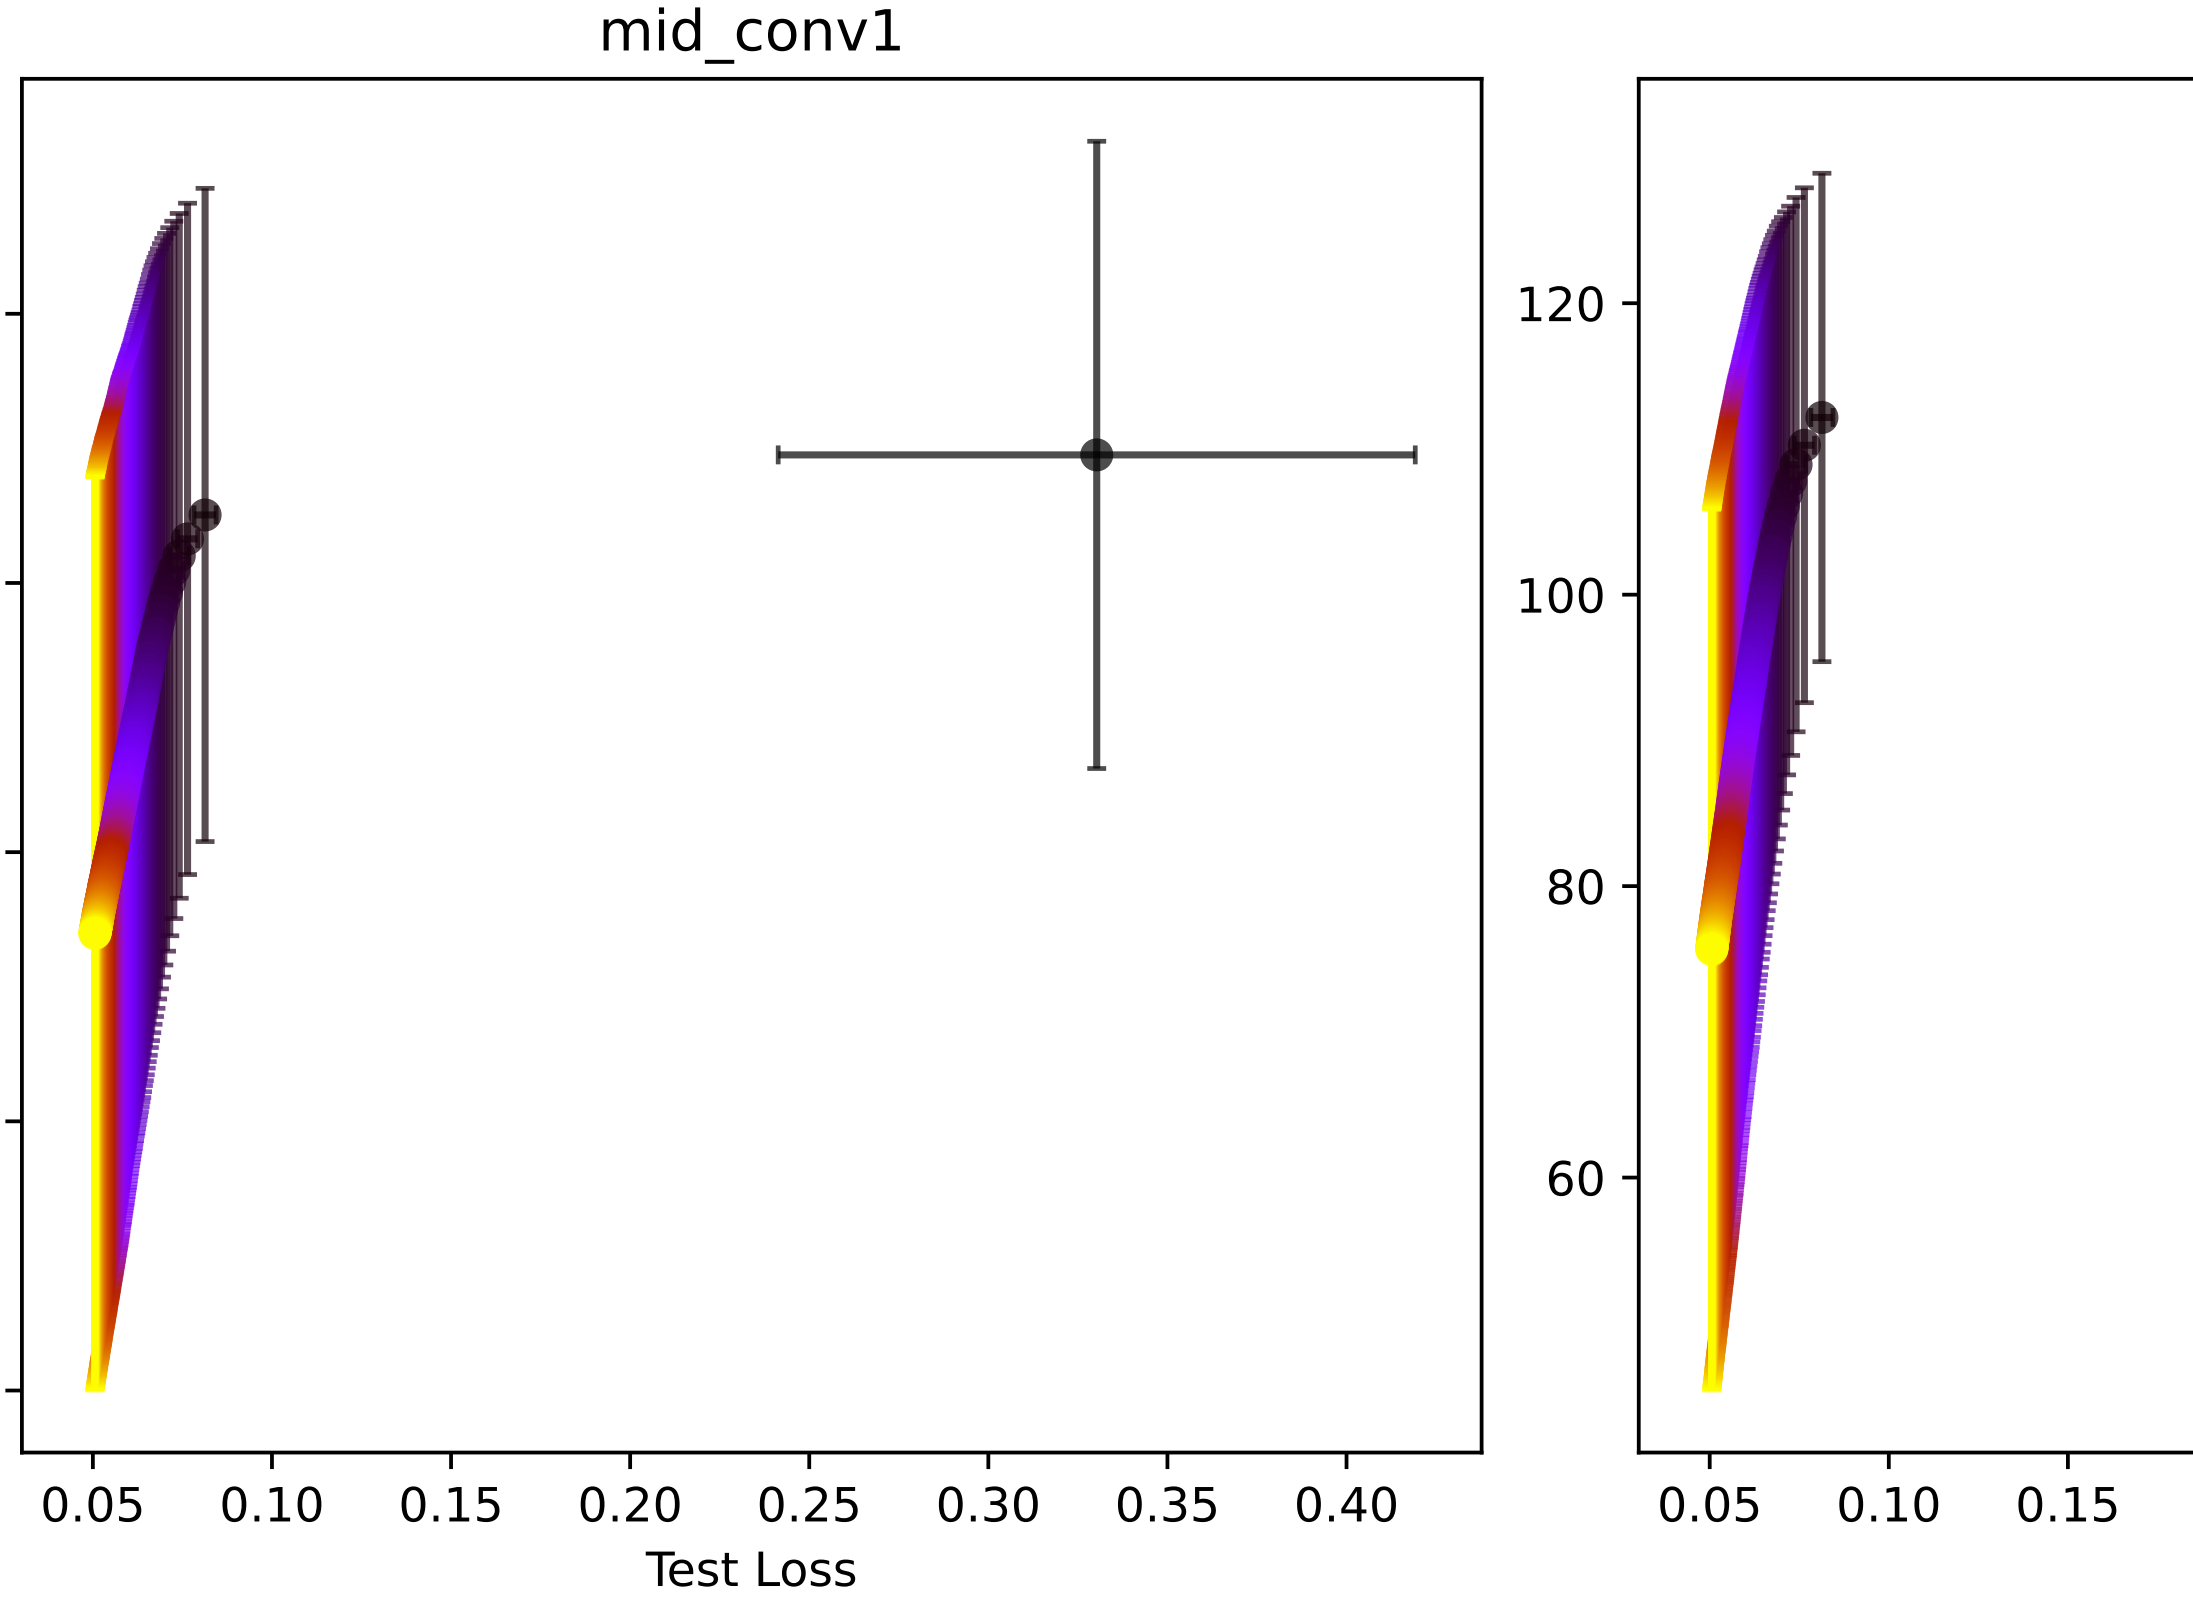
mid_conv1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
120
100
80
60
0.05
0.10
0.15

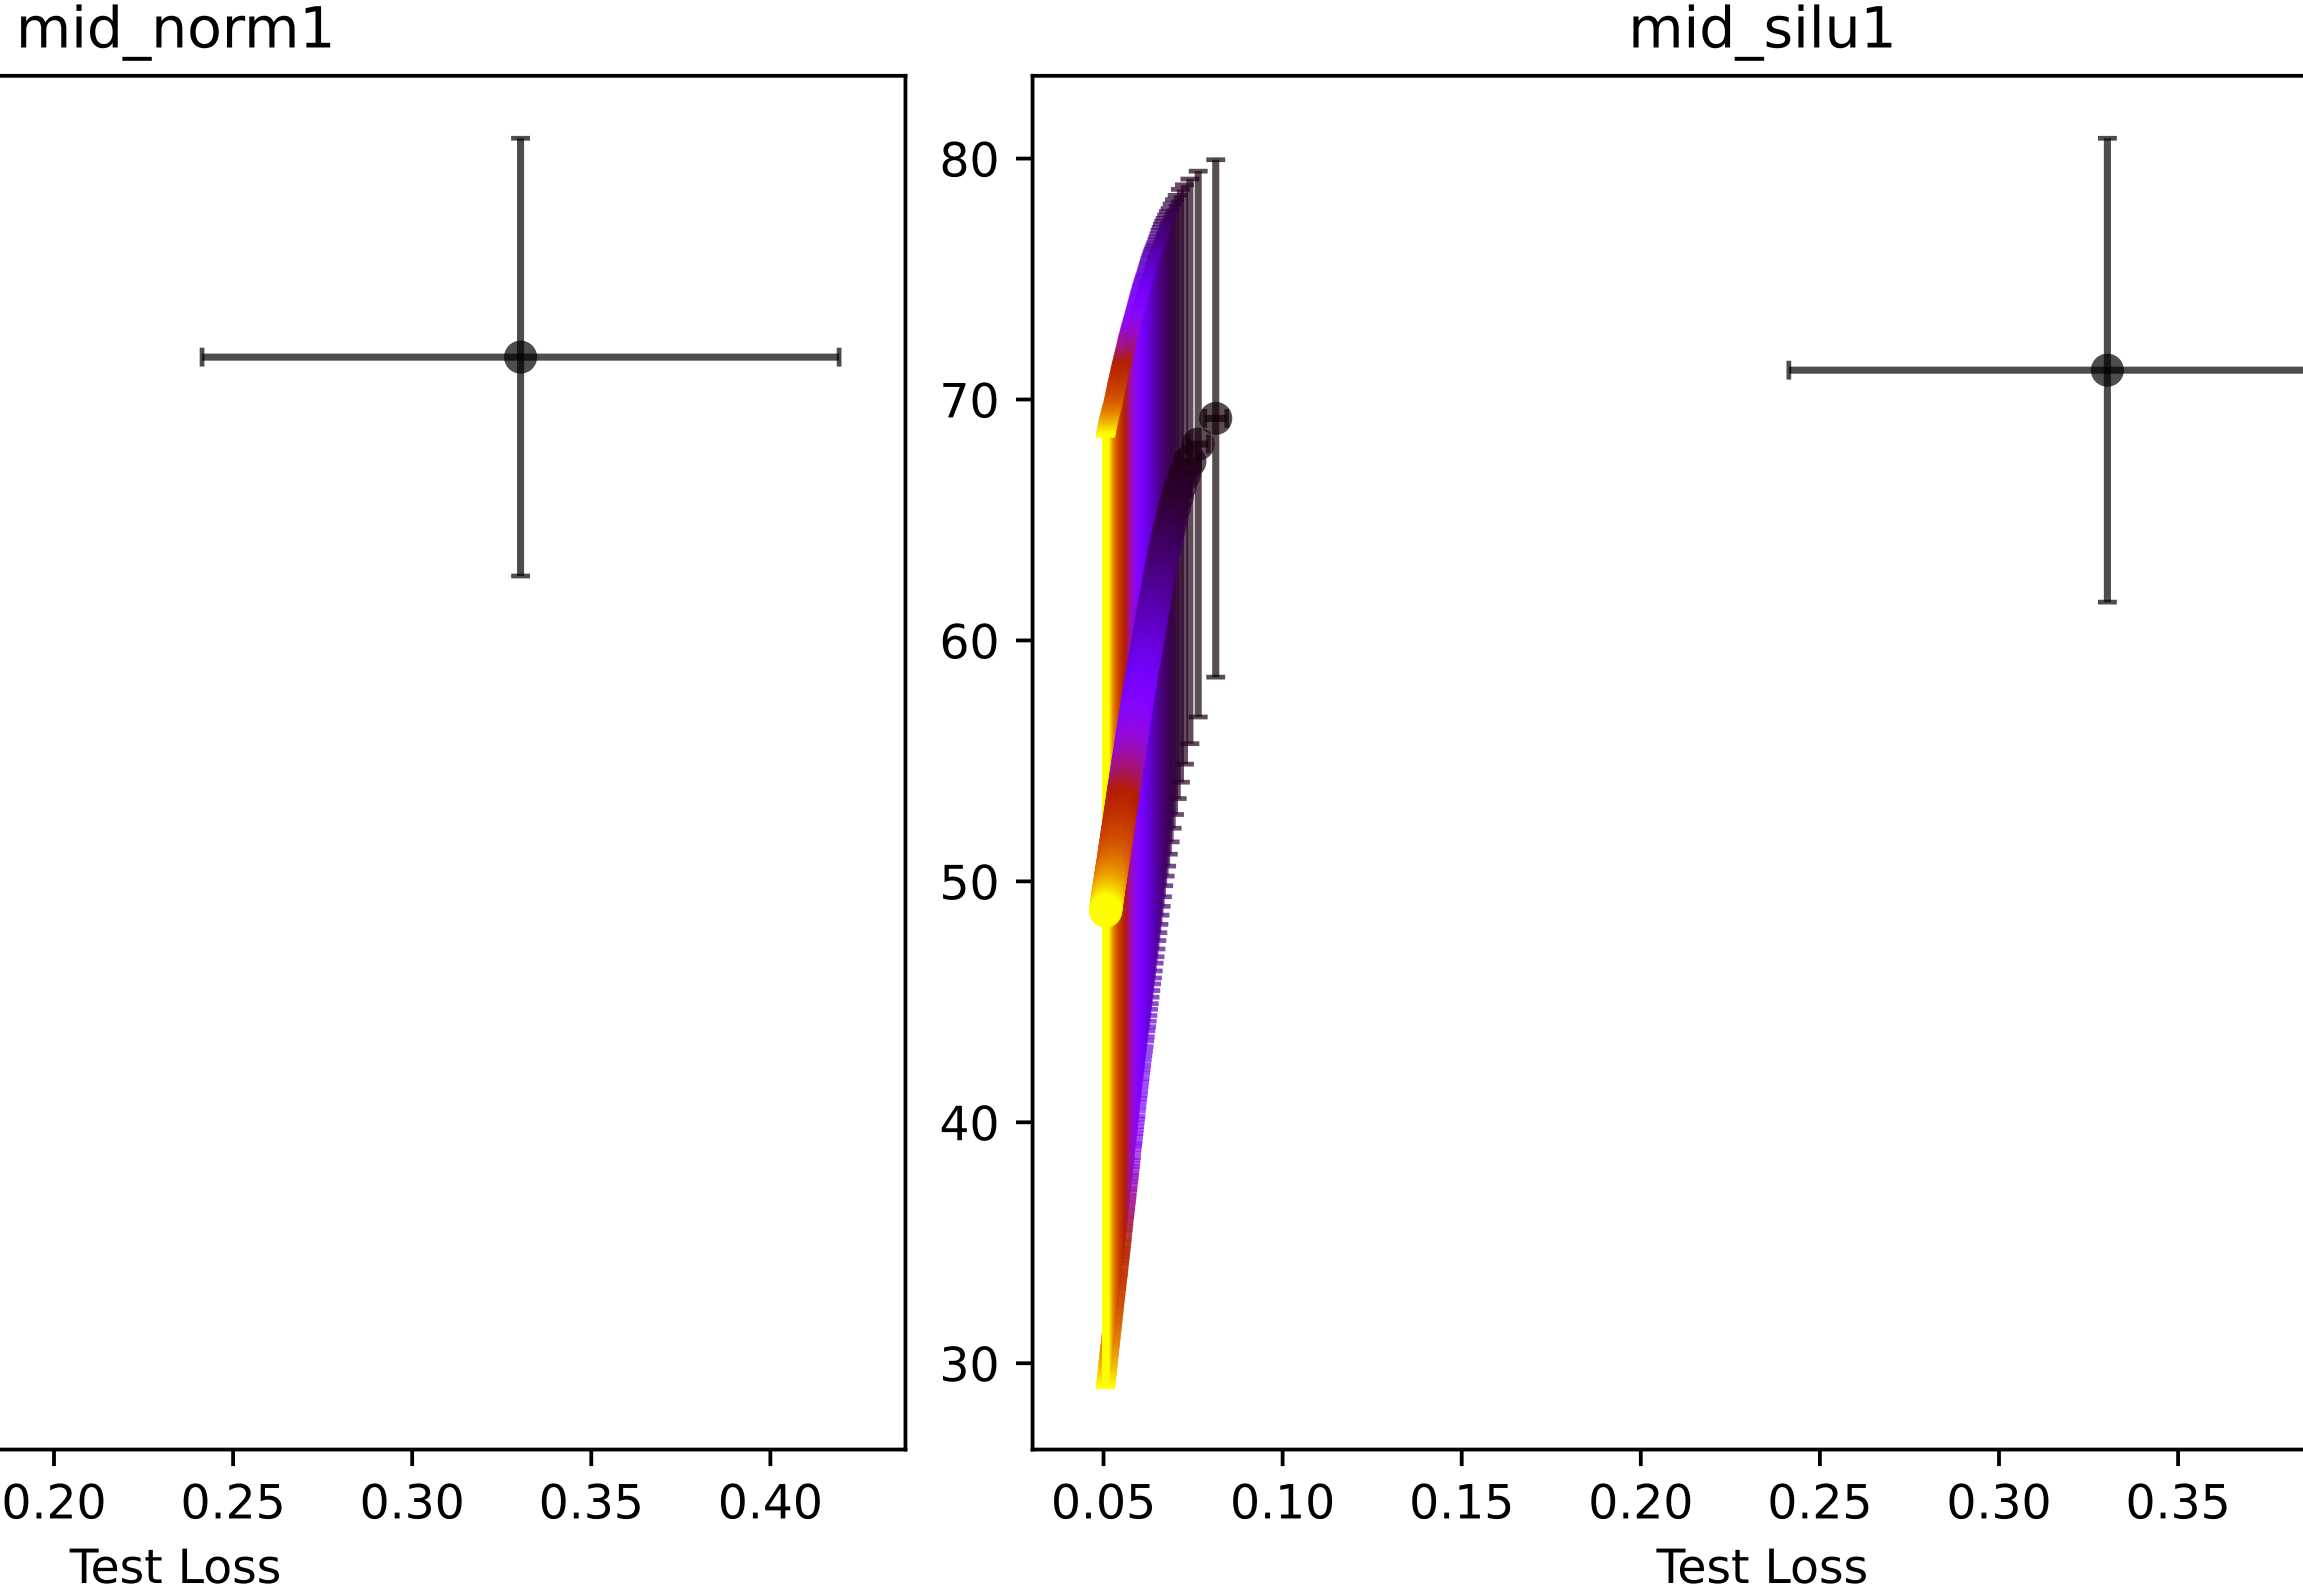
mid_norm1
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
mid_silu1
80
70
60
50
40
30
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

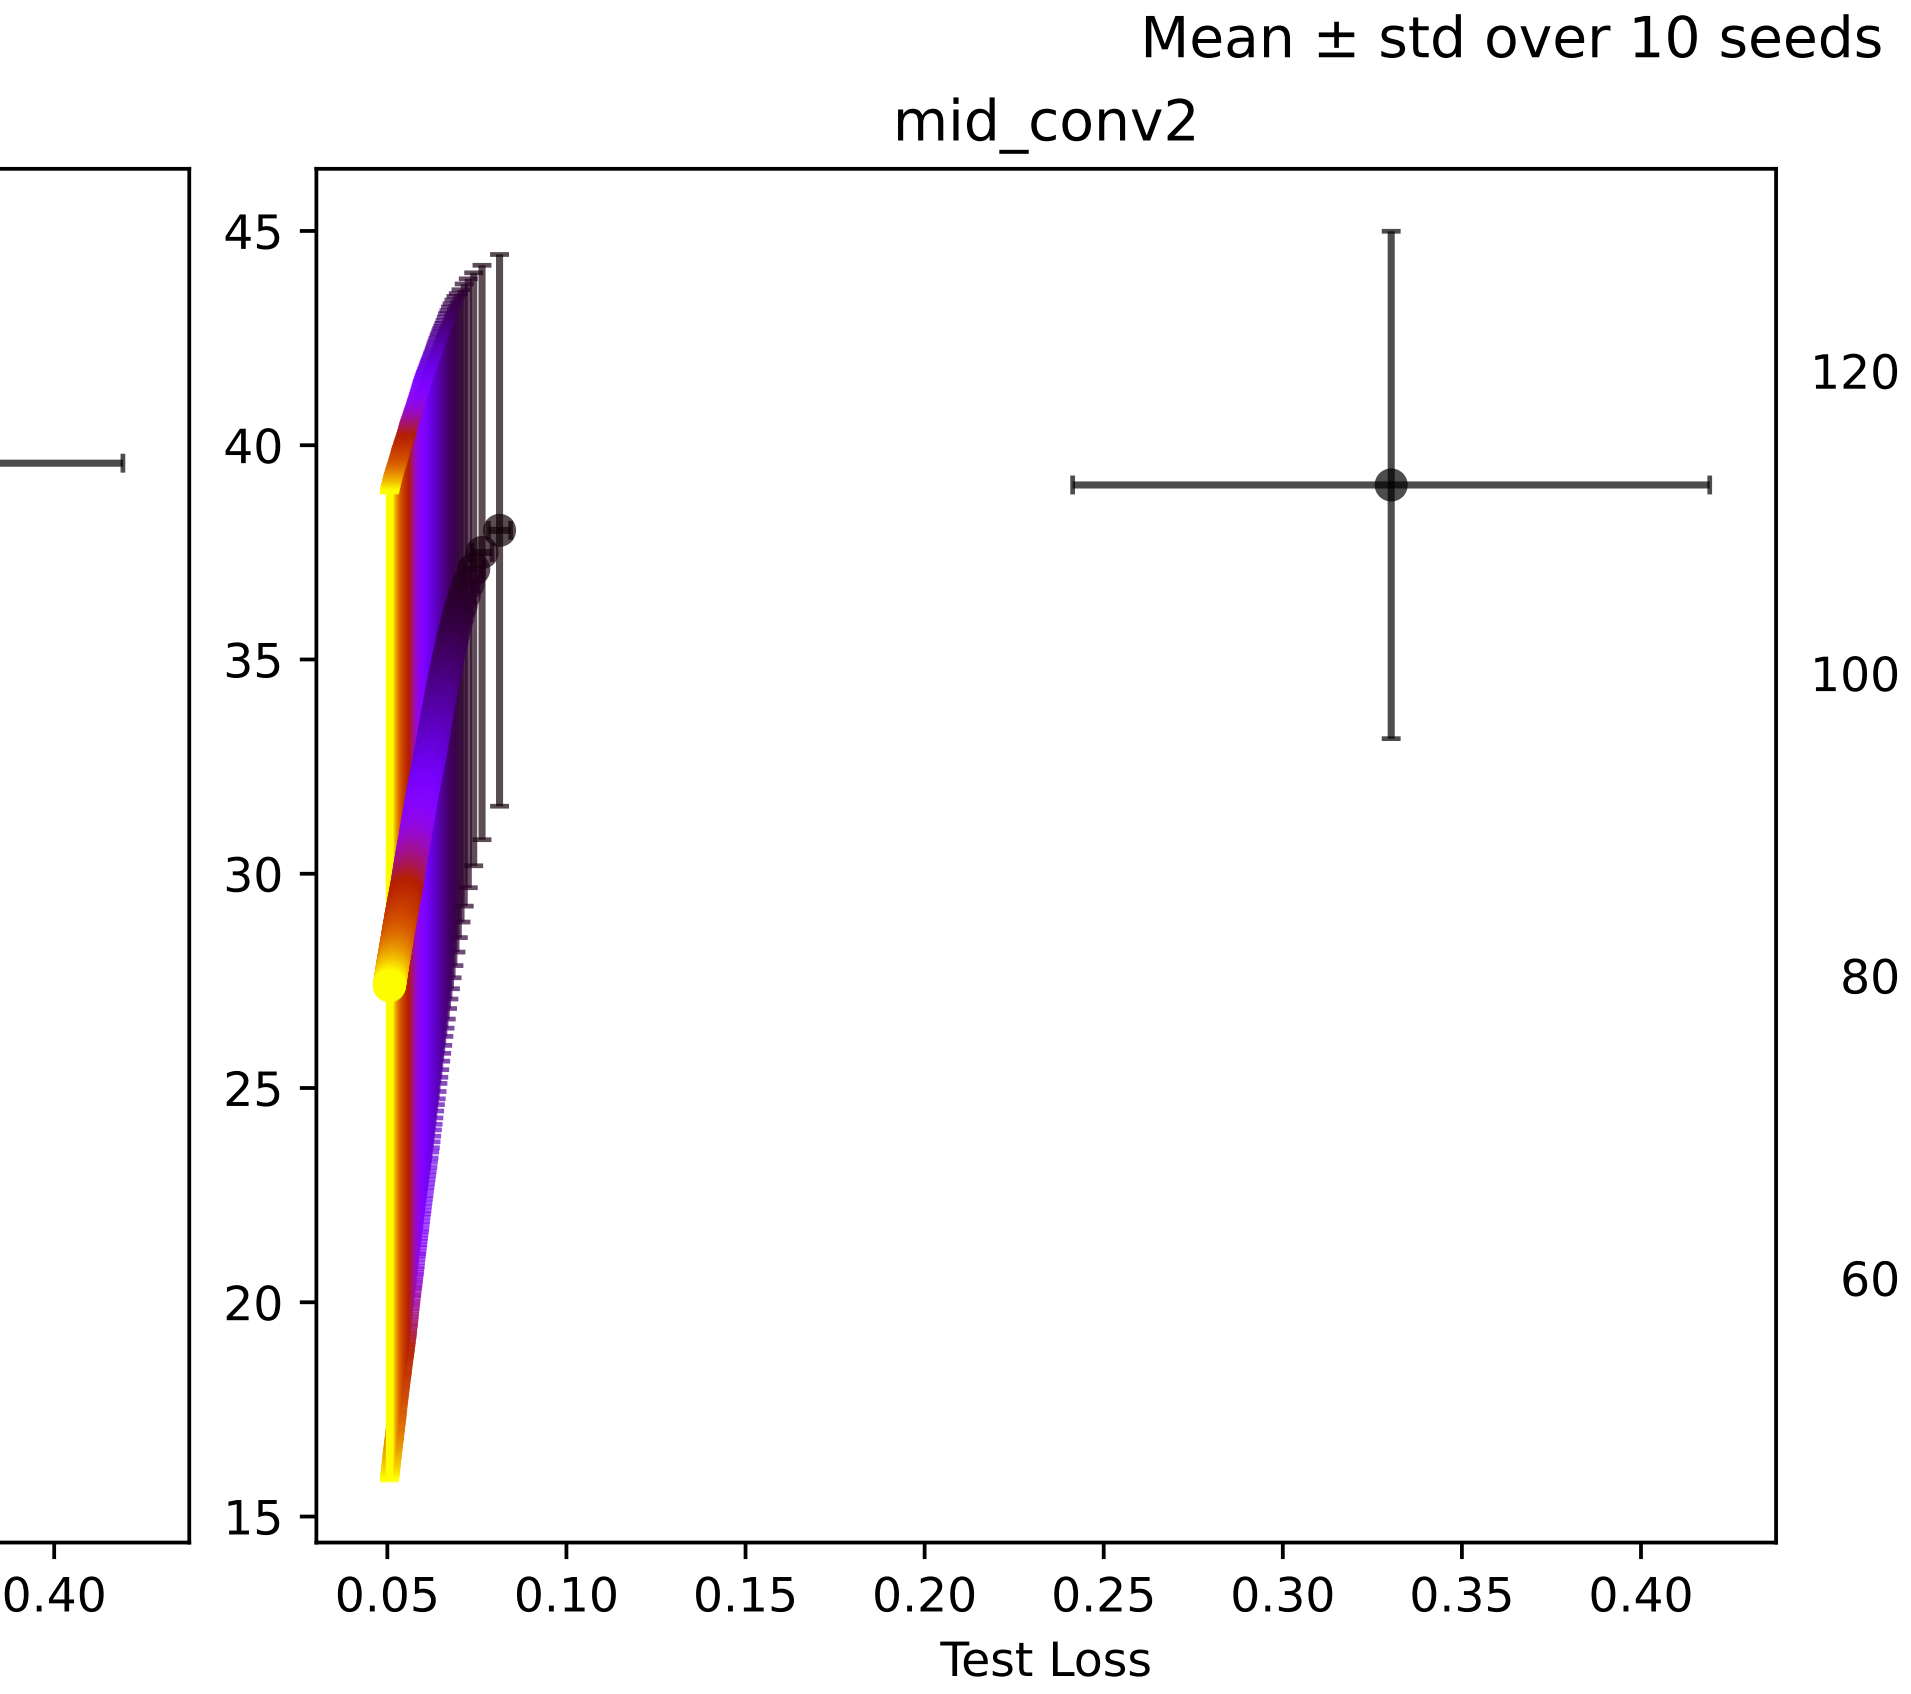
Mean ± std over 10 seeds
mid_conv2
45
40
35
30
25
20
15
0.40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
120
100
80
60

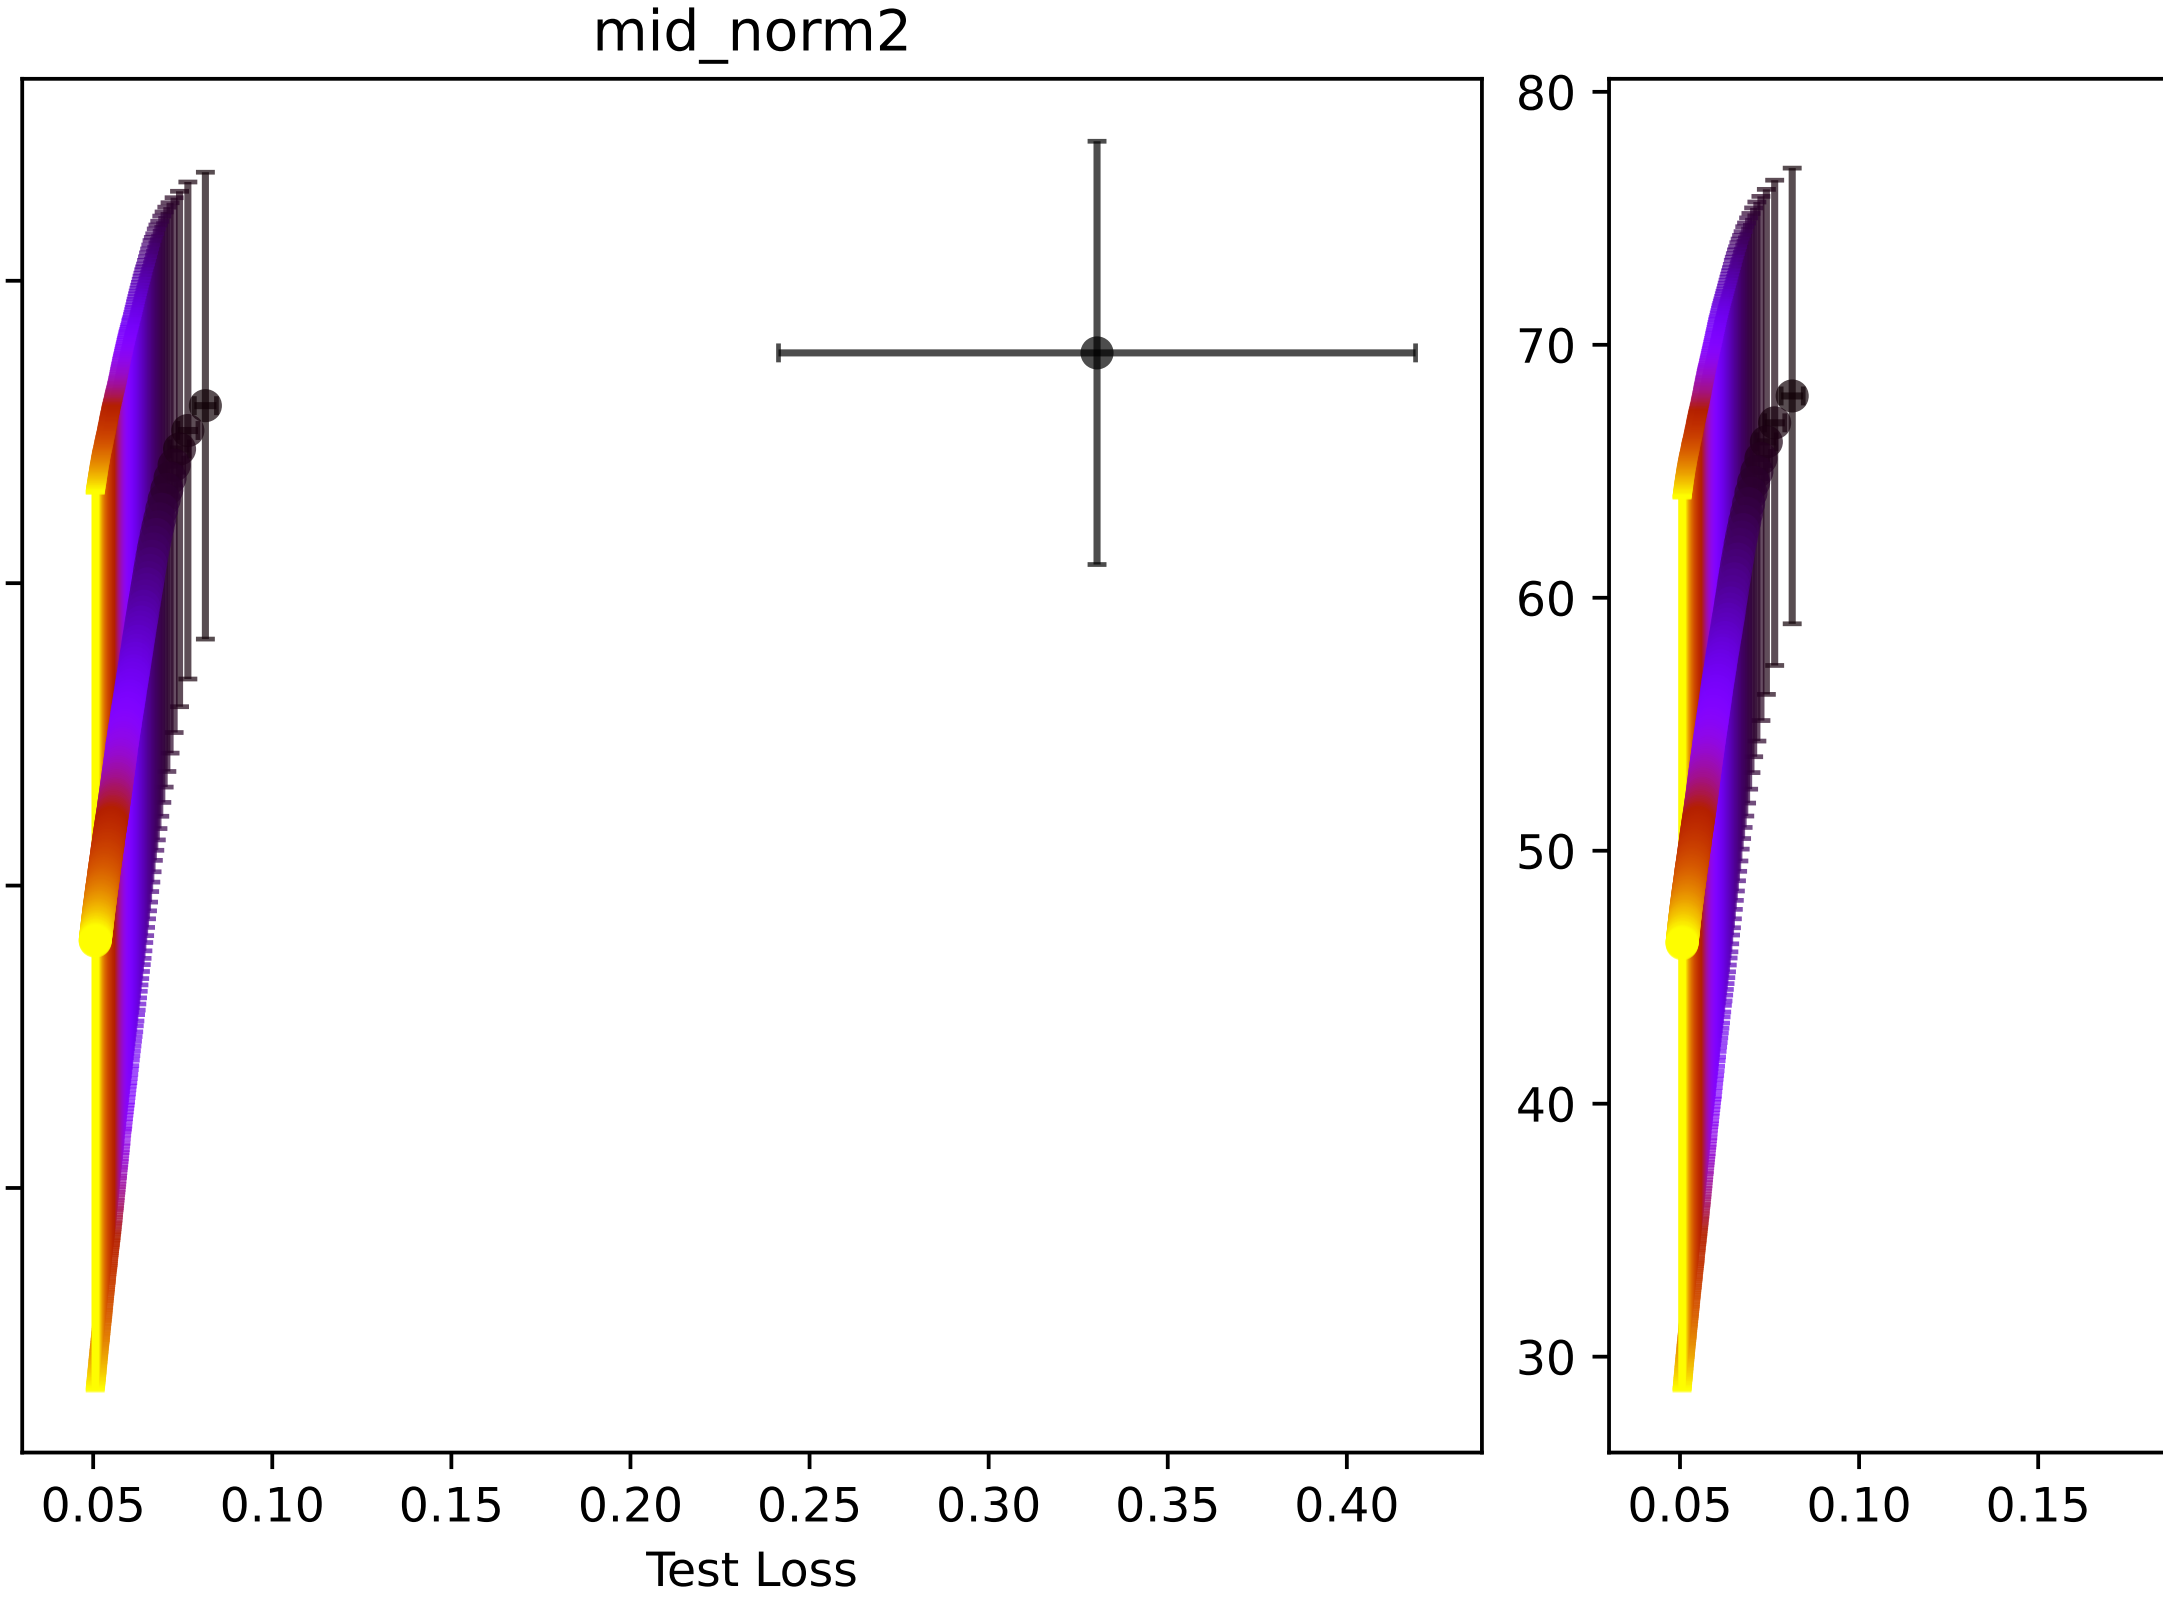
mid_norm2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
80
70
60
50
40
30
0.05
0.10
0.15

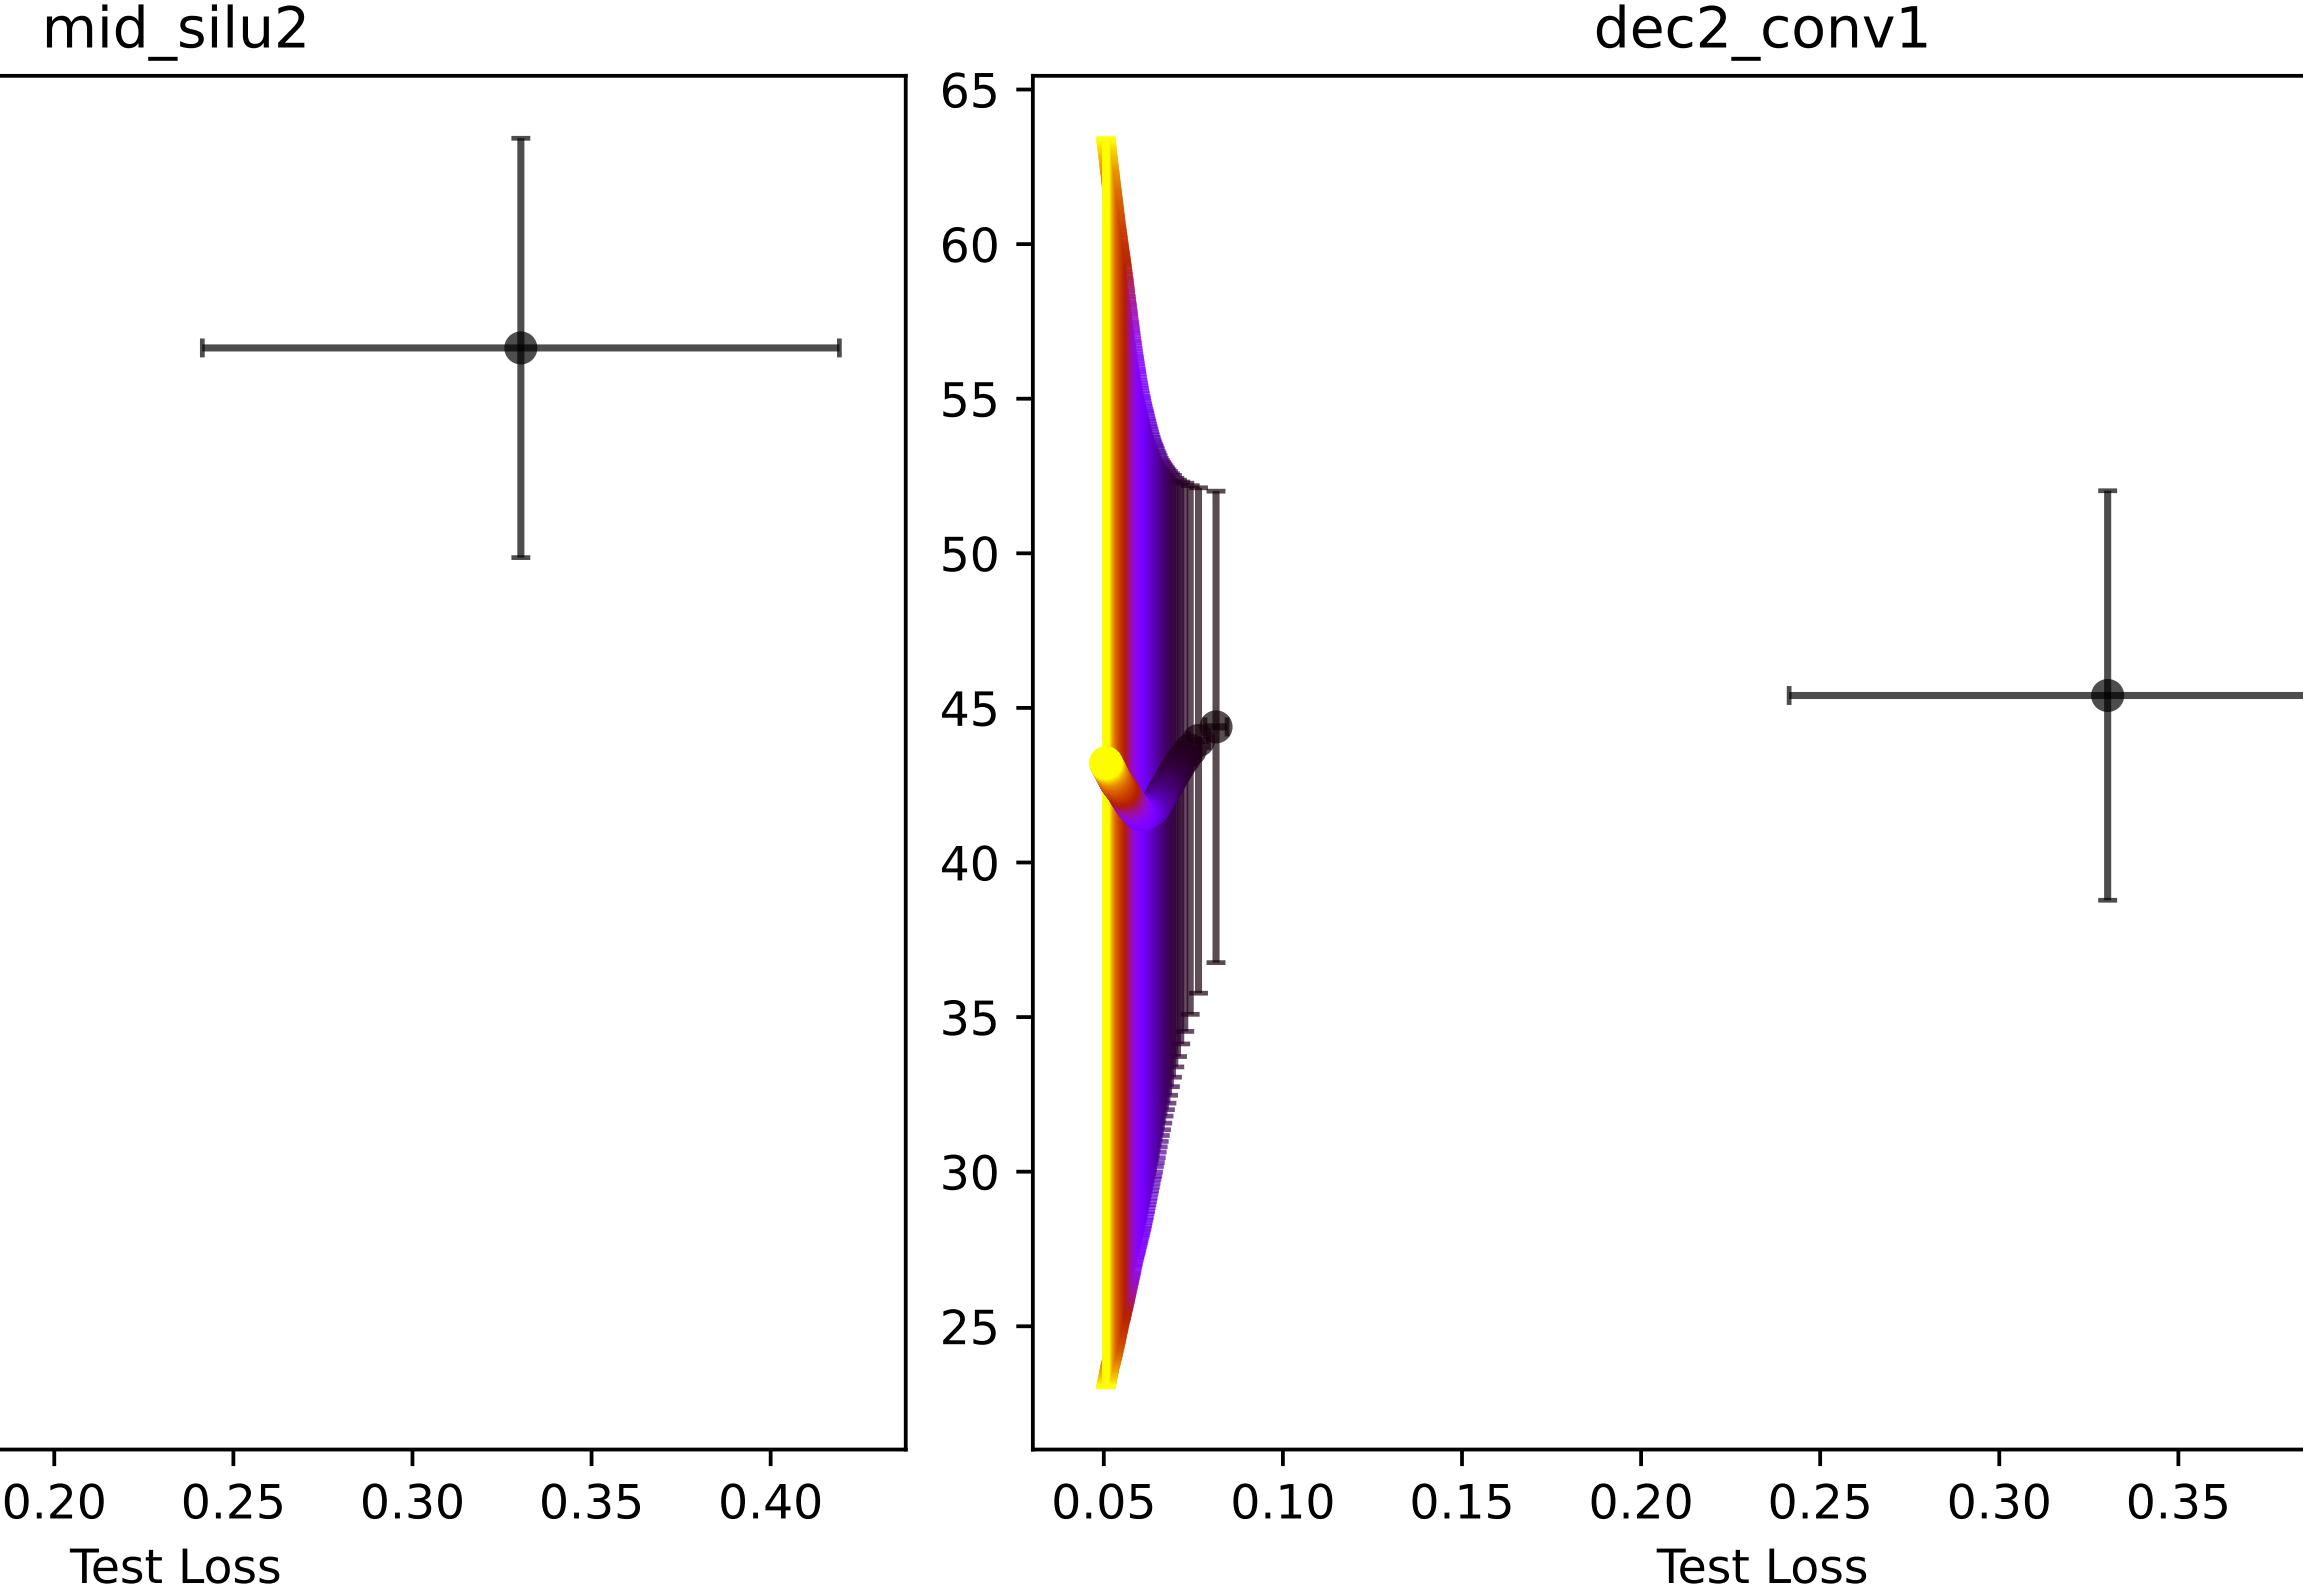
mid_silu2
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
dec2_conv1
65
60
55
50
45
40
35
30
25
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

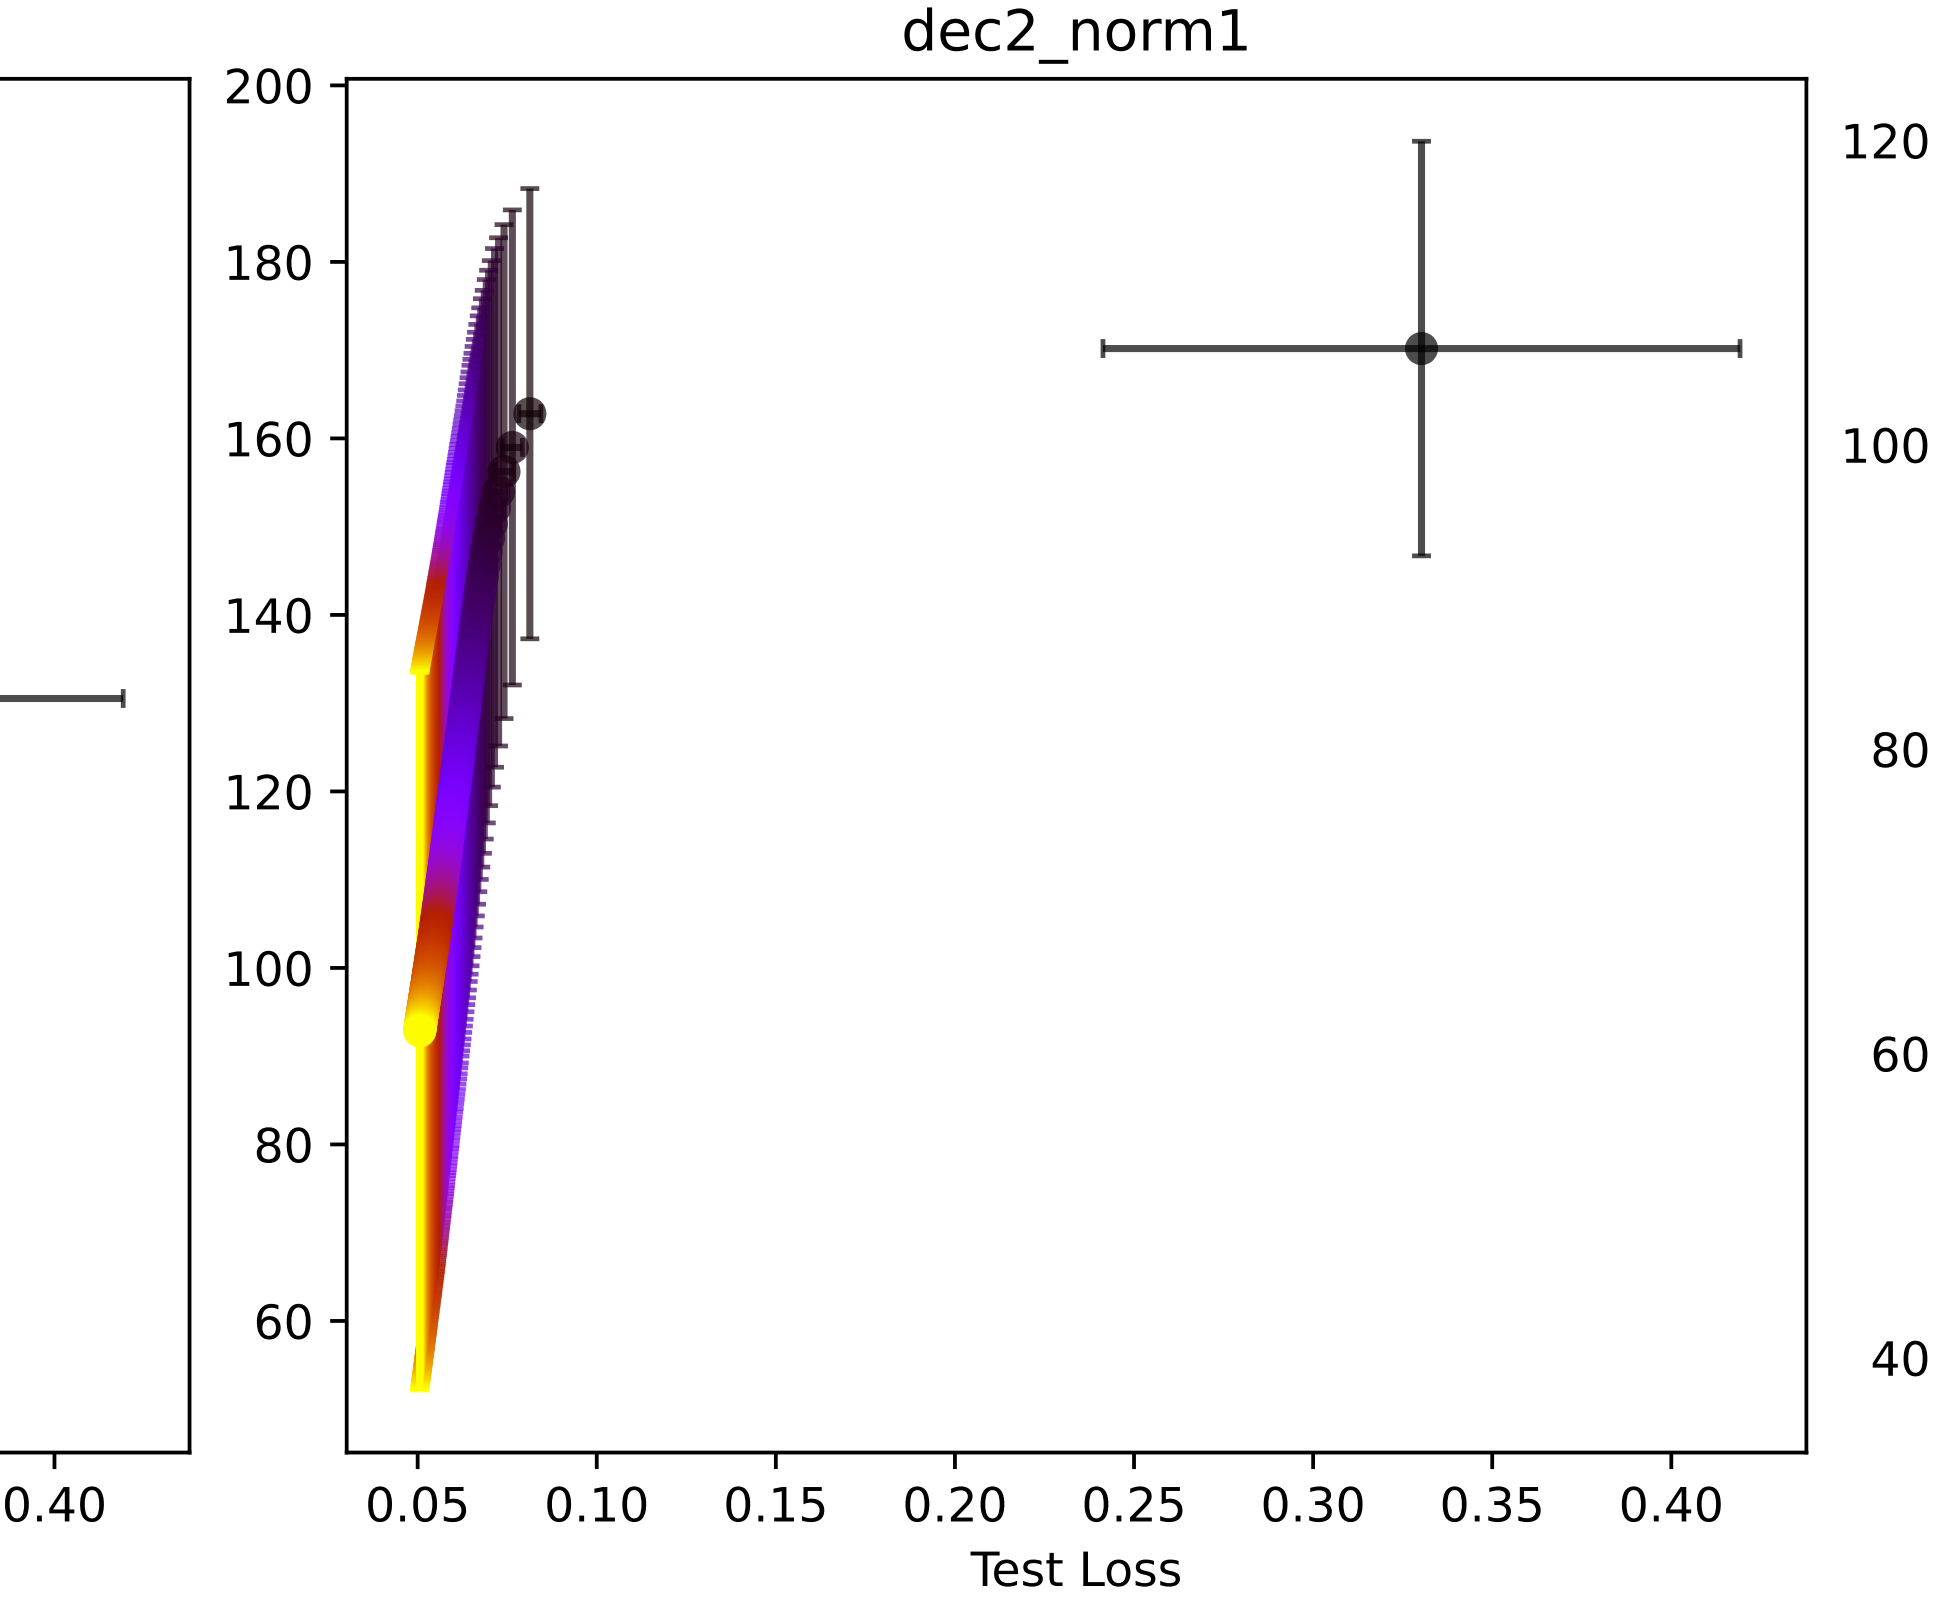
dec2_norm1
200
180
160
140
120
100
80
60
0.40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
120
100
80
60
40

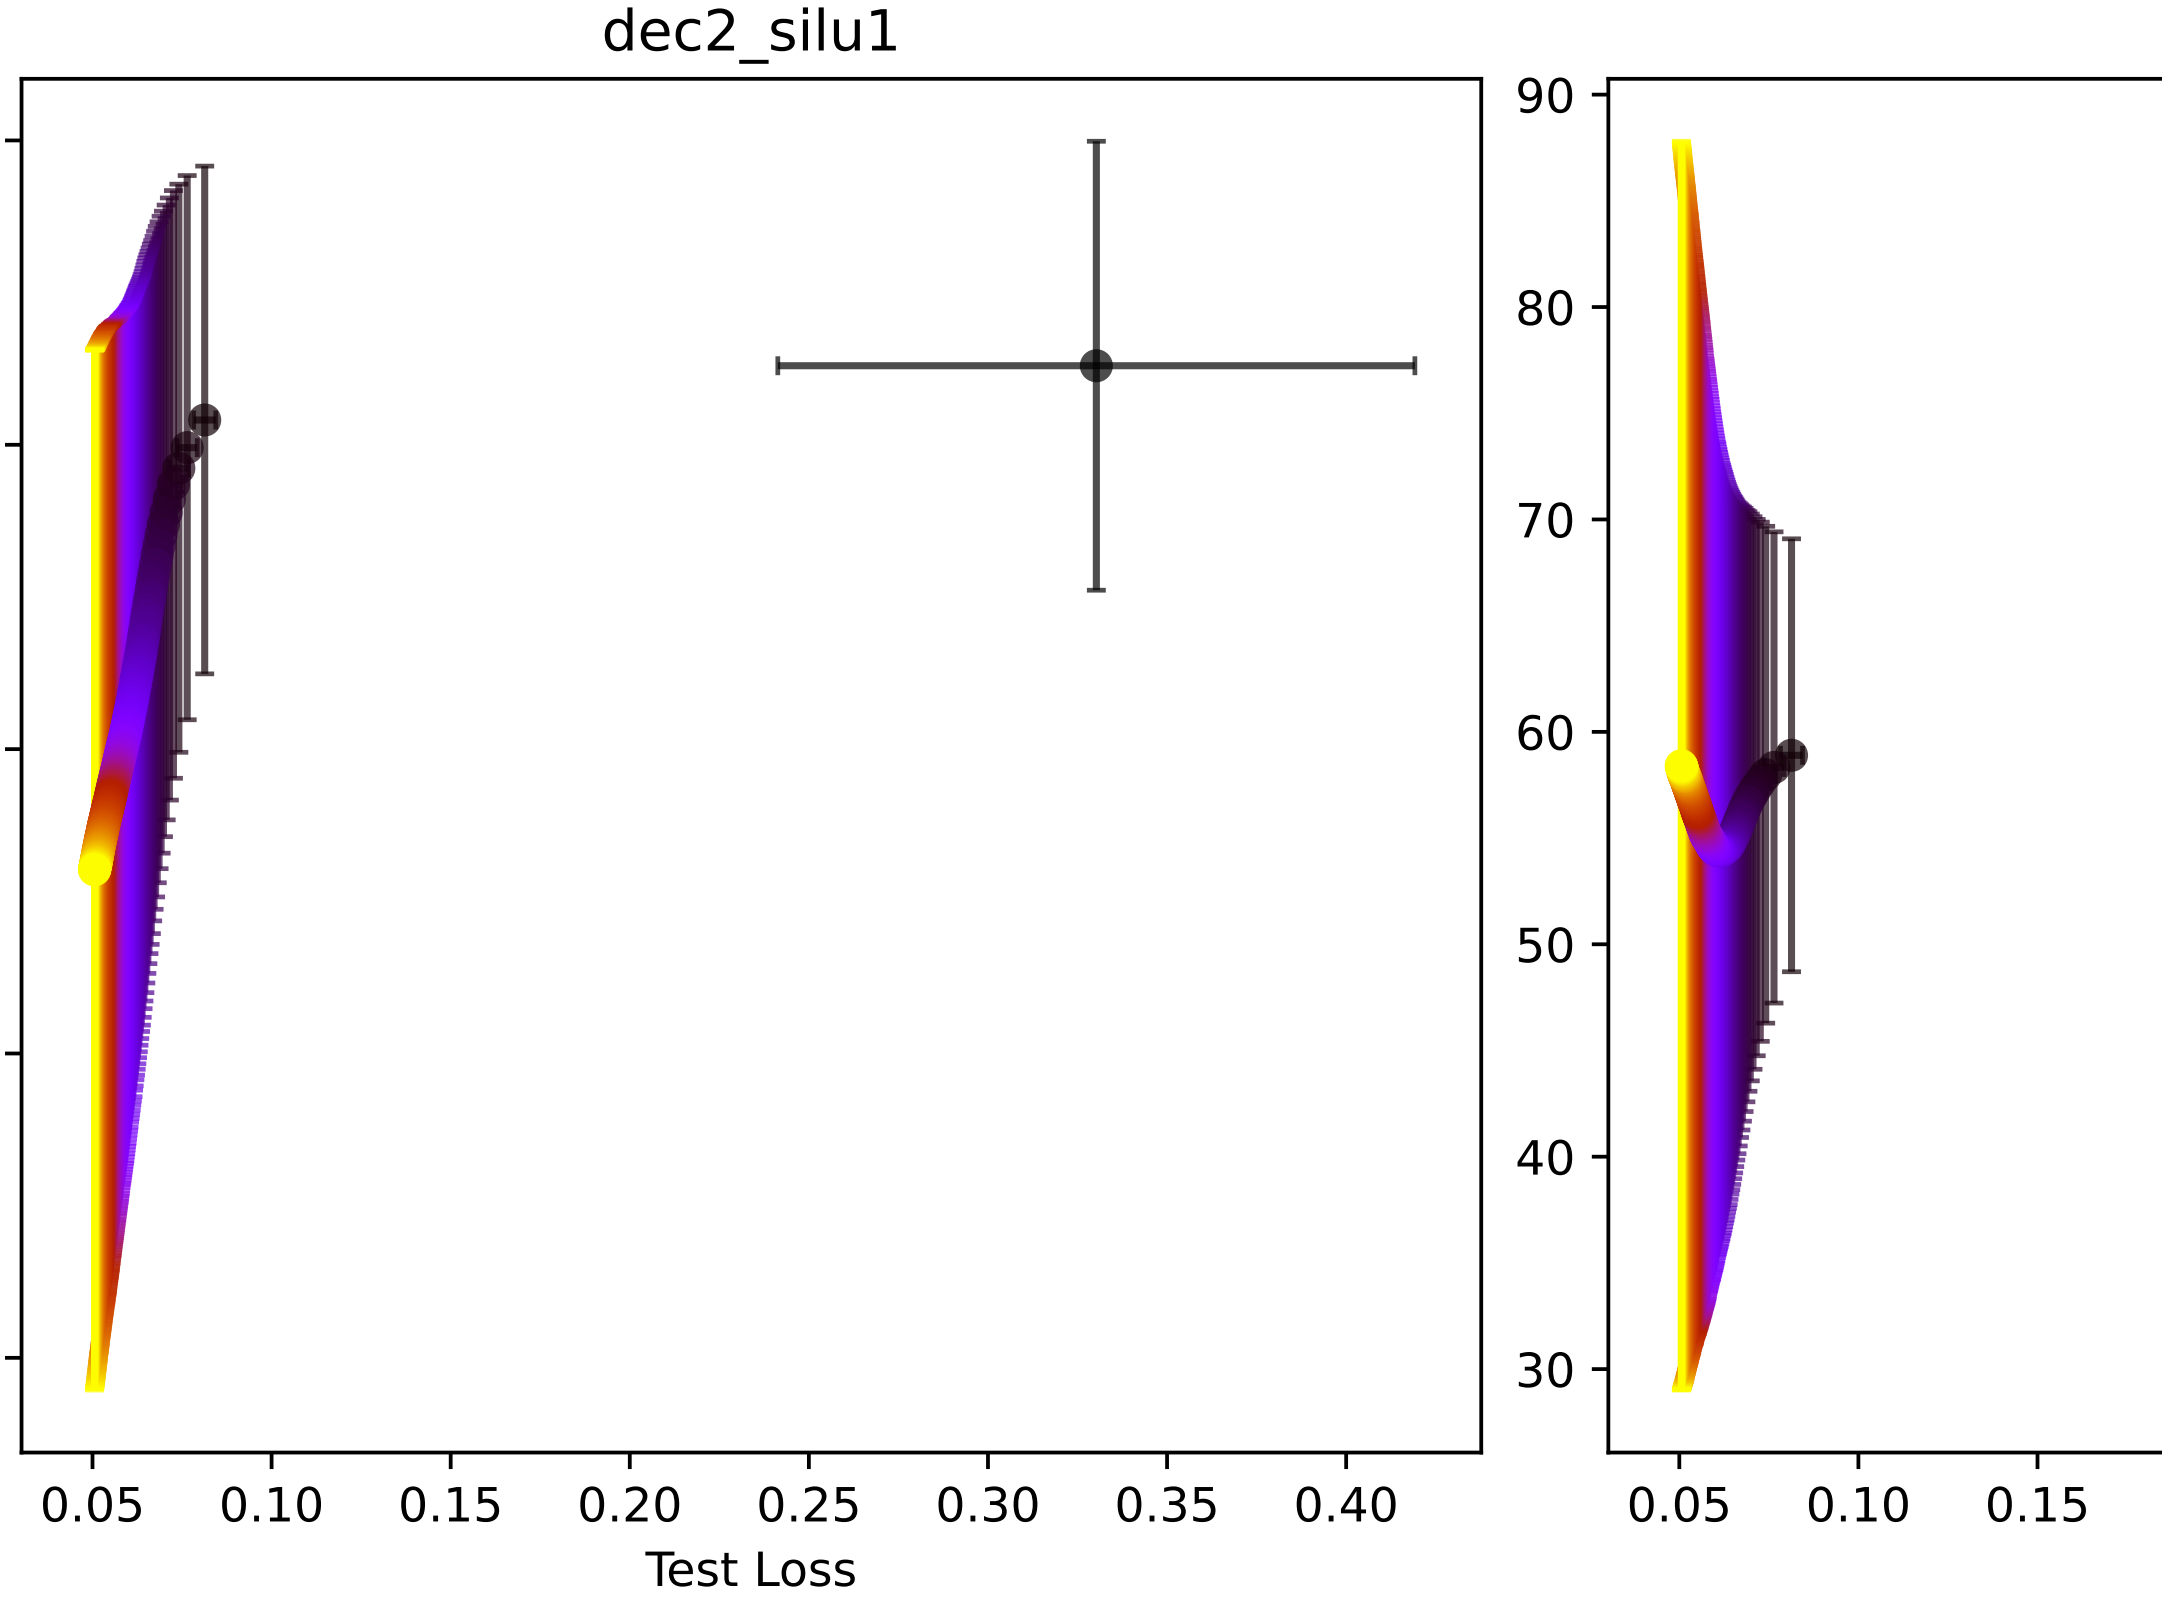
dec2_silu1
90
80
70
60
50
40
30
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
0.05
0.10
0.15

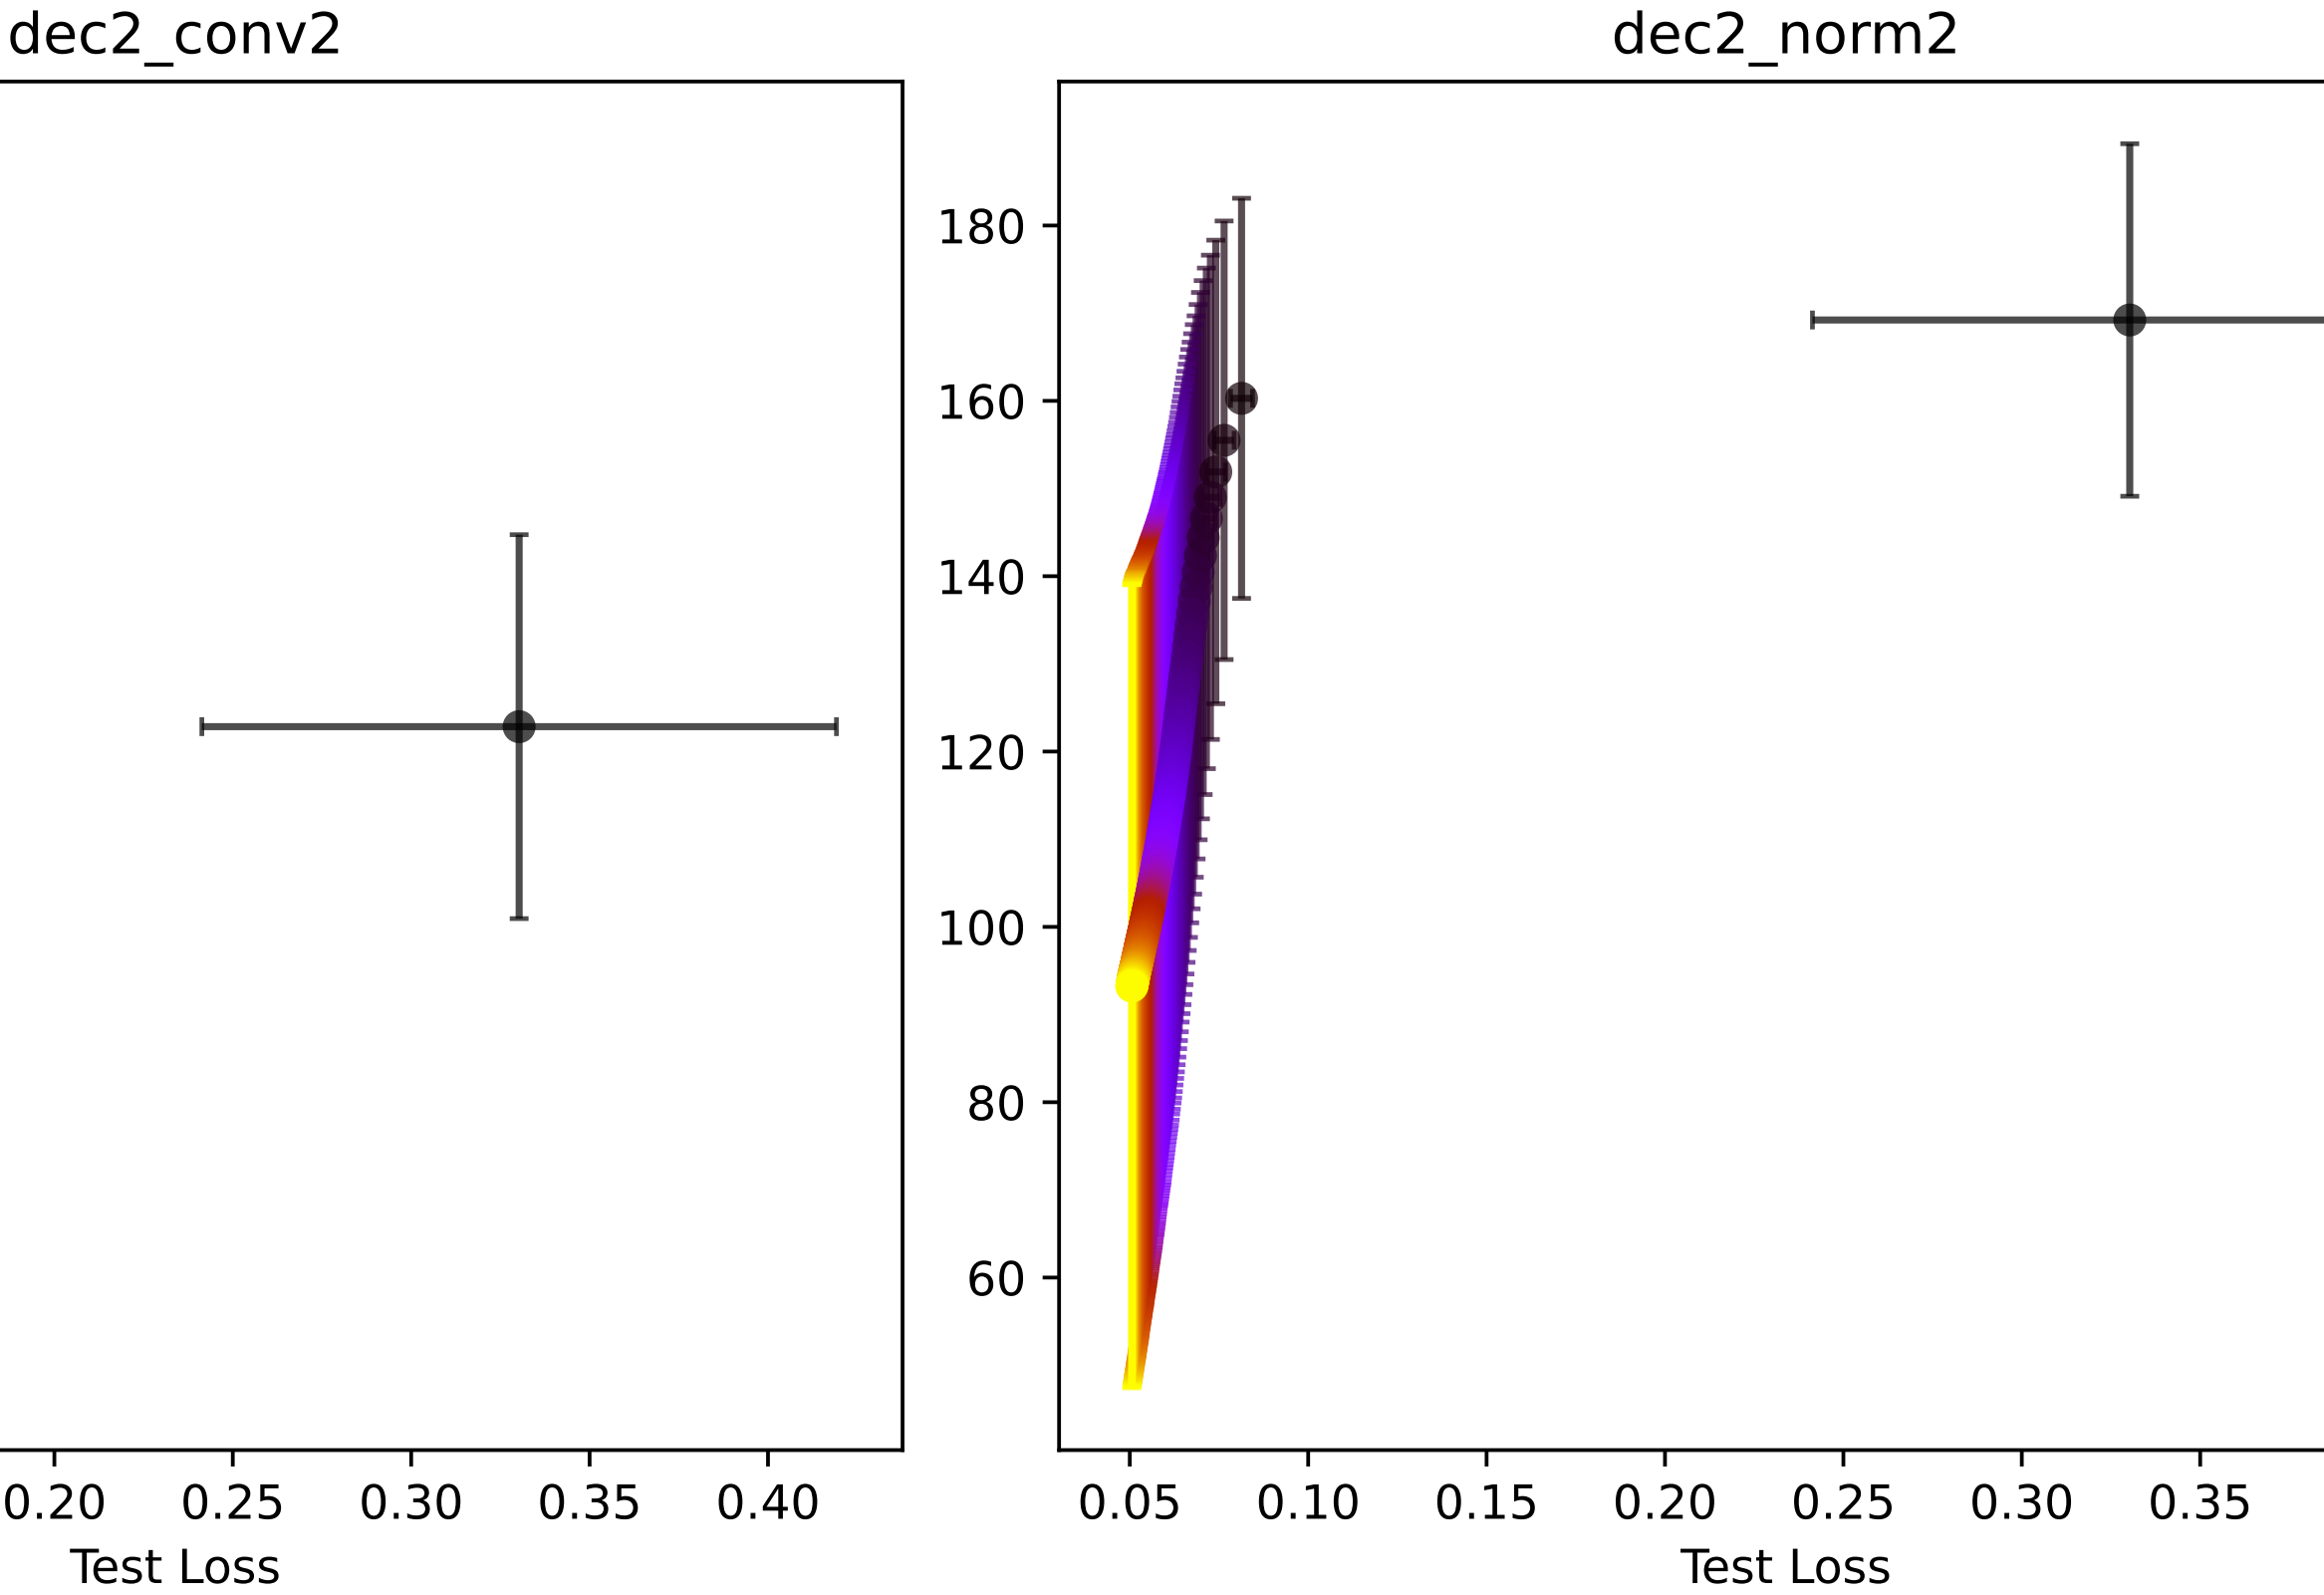
dec2_conv2
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
dec2_norm2
180
160
140
120
100
80
60
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

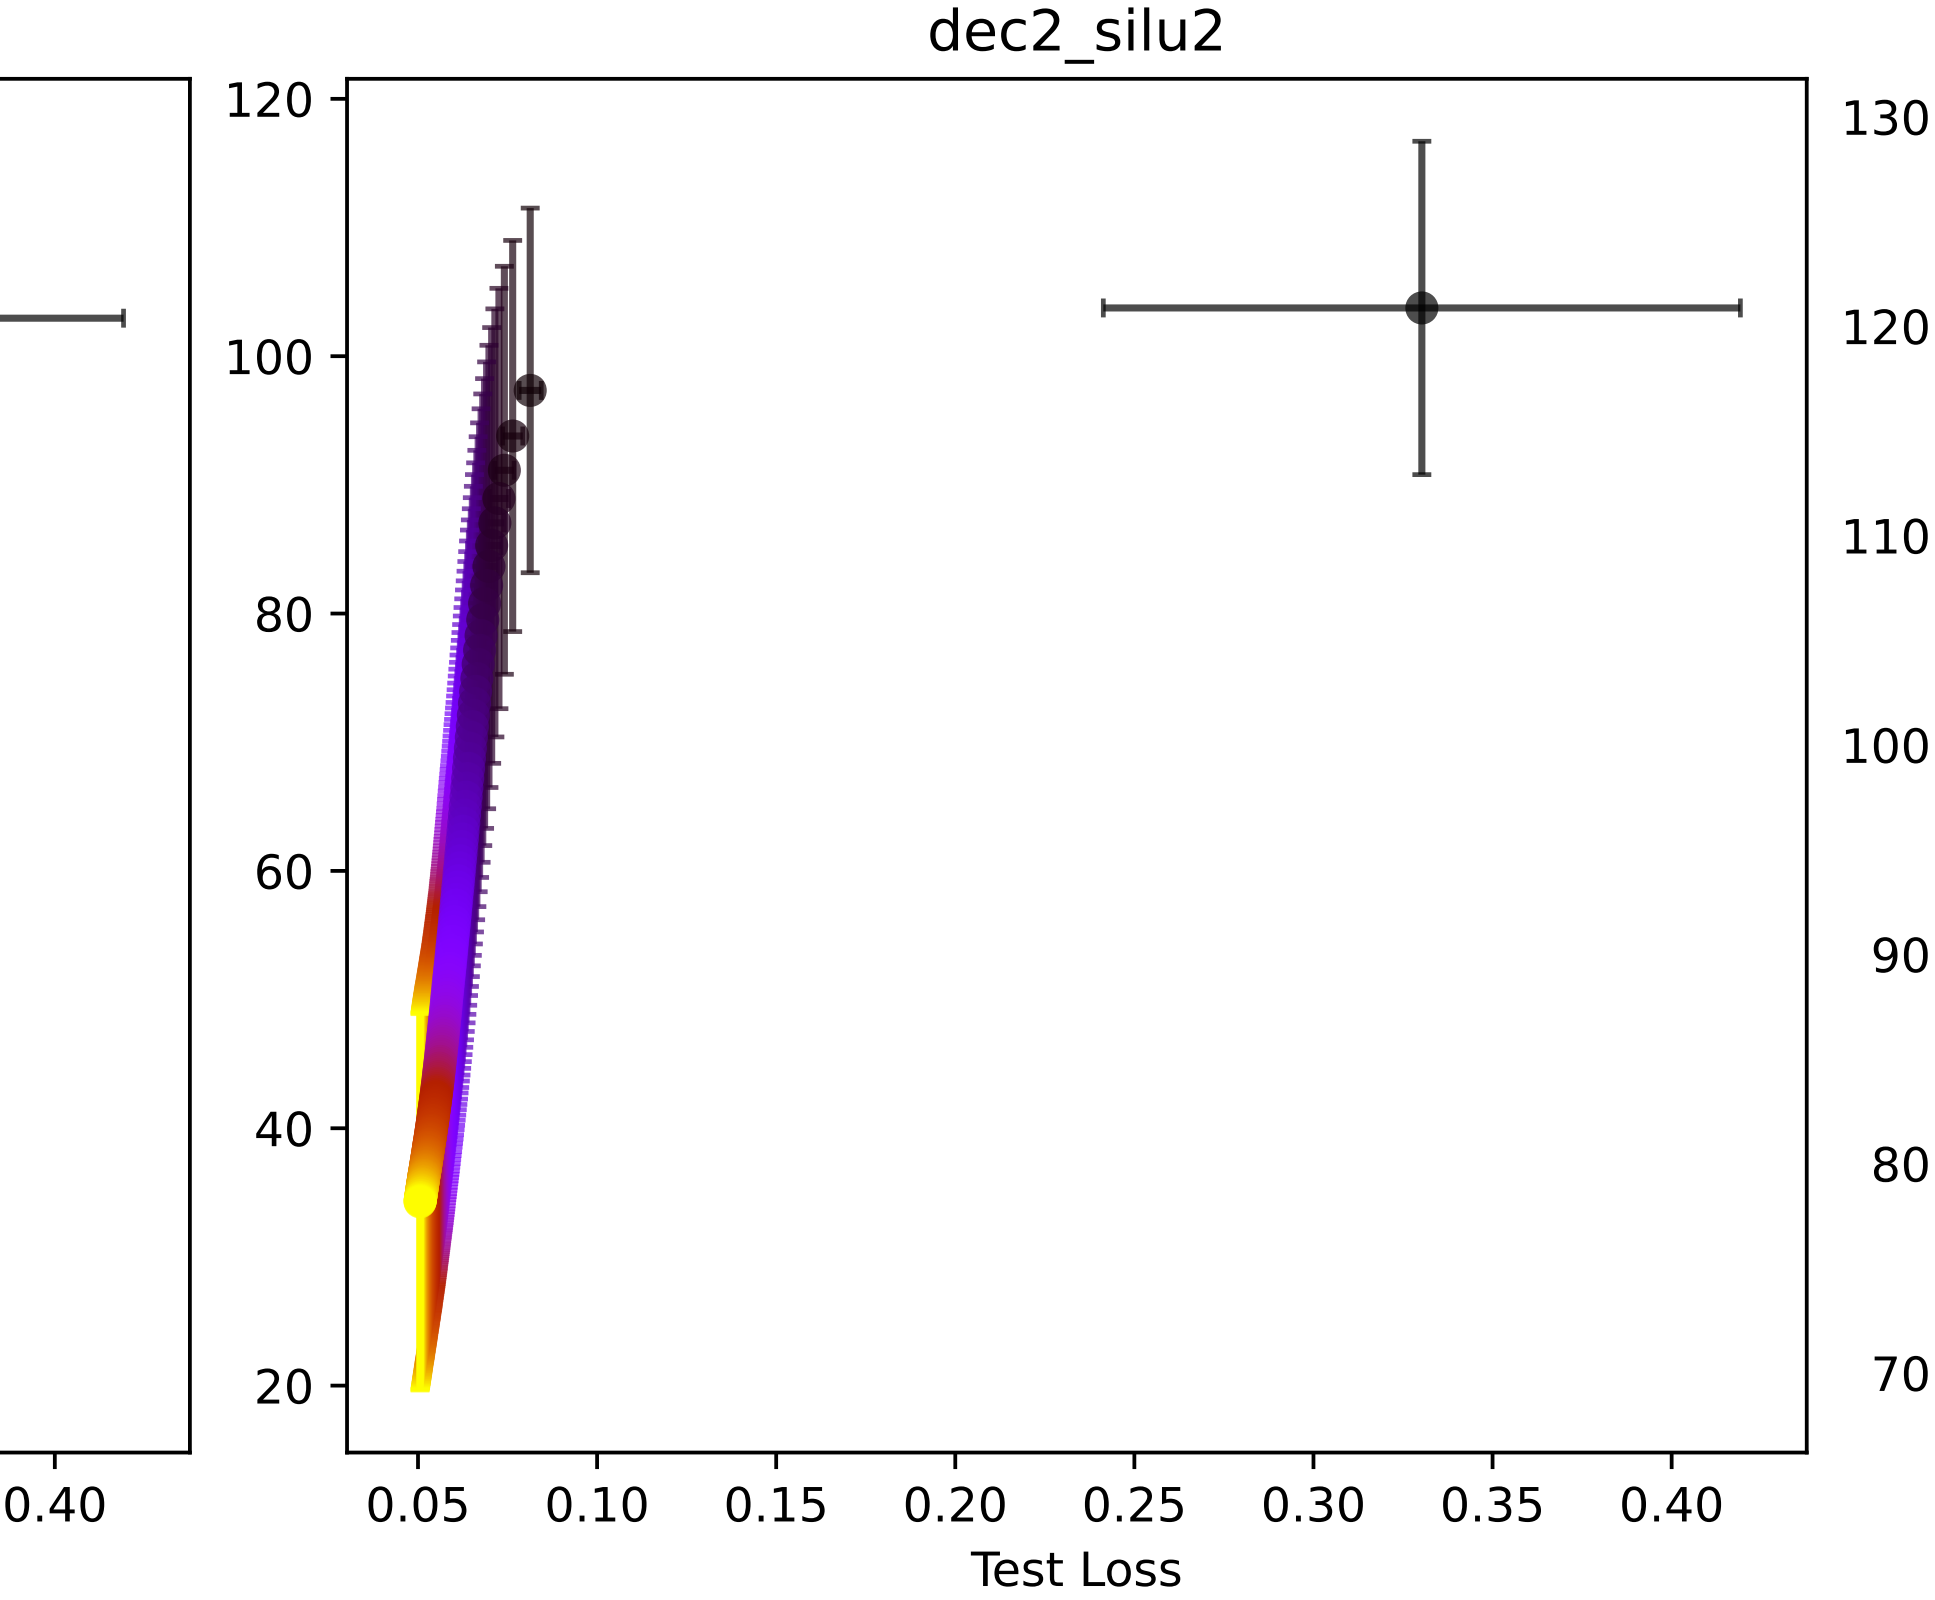
dec2_silu2
120
100
80
60
40
20
130
120
110
100
90
80
70
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.40
Test Loss

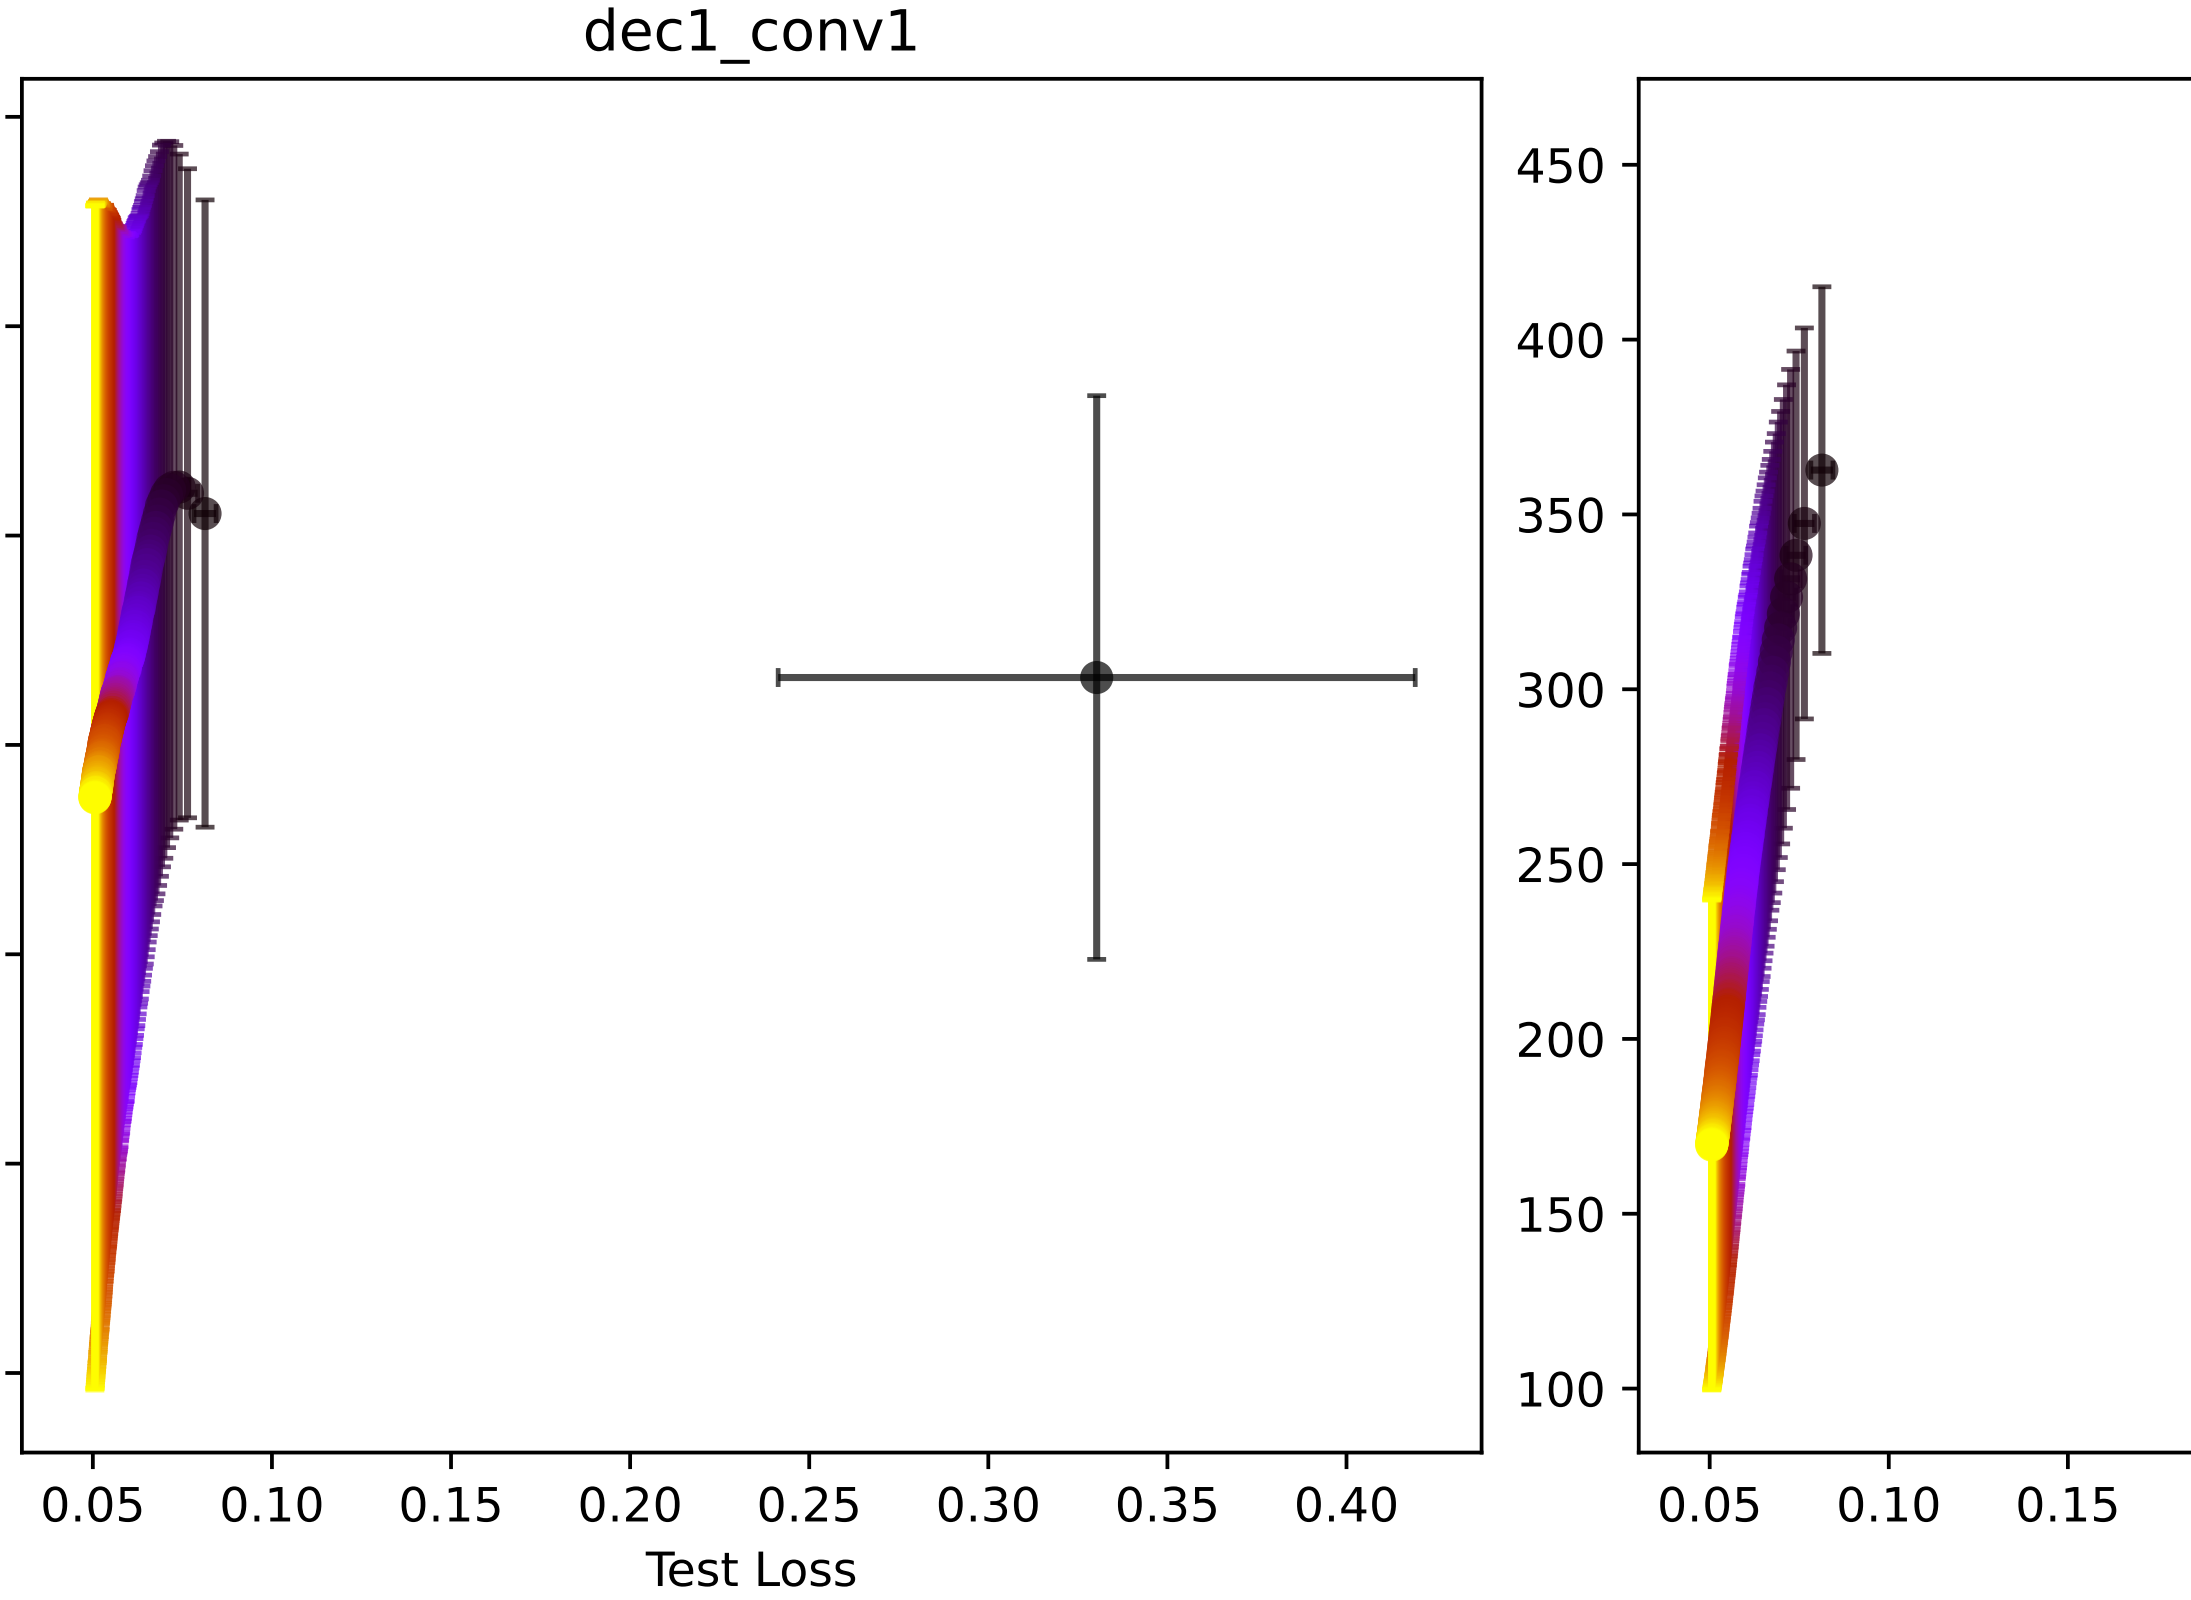
dec1_conv1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
450
400
350
300
250
200
150
100
0.05
0.10
0.15

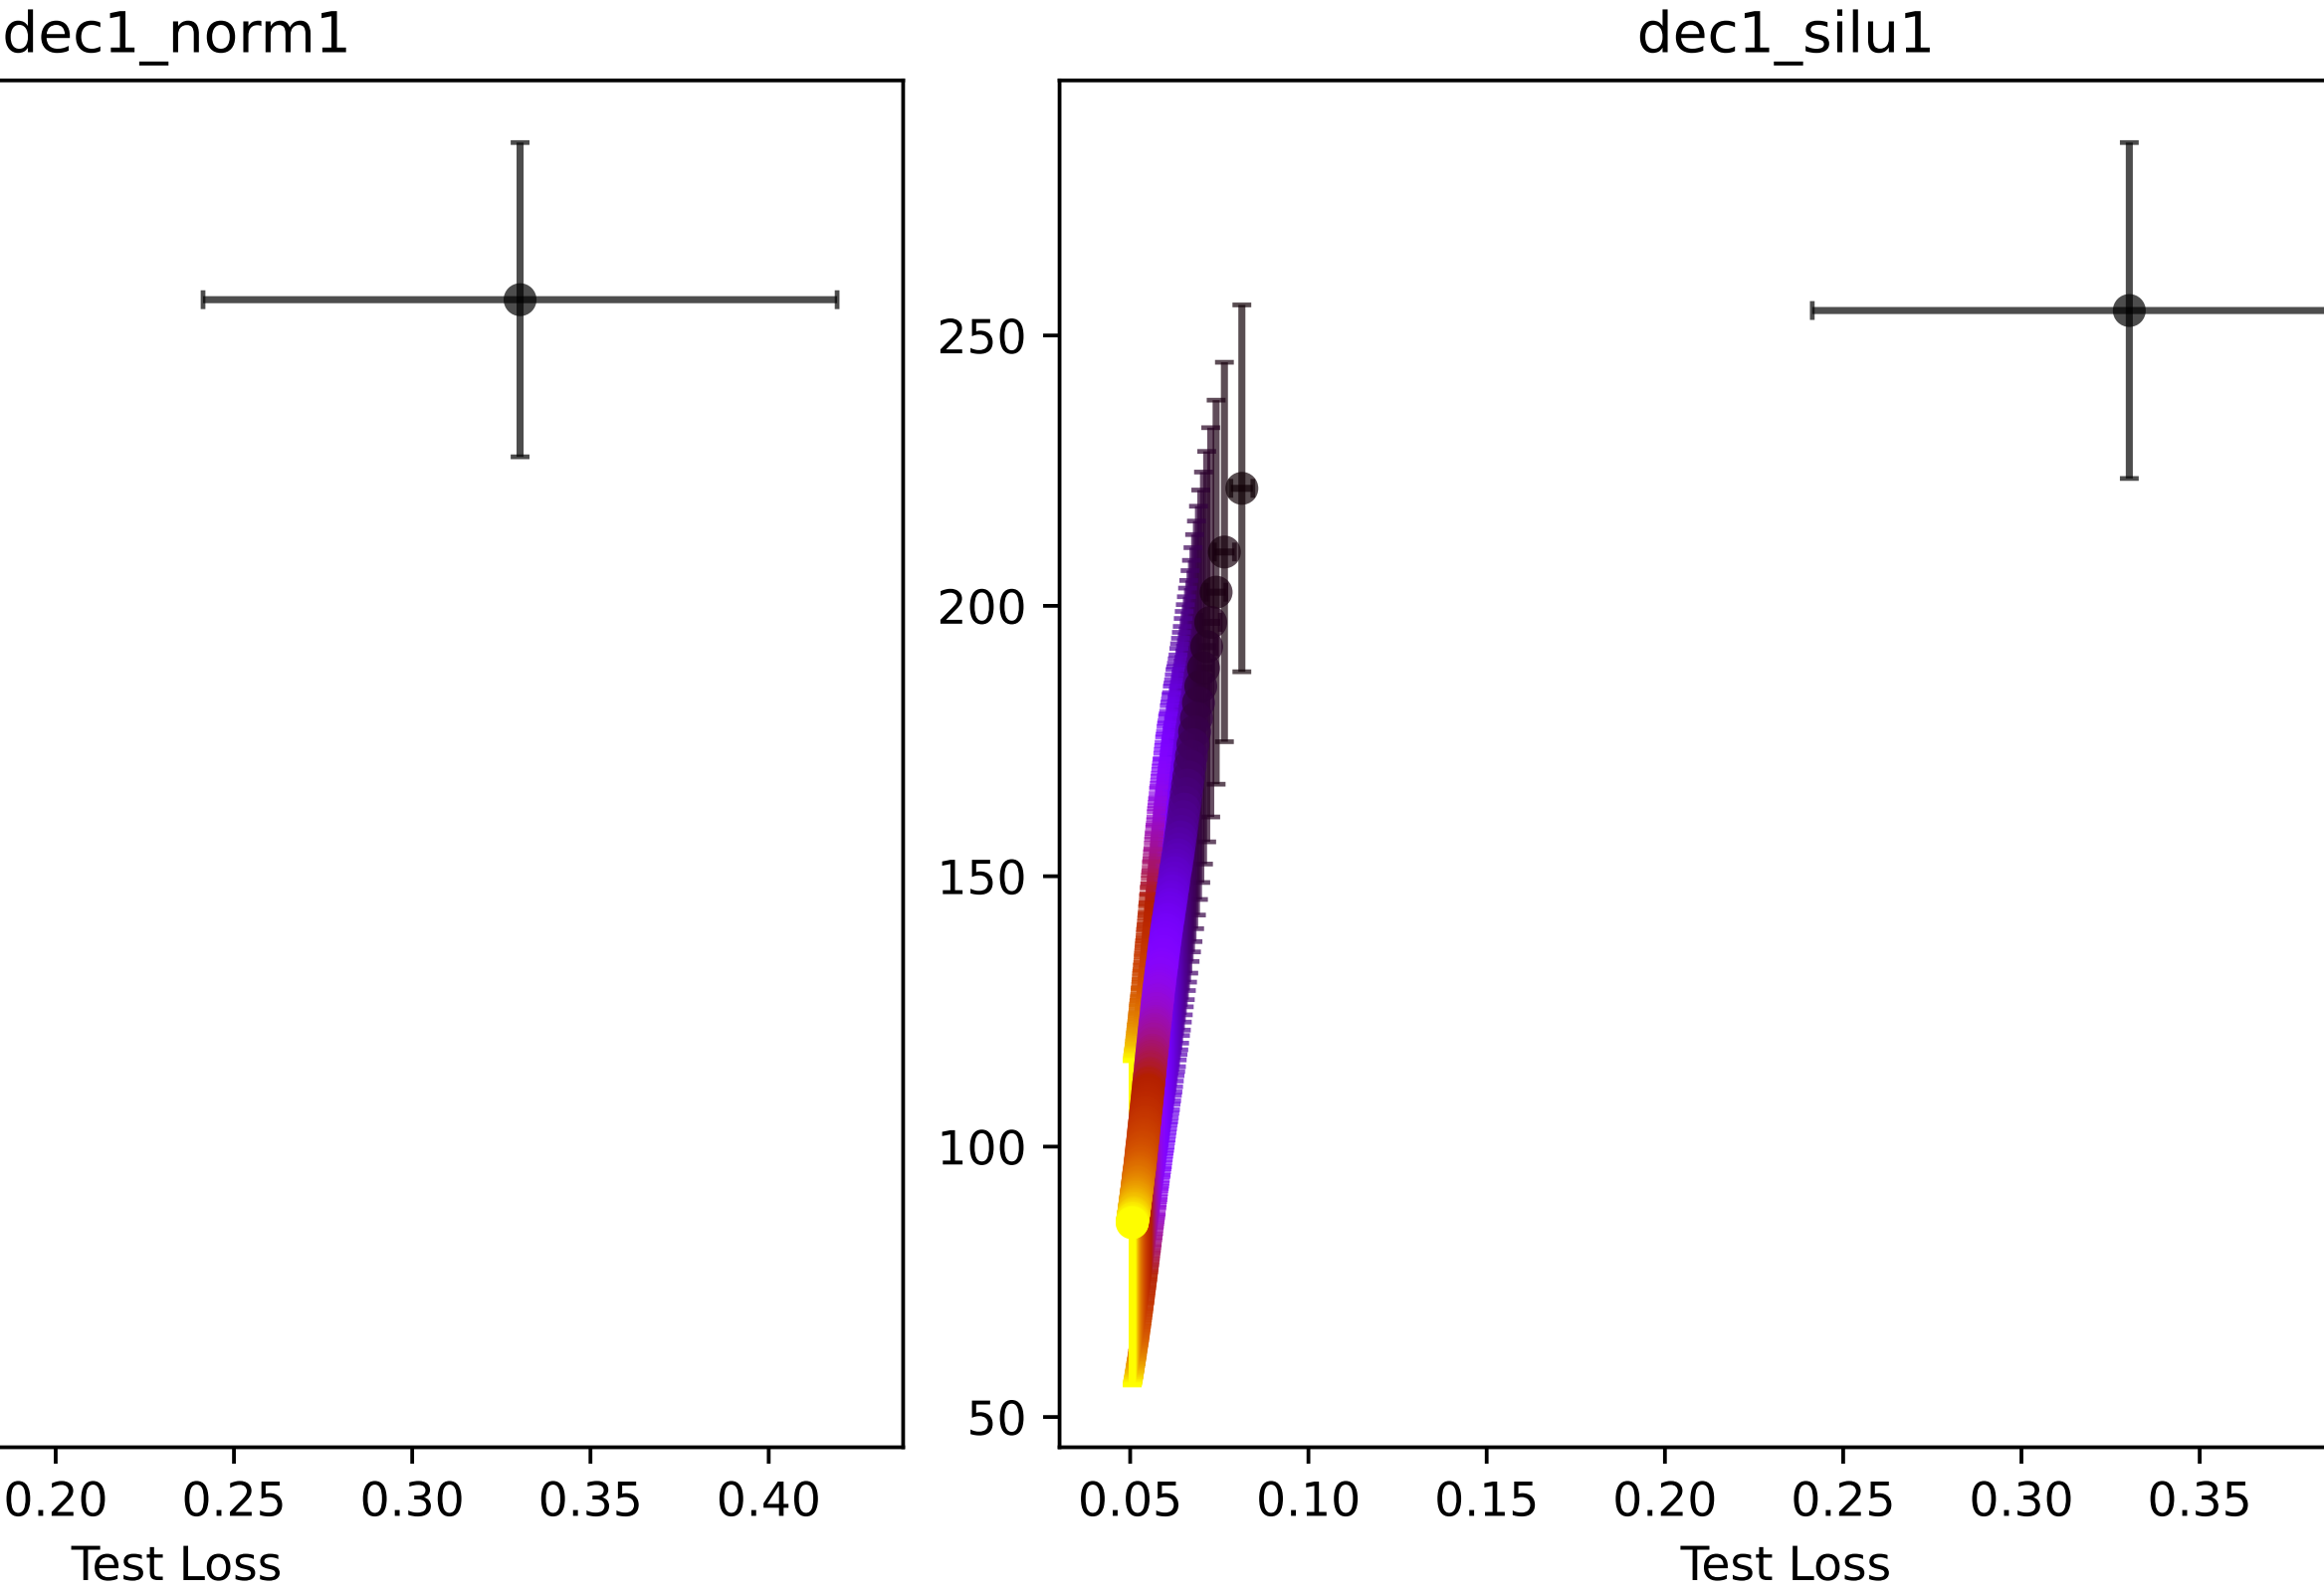
dec1_norm1
dec1_silu1
250
200
150
100
50
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Test Loss

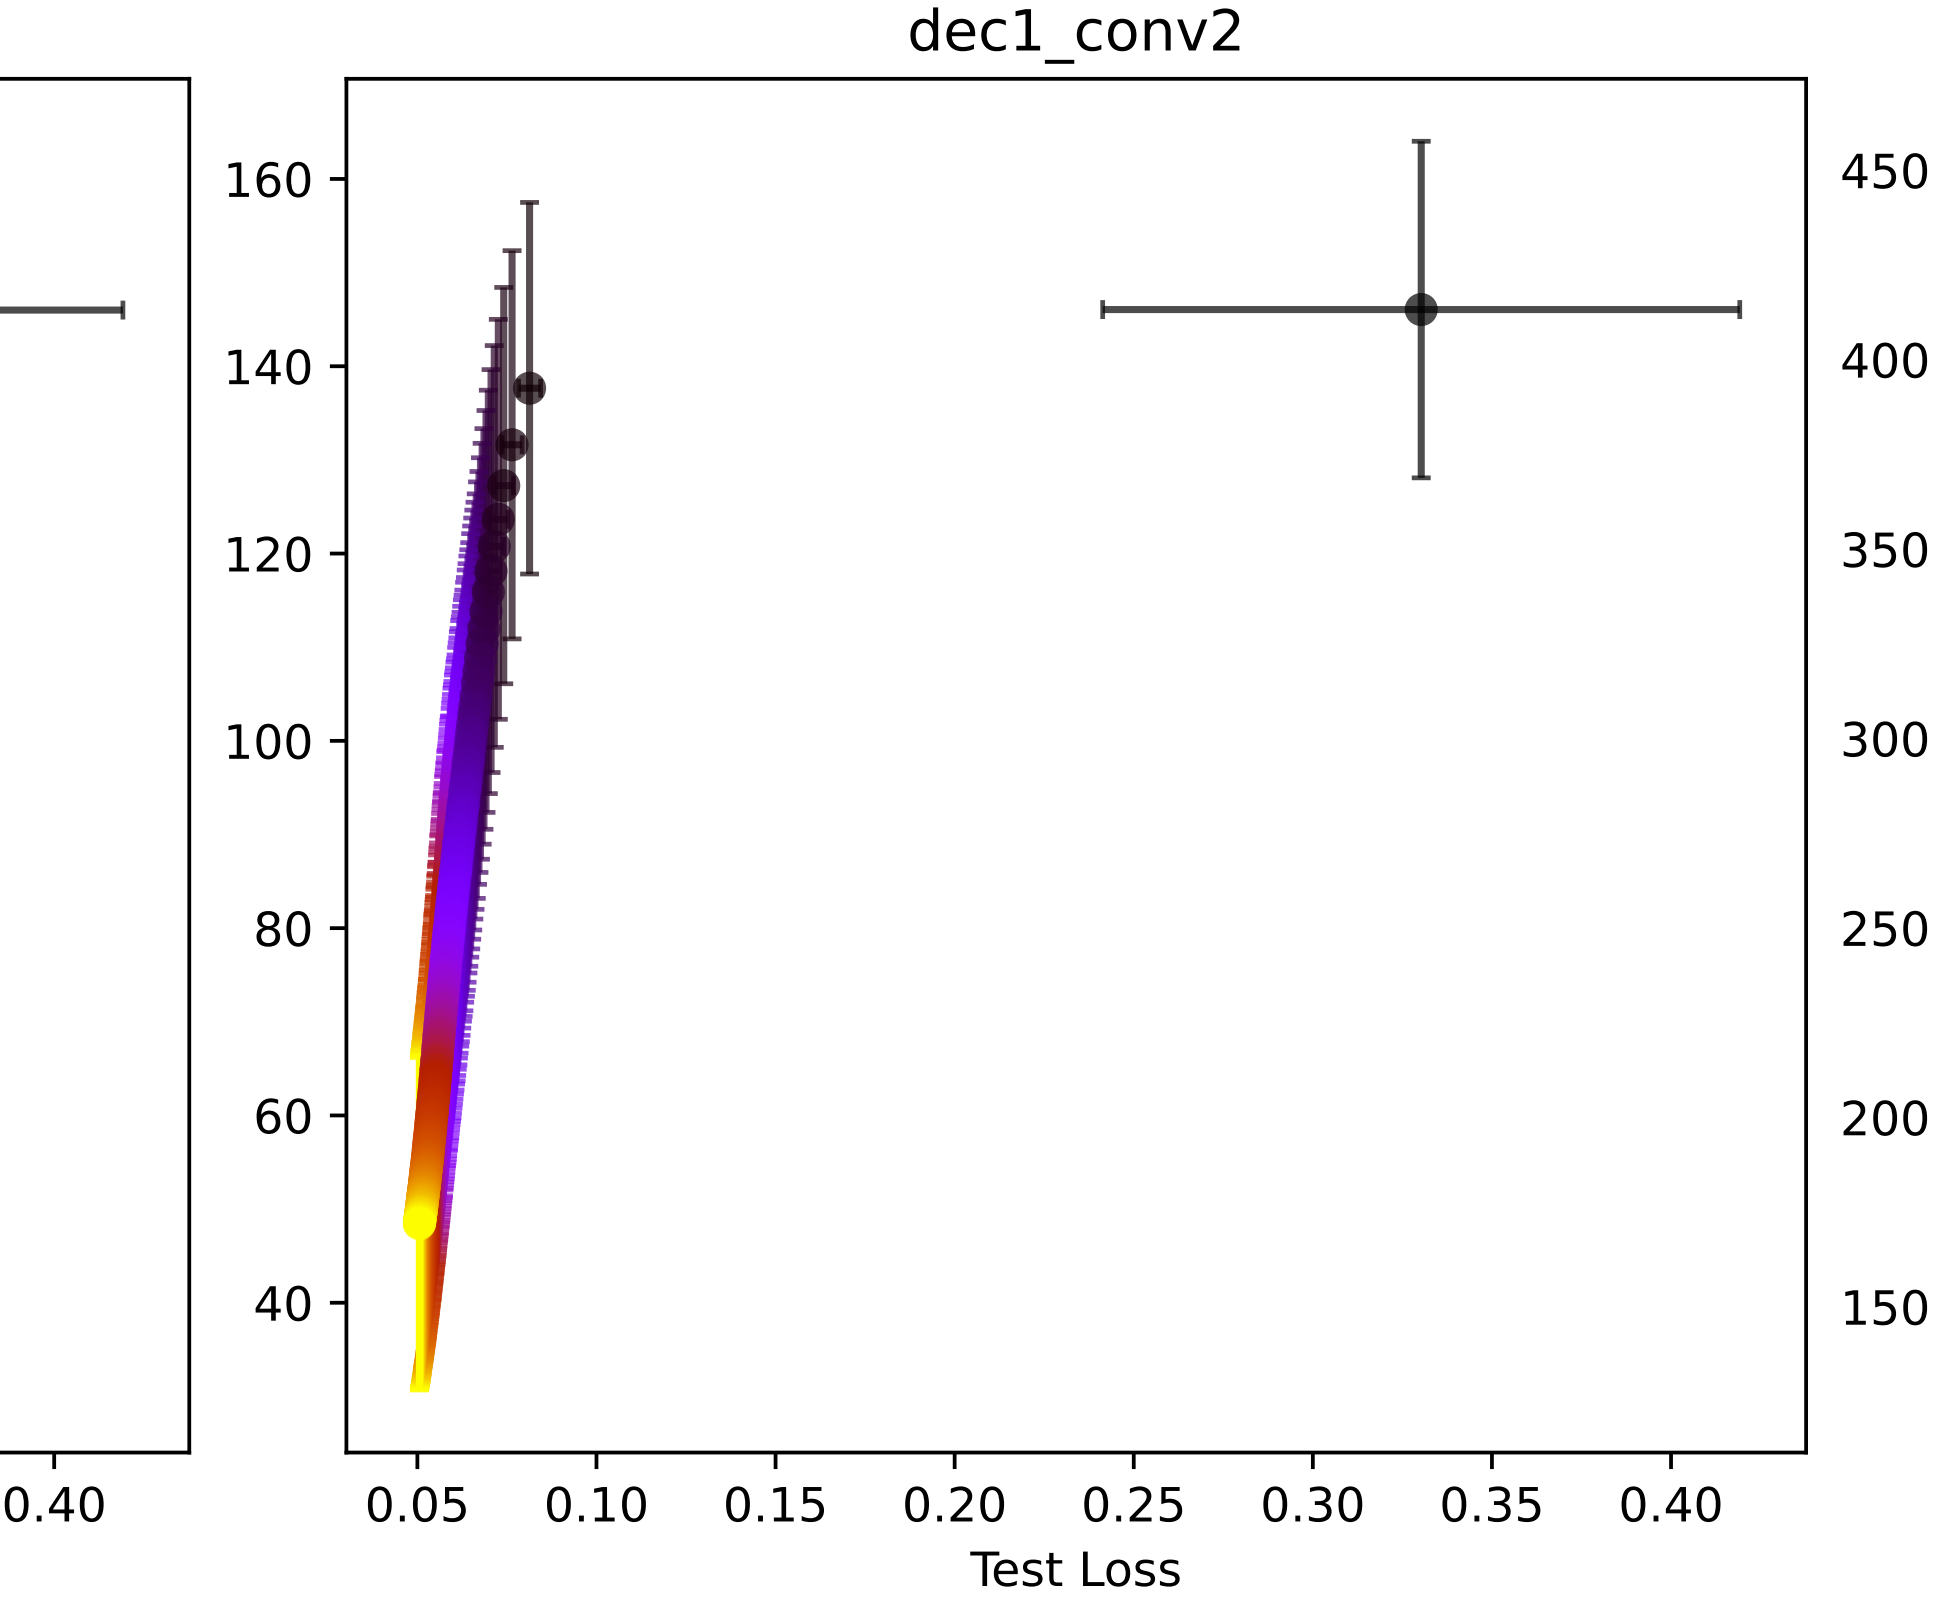
dec1_conv2
160
140
120
100
80
60
40
450
400
350
300
250
200
150
0.40
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss

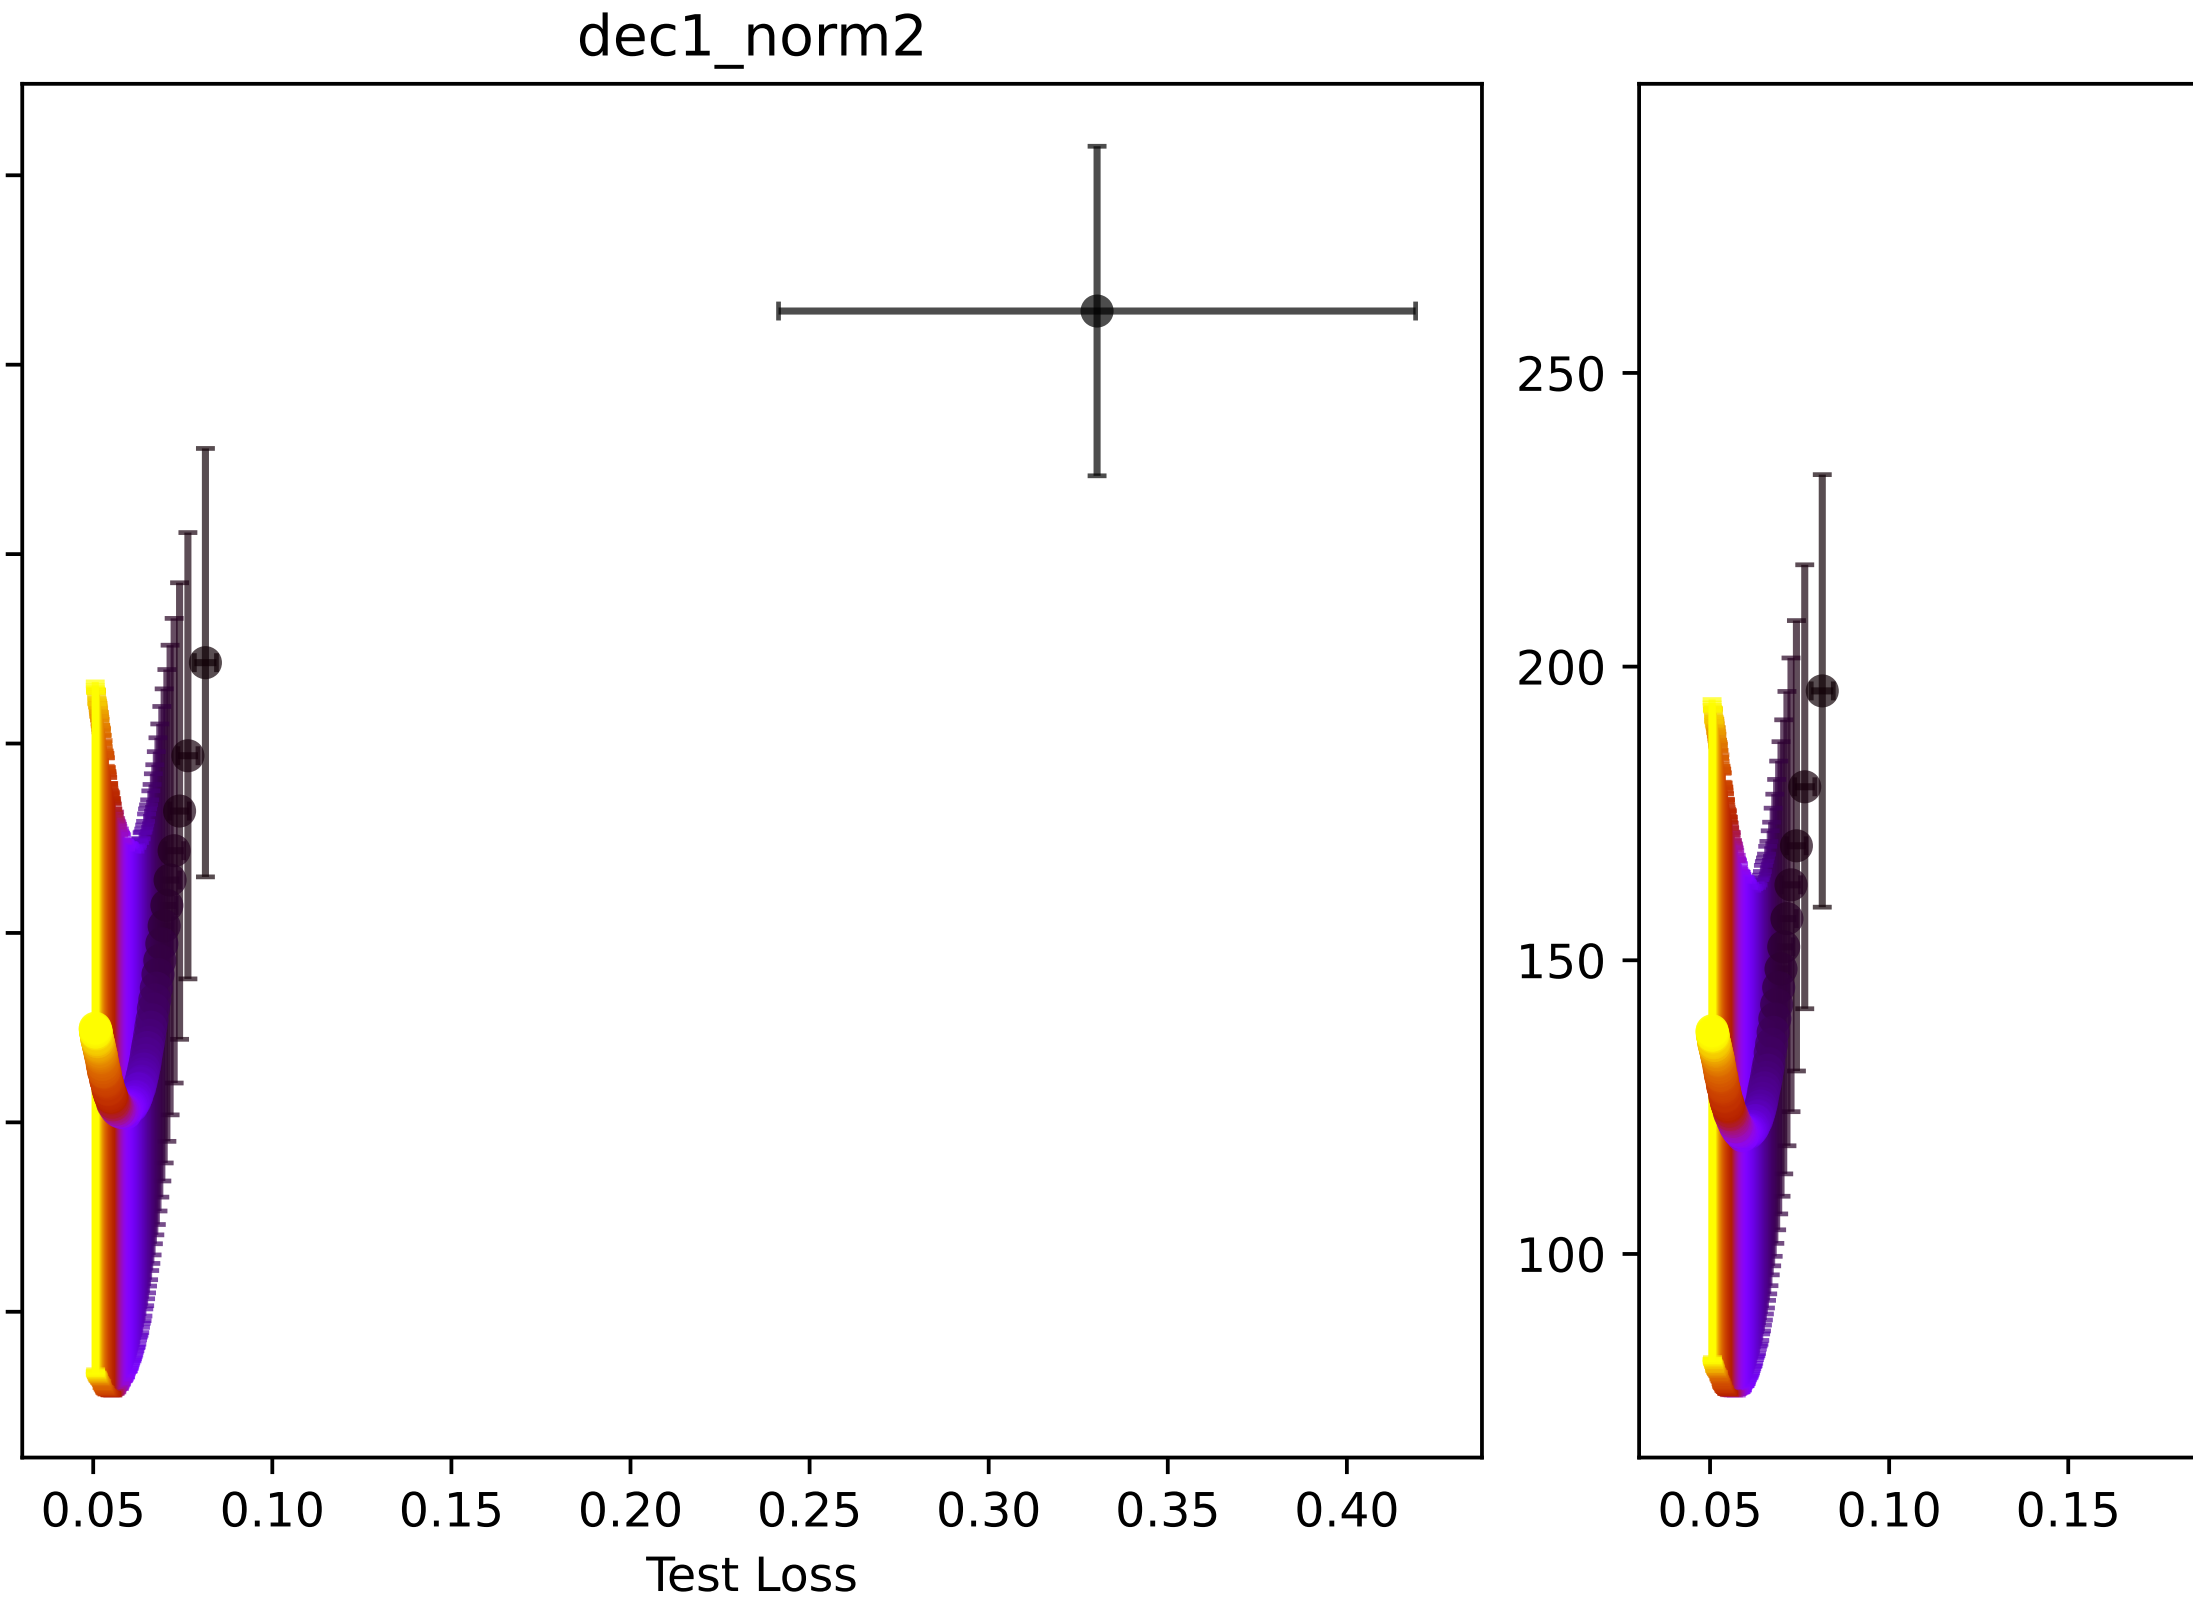
dec1_norm2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss
250
200
150
100
0.05
0.10
0.15

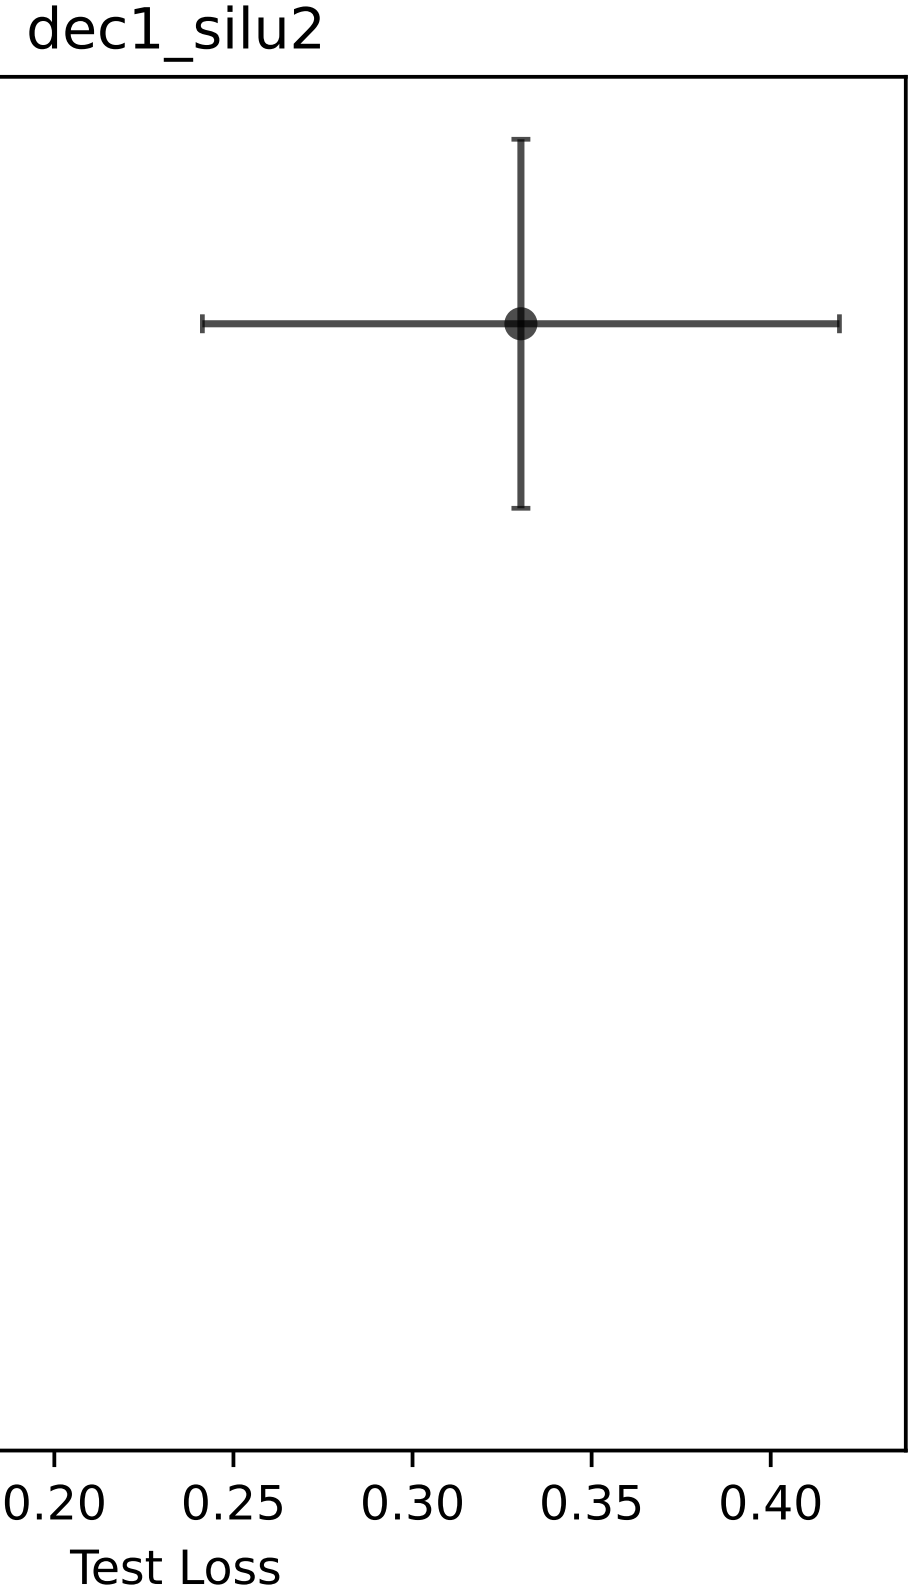
dec1_silu2
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Test Loss



200
Number Training Epochs
0