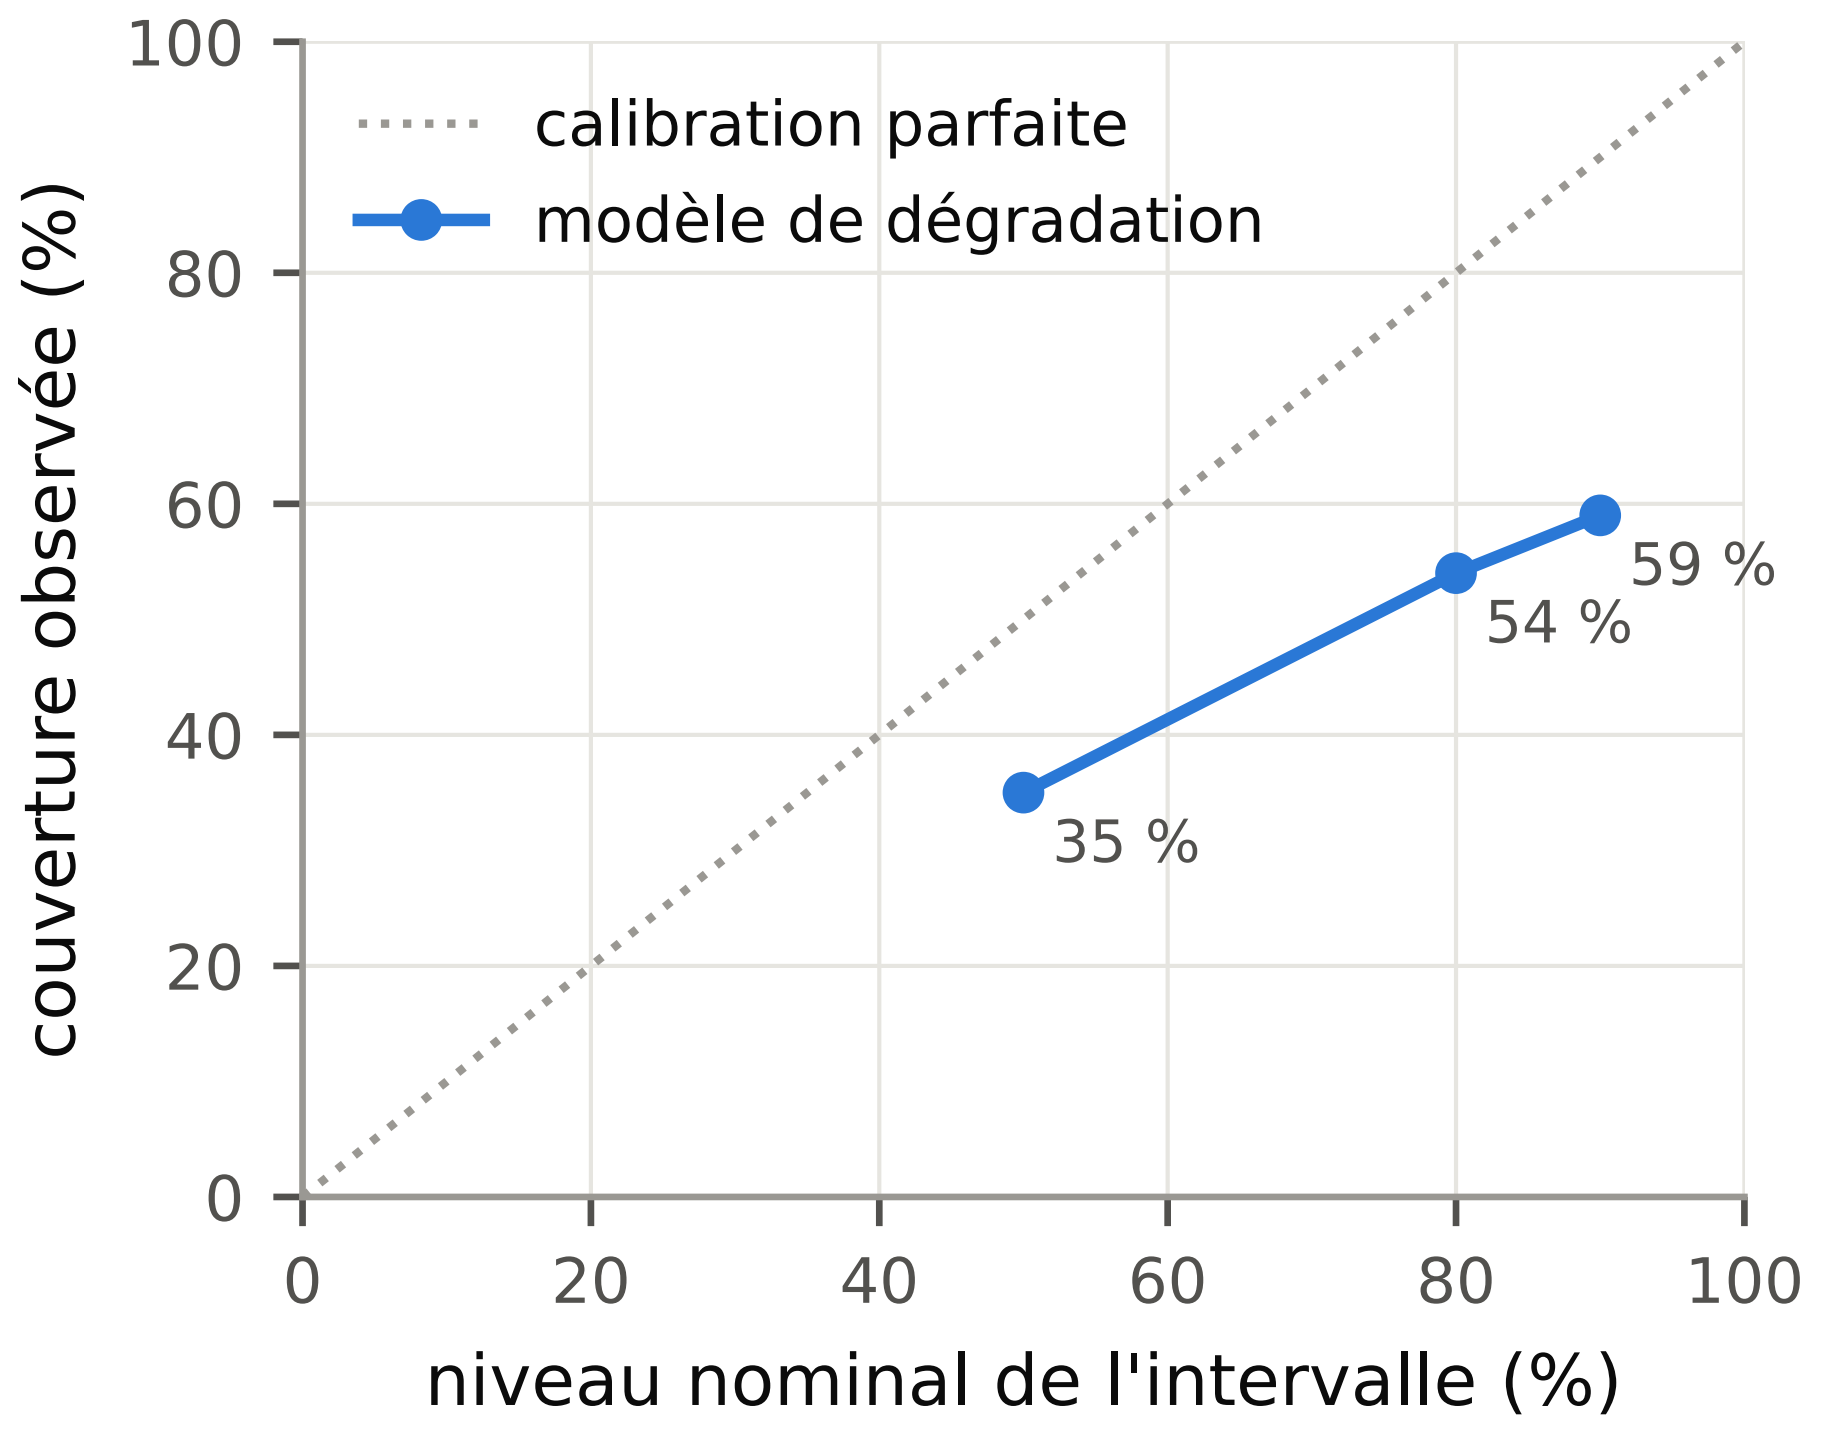
calibration parfaite
modèle de dégradation
35 %
54 %
59 %
couverture observée (%)
niveau nominal de l'intervalle (%)
0
20
40
60
80
100