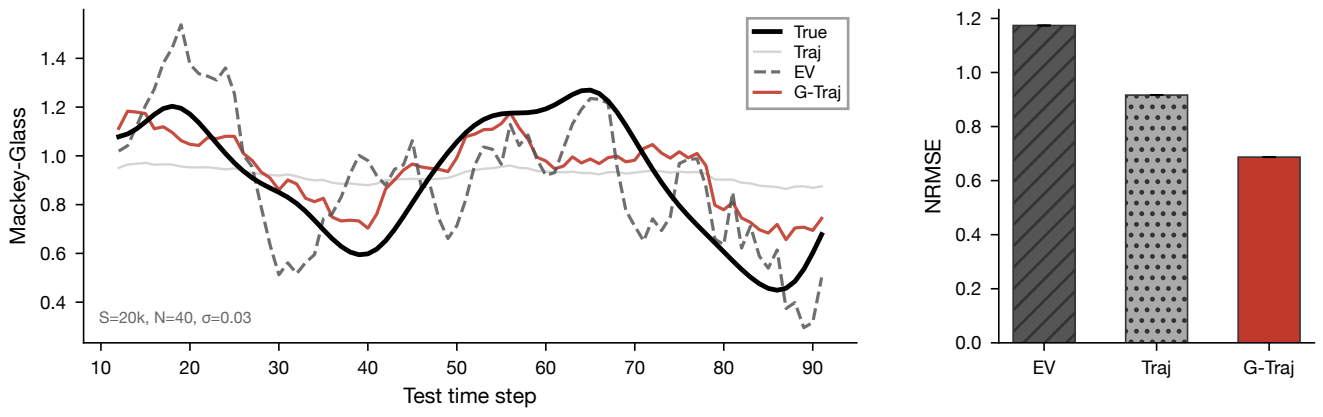
Mackey-Glass
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
S=20k, N=40, σ=0.03
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Test time step
True
Traj
EV
G-Traj
NRMSE
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
EV
Traj
G-Traj