




(a) Estímulo com bloqueio sinoatrial, sem perturbação — 50 bpm, 26 picos R em 30 s

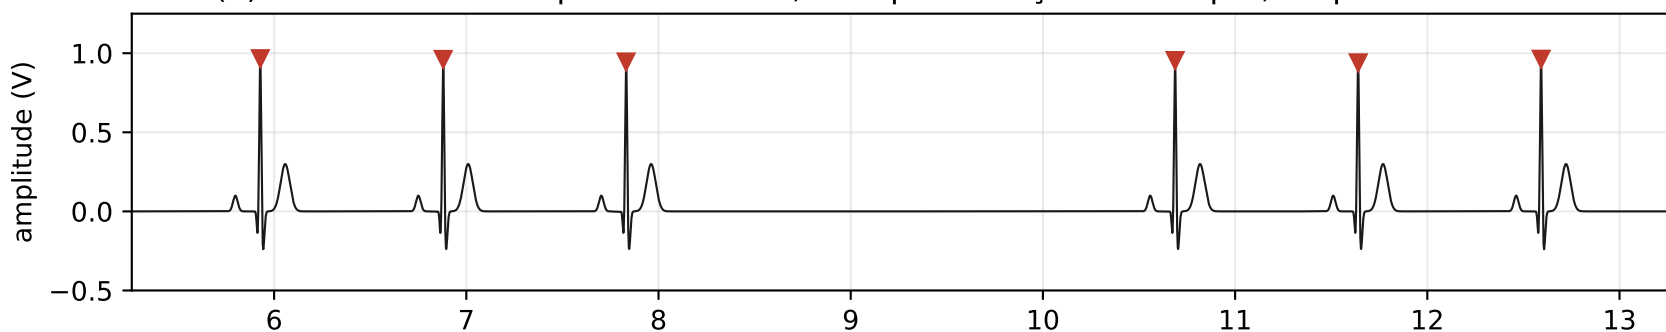


(b) Com interferência de rede de 60 Hz a 30 % — 50 bpm, 26 picos R em 30 s

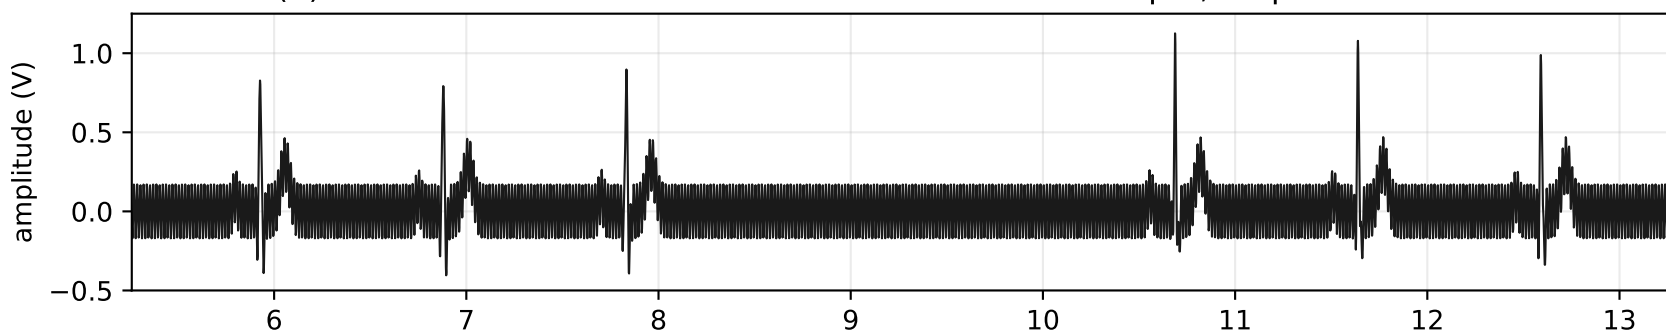

(c) Detalhe de um complexo QRS: a interferência de 0,18 V superposta à onda R de 0,97 V

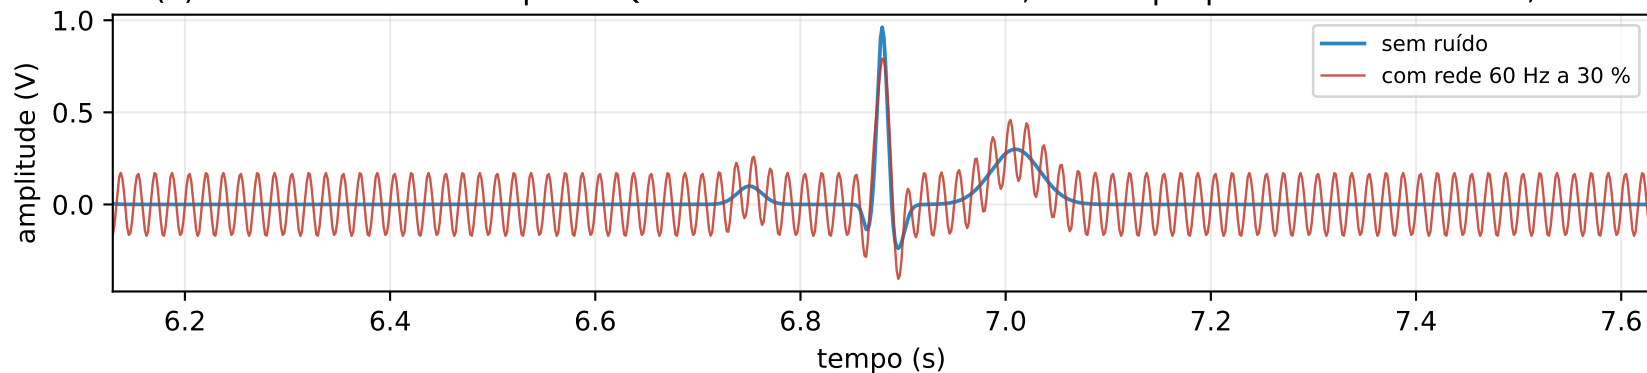

(d) Intervalos R-R em SIMULAÇÃO — o ruído digital não degrada a detecção (classificado: bloqueio)

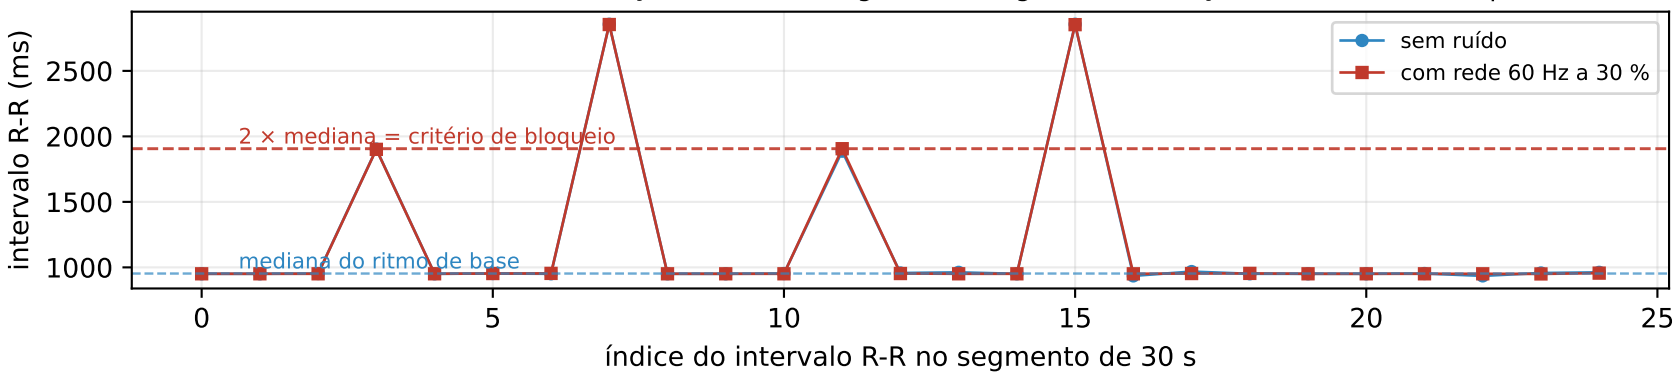

Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPS.