




(a) Estímulo com taquicardia, sem perturbação — 105 bpm, 53 picos R em 30 s

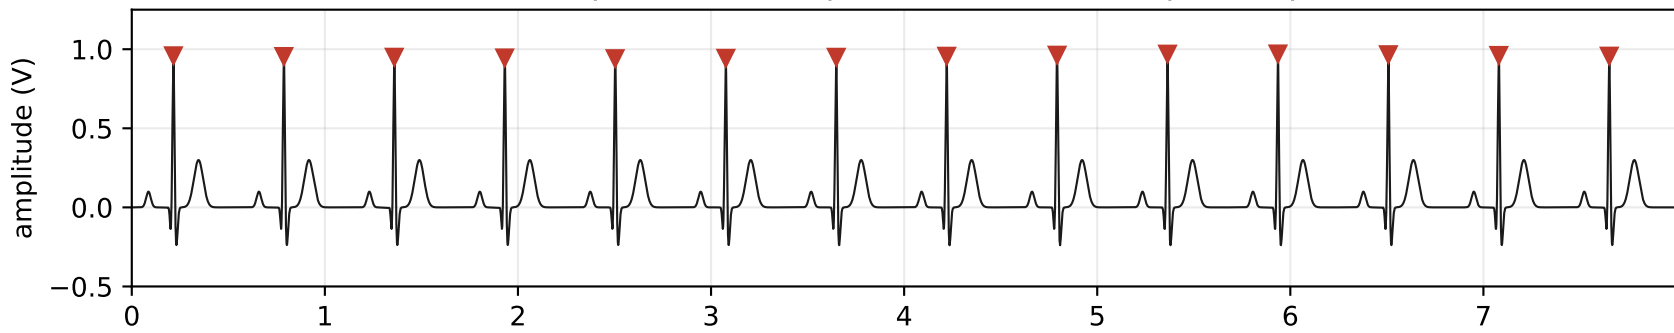


(b) Com interferência de rede de 60 Hz a 30 % — 84 bpm, 43 picos R em 30 s

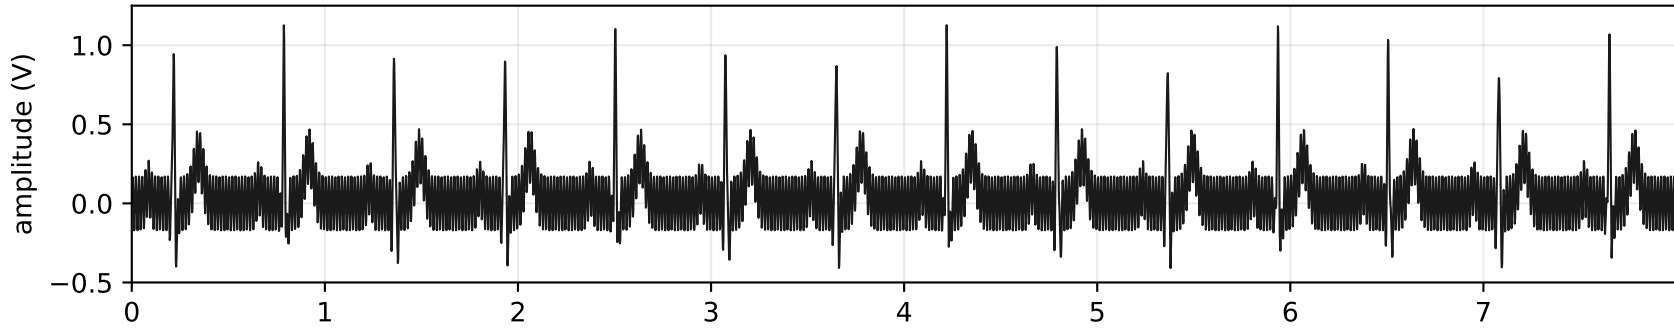

(c) Detalhe de um complexo QRS: a interferência de 0,18 V superposta à onda R de 0,97 V

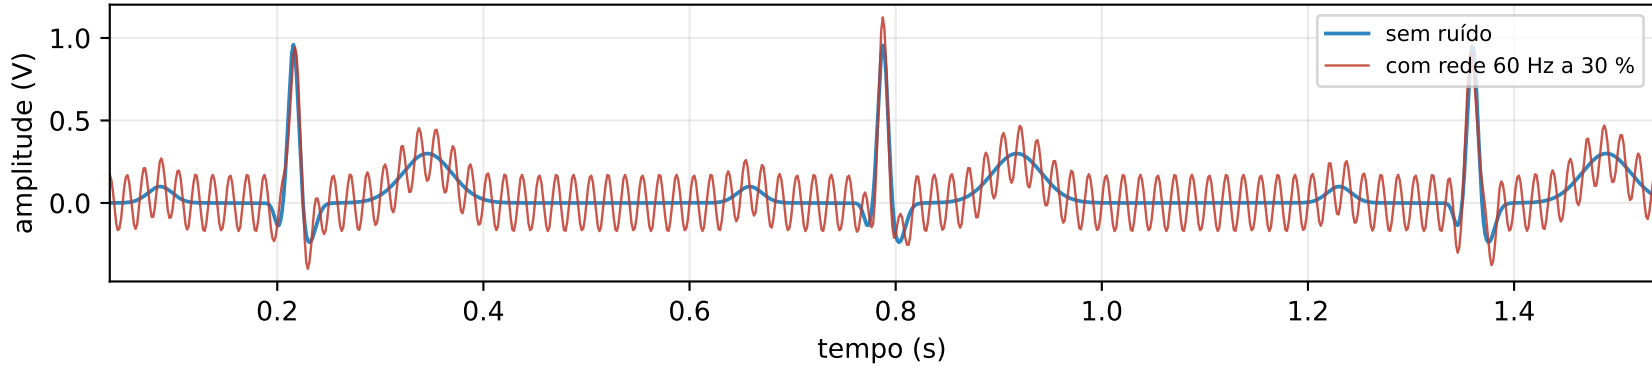

(d) Intervalos R-R em SIMULAÇÃO — 10 picos R perdidos produzem intervalos múltiplos (classificado: bloqueio)

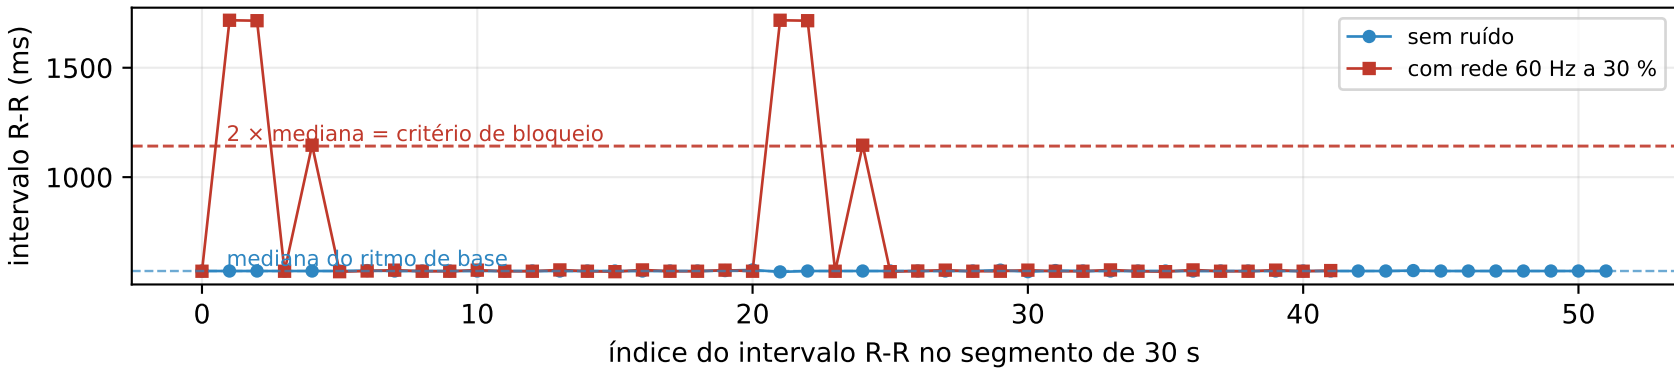

Nota: nesta classe o ruído de 60 Hz somado digitalmente já basta para derrubar 10 dos 53 picos R. Cada pico perdido produz um intervalo múltiplo da mediana, que satisfaz o critério de bloqueio — o mecanismo da falha observada na bancada, aqui reproduzido sem a cadeia física de reprodução e aquisição.