




complexo QRS presente no sinal




não detectado pelo algoritmo


Sem perturbação — 11 QRS no sinal, 11 detectados

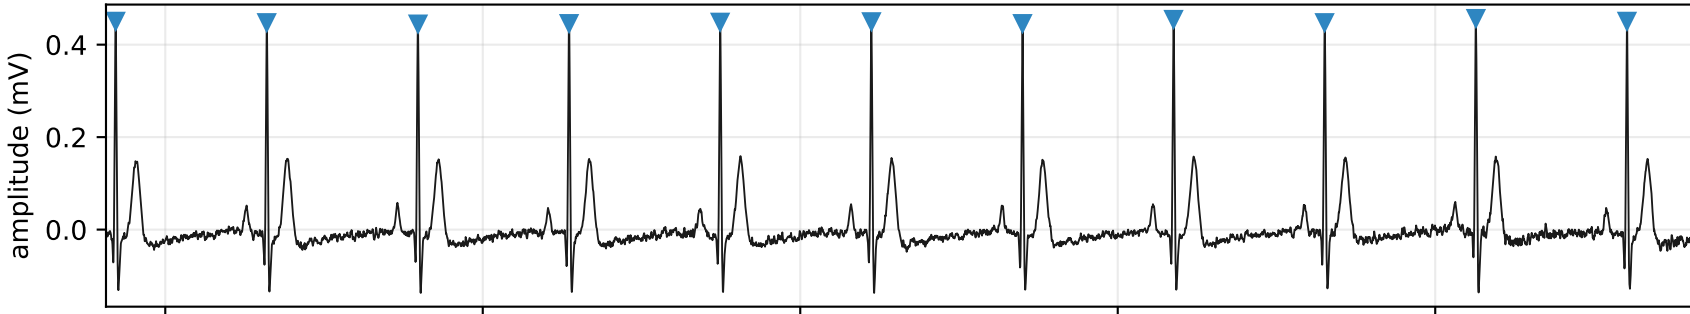

Rede 60 Hz a 30 % — 10 QRS no sinal, 8 detectados → classificado como BLOQUEIO

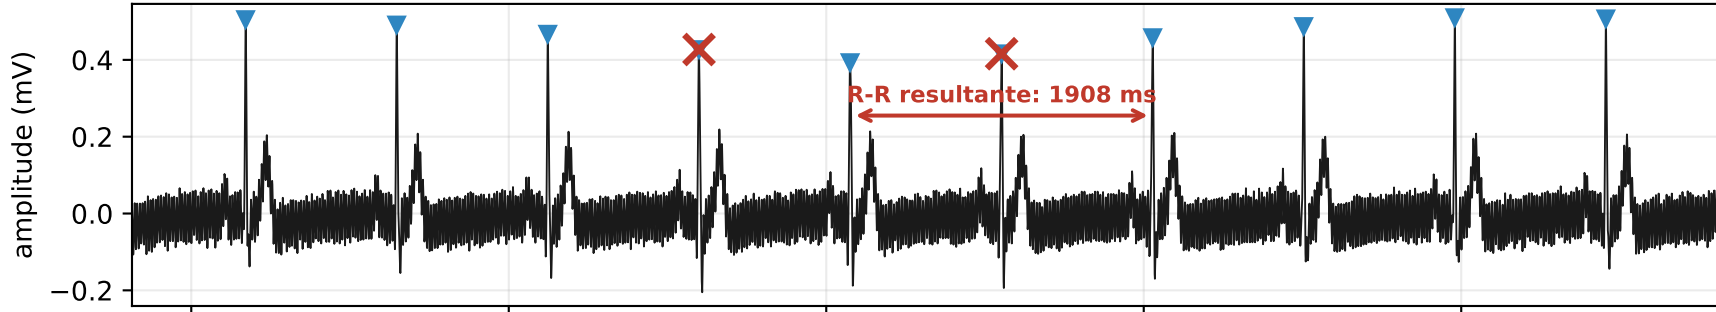

Aleatório a 30 % — 11 QRS no sinal, 11 detectados

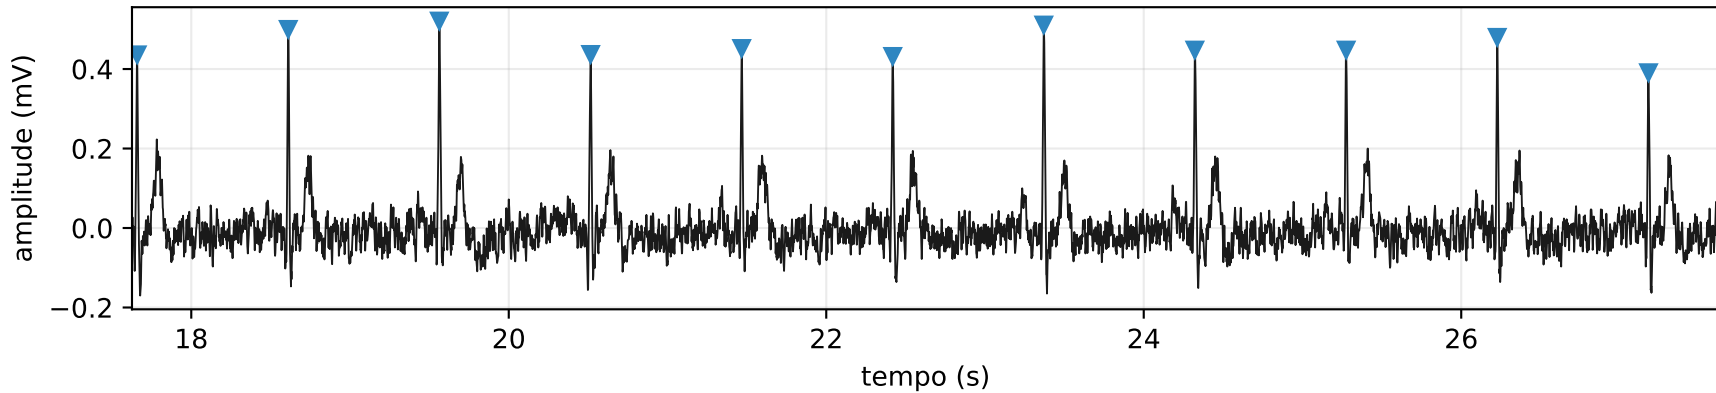

Traçados extraídos do buffer interno do firmware — a sequência de amostras que o algoritmo de detecção efetivamente recebeu, após o divisor resistivo, o AFE e os filtros digitais. Os complexos QRS estão ÍNTEGROS nos três casos, com ritmo regular: a aquisição não perde batimentos.

Sob a interferência de rede, porém, o algoritmo deixa de localizar parte deles, e o intervalo daí resultante satisfaz o critério de bloqueio. O ruído aleatório, de mesma amplitude mas espectro espalhado, não produz o efeito — o que aponta a periodicidade da interferência, e não sua energia.