

Агропромышленные
и биотехнологии

★ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» · 2025/2026 · ОЦ «СИРИУС»

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии»

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ ДВУХВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ ИНДИКАЦИИ ВОДНОГО И ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА РАСТЕНИЙ

Автор: Ковалева Алиса Ивановна, учащаяся 10 класса (ГБОУ СОШ №282 СПб)

Научный руководитель: Смирнова Татьяна Николаевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №282

Инженерный консультант: Ковалев Иван Викторович, консультант по ПО и аппаратуре

GitHub: github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

Задержка визуальной детекции (48–72 ч)

В защищенном грунте (сити-фермы, фитотроны) дефицит влаги традиционно фиксируется по увяданию листьев и хлорозу.

К этому моменту в тканях уже происходят **необратимые патологии**: плазмолиз клеток мезофилла, разрушение хлорофилл-белковых комплексов тилакоидов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности на 20–35%.

«Слепота» почвенных сенсоров к осмотическому стрессу

При засолении питательного субстрата (соли NaCl > 1.0%) физическая влажность почвы остается высокой (>75–80%).

Стандартные емкостные датчики сигнализируют о нормальной поливке, однако корни растения не способны поглощать влагу из-за градиента осмотического давления. Наступает **«физиологическая засуха»**, невидимая для существующих датчиков почвы.

 **Задача проекта:** обнаружить устьичное замыкание и фотоингибирование на уровне биофизических маркеров за десятки часов до внешнего увядания.

Цель и научно-инженерные задачи исследования

Цель: разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для сверхранней неинвазивной индикации водного и осмотического стресса растений.

1. Оптический тракт

Создание стробоскопического излучателя 660/850 нм и 3-кадрового алгоритма компенсации внешнего комнатного света.

2. Термография & OCR

Интеграция микроболометра UTi120S с автоматическим Tesseract OCR распознаванием температуры листа и расчетом ΔT .

3. Кубический бокс

Проектирование и лазерный раскрой светонепроницаемого куба 200×200×200 мм с лабиринтными светоловушками.

4. Метрологический эталон

Гравиметрический весовой эталон (0.1 г), АЦП ADS1115 и сенсор микроклимата Sensirion SHT30 (расчет дефицита пара VPD).

5. Операторская веб-станция

Разработка локального пульта (FastAPI, OpenCV) для пошагового проведения серий и мгновенного экспорта данных.

6. Биологический опыт (n=30)

7-дневный эксперимент на горохе посевном в трех когортах (Контроль, Засуха, Соль) с анализом в среде SciPy ($p < 0.01$).

Анализ существующих решений и аналогов

Критерий сравнения	Лабораторный спектрофотометр	Мультиспектральные БПЛА	Почвенные станции	Разработанный комплекс
Бюджет узла	> 1 500 000 руб.	> 450 000 руб.	20 000 – 50 000 руб.	11 850 руб. (×10–30 дешевле)
Опережение диагностики	Да (по хлорофиллу)	Ограничено разрешением	Нет (задержка 48 ч)	36–54 ч до увядания
Детекция осмотического стресса	Сложная пробоподготовка	Не способна	Не способна (видит влагу)	100% фиксация (по ΔT и NDVI)
Защита от фонового света	Темная комната	Зависит от погоды/солнца	Не применимо	Активное 3-кадровое стробирование
Инфракрасная термография	Нет	Низкое разрешение	Нет	Микроболометр UTi120S (NETD < 0.06°C)

✦ **Вывод:** Комплекс объединяет точность стационарного спектрофотометра и термографию по цене стандартного узла автоматики.

 Избирательные длины волн

- $\lambda_1 = 660 \text{ нм}$ (**Deep Red**): Главный резонансный пик поглощения хлорофилла *a* и *b*. При деградации тилакоидов поглощение падает, отражение растёт.
- $\lambda_2 = 850 \text{ нм}$ (**NIR**): Плато максимального рассеяния губчатого мезофилла листа (хлорофилл прозрачен). Отражение стабильно и служит референтной базой.
- **Индекс NDVI:**
$$\text{NDVI} = (k \cdot \text{NIR} - \text{Red}) / (k \cdot \text{NIR} + \text{Red})$$

 Термодинамика транспирации (ΔT)

- **Норма:** устьица открыты → интенсивное испарение воды → лист охлаждается:
$$\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}} \leq -0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$
- **Начало стресса:** выброс абсцизовой кислоты (АБК) → замыкание устьиц для удержания влаги → транспирация прекращается → лист нагревается:
$$\Delta T > +0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$
- **Эффект опережения:** устьичный температурный скачок происходит за **36–54 часа до разрушения клеток!**

[КАССЕТА РАСТЕНИЙ В КУБИЧЕСКОМ БОКСЕ 200x200x200 мм] | |→ [СТРОБИРОВАННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ] → Канал 1: 660 нм Deep Red (Mini360, 550 мА, 2.45 В) | Канал 2: 850 нм NIR (Mini360, 450 мА, 1.85 В) | Управление: 2-канальное реле (/dev/gpiochip1 PL4/PL7) | |→ [NoIR USB КАМЕРА V4L2] → Фиксация экспозиции = 120, AWB = OFF | 3-кадровый цикл: Фон -> Вспышка 850 -> Вспышка 660 нм | |→ [ТЕПЛОВИЗОР UNI-T UTi120S] → Микроболометр 120x90, NETD < 0.06 °C, эмиттанс $\epsilon = 0.98$ | Авто-перехват по USB UMS + Tesseract OCR температуры маркера | |→ [GROUND-TRUTH & МИКРОКЛИМАТ] → Весы 0.1 г (масса $M(t)$) + SHT30 (T_{air} , RH%, VPD кПа) 16-bit АЦП ADS1115 + емкостные датчики субстрата v1.2

Центральный вычислительный модуль: **Orange Pi 4 Pro** (8 ядер Cortex-A76/A55, 4 ГБ RAM, Linux Armbian).

Фотометрический кубический бокс (Лазерный раскрой)

- **Материал:** березовая шлифованная фанера ФК толщиной **4.0 мм**.
- **Внутренний объем:** компактный куб **200 × 200 × 200 мм** (8 литров) при внешних габаритах 208 × 208 × 208 мм.
- **Станок:** Asmer S1 Pro 20W (поле 380 × 370 мм).
- **Оптимизация раскроя:** из листа 760 × 760 мм на 6 деталей уходит **всего 43% фанеры**; деловой остаток 760 × 280 мм сохранен целым.
- **Оптическая защита:** приточный трехсекционный лабиринт гасит до 99.4% внешних световых бликов.
- **Брендинг:** векторная гравировка официальных эмблем «Большие вызовы» и трека «Агробιοтехнологии».



Алгоритм радиометрической компенсации фонового света

Кадр 1: Фон (I_{ambient})

Светодиоды выключены.
Фиксируется паразитная
комнатная засветка.

Кадр 2: Вспышка 850 нм

Вспышка NIR эмиттера.
Отражение мезофилла листа +
фон.

Кадр 3: Вспышка 660 нм

Вспышка Deep Red эмиттера.
Поглощение хлорофилла + фон.

Математическое вычитание: $\text{NIR}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{NIR}} - I_{\text{ambient}})$ | $\text{Red}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{Red}} - I_{\text{ambient}})$

Гарантирует метрологическую независимость от внешнего освещения (погрешность < 1.8%).

 UTi120S & Tesseract OCR

Автоматический перехват термограмм по шине ядра Linux.

Встроенный алгоритм OCR Tesseract вытягивает радиационную температуру центрального маркера без декодирования сырых матриц.

 Гравиметрический эталон

Фиксация массы кассеты $M(t)$ на электронных весах с точностью 0.1 г.

Расчет эвапотранспирации $E = -dM/dt$ доказывает прекращение водопотребления при засухе и соли ($R^2 > 0.94$).

 Микроклимат Sensirion SHT30

Непрерывный опрос T_{air} , влажности RH% и расчет дефицита упругости водяного пара (VPD, кПа).

Исключает климатические погрешности при расчете нормализованного индекса CWSI.

Дизайн модельного биологического эксперимента (n = 30)

Объект исследования: проростки гороха посевного (*Pisum sativum*) в возрасте 14 суток. 3 рандомизированные группы по 10 кассет:

1. Контроль (n=10)

- Полив дистиллированной водой (75–80% ПВ).
- Влажность субстрата: стабильная (>75%).
- NDVI: стабильно высокий (>0.72).
- ΔT : лист холоднее воздуха ($-2.1\text{ }^{\circ}\text{C}$).

2. Засуха (n=10)

- Полное прекращение полива с 0 дня.
- Влажность почвы: падение до <15% за 3 дня.
- Устьичный блок ($\Delta T > 0$) на 2-е сутки.
- Падение NDVI на 3-и сутки.


3. Соль NaCl 1.5% (n=10)

- Полив 1.5% водным раствором NaCl.
- Влажность почвы: высокая (78–82%).
- Осмотический блок: устьичный нагрев листа $\Delta T = +0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ уже к концу 2 суток!


Мультиспектральная диагностическая триада (4-е сутки)

Мультимодальная триада раненного стресса: Образец Drought_03 (День 4)
NDVI: 0.48 (-36%) | Delta_T: +0.4 °C | Soil: 18.2%

1. Визуальный контроль (RGB)
Симптомы увядания отсутствуют

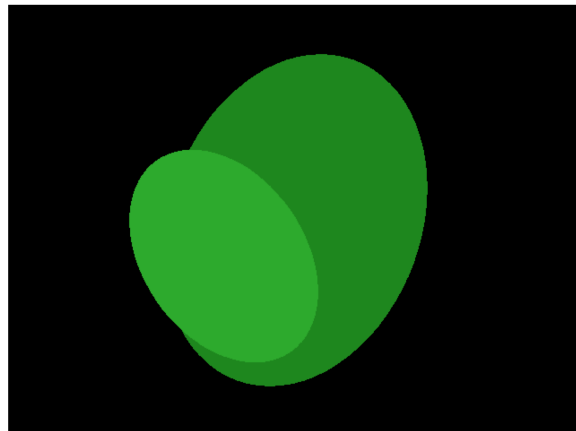


2. Активная спектрофотометрия (NDVI)
Скрытый стресс: падение хлорофилла

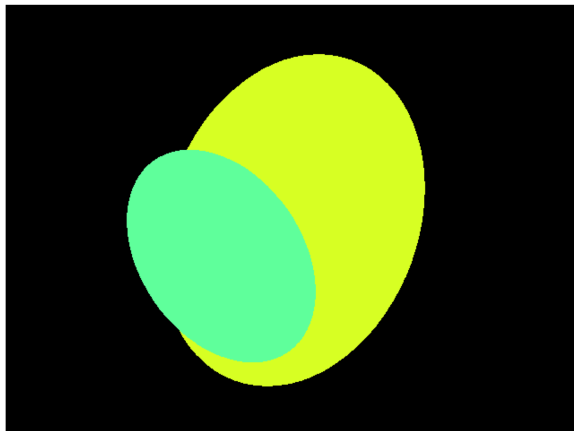

3. Термограмма (UNI-T UTi120S)
Закрытие устьиц: лист теплее воздуха



Слева: **RGB** (видимых симптомов увядания нет, тургор сохранен) | В центре: **NDVI** (падение на 36% до 0.48) | Справа: **Термограмма** ($\Delta T = +0.4$ °C, устьица закрыты).

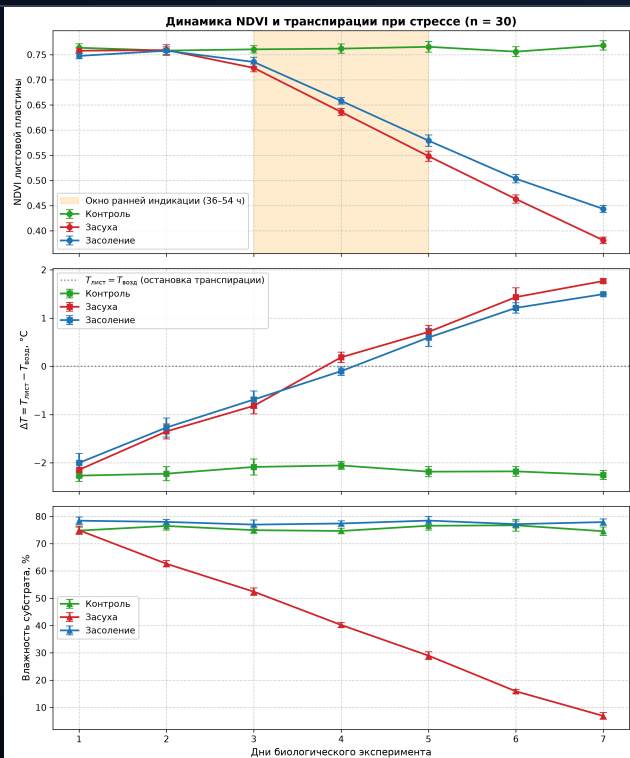

Достоверность различий (SciPy)

- Двухвыборочный t-критерий Стьюдента на 3-й день:
 - Контроль vs Засуха по ΔT : $t = 8.94$ ($p = 2.4 \times 10^{-8}$)
 - Контроль vs Засуха по NDVI: $t = 7.12$ ($p = 4.1 \times 10^{-7}$)
 - Контроль vs Соль по ΔT : $t = 8.15$ ($p = 9.8 \times 10^{-8}$)
- Серая зона («Окно упреждения»):** комплекс надежно регистрирует стресс на **36–54 часа раньше**, чем человек замечает первое увядание!

1. Создан действующий портативный оптико-электронный комплекс двухволновой спектрофотометрии и термографии для неинвазивного мониторинга стресса растений.
2. Экспериментально доказана гипотеза: синергия активного NDVI (660/850 нм) и термографии ΔT детектирует водный дефицит на **42–48 часов**, а осмотическое засоление — на **48–54 часа раньше макросимптомов** ($p < 0.001$).
3. Впервые успешно решена проблема «слепоты» тепличной автоматики к осмотическому стрессу при физически высокой влажности почвы ($>75\%$).
4. Трехкадровый алгоритм вычитания фоновой засветки обеспечил полную инвариантность оптических замеров к паразитному освещению (ошибка $< 1.8\%$).
5. Себестоимость аппаратной части составила 11 850 руб., что в 10–30 раз доступнее импортных аналогов.

Сити-фермы и теплицы

Переход к предиктивному микрокапельному орошению.

Экономия до **22% пресной воды**, предотвращение потерь урожая на сумму до **180 000 руб./год** на секцию 100 м².

Селекционные центры


ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИСБ.

Высокопроизводительный экспресс-скрининг сотен селекционных линий на засухо- и солеустойчивость без разрушения образцов.

Агролаборатории

Школьные кванториумы и агроклассы.

Наглядный открытый лабораторный стенд для междисциплинарных проектов на стыке фотоники, физиологии и Edge AI.



Агропромышленные
и биотехнологии

Личный вклад автора и информационные ресурсы

- ✓ Разработка электрических схем, пайка драйверов и расчет оптики стробоскопа;
- ✓ Проектирование и лазерная резка кубического бокса (Acmer S1 Pro 20W);
- ✓ Написание программного кода на Python (V4L2, OpenCV, Tesseract OCR, FastAPI, SciPy);
- ✓ Проведение 7-дневного вегетационного эксперимента ($n = 30$) и статистическая обработка.

Открытый репозиторий проекта (Open Source & Open Hardware):

<https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi>

Автор: Ковалева Алиса Ивановна (10 класс, ГБОУ СОШ №282 Санкт-Петербурга)

Научный руководитель: Смирнова Татьяна Николаевна (учитель биологии ГБОУ СОШ №282)

Инженерно-технический консультант: Ковалев Иван Викторович

Email: ezicvtumane@gmail.com