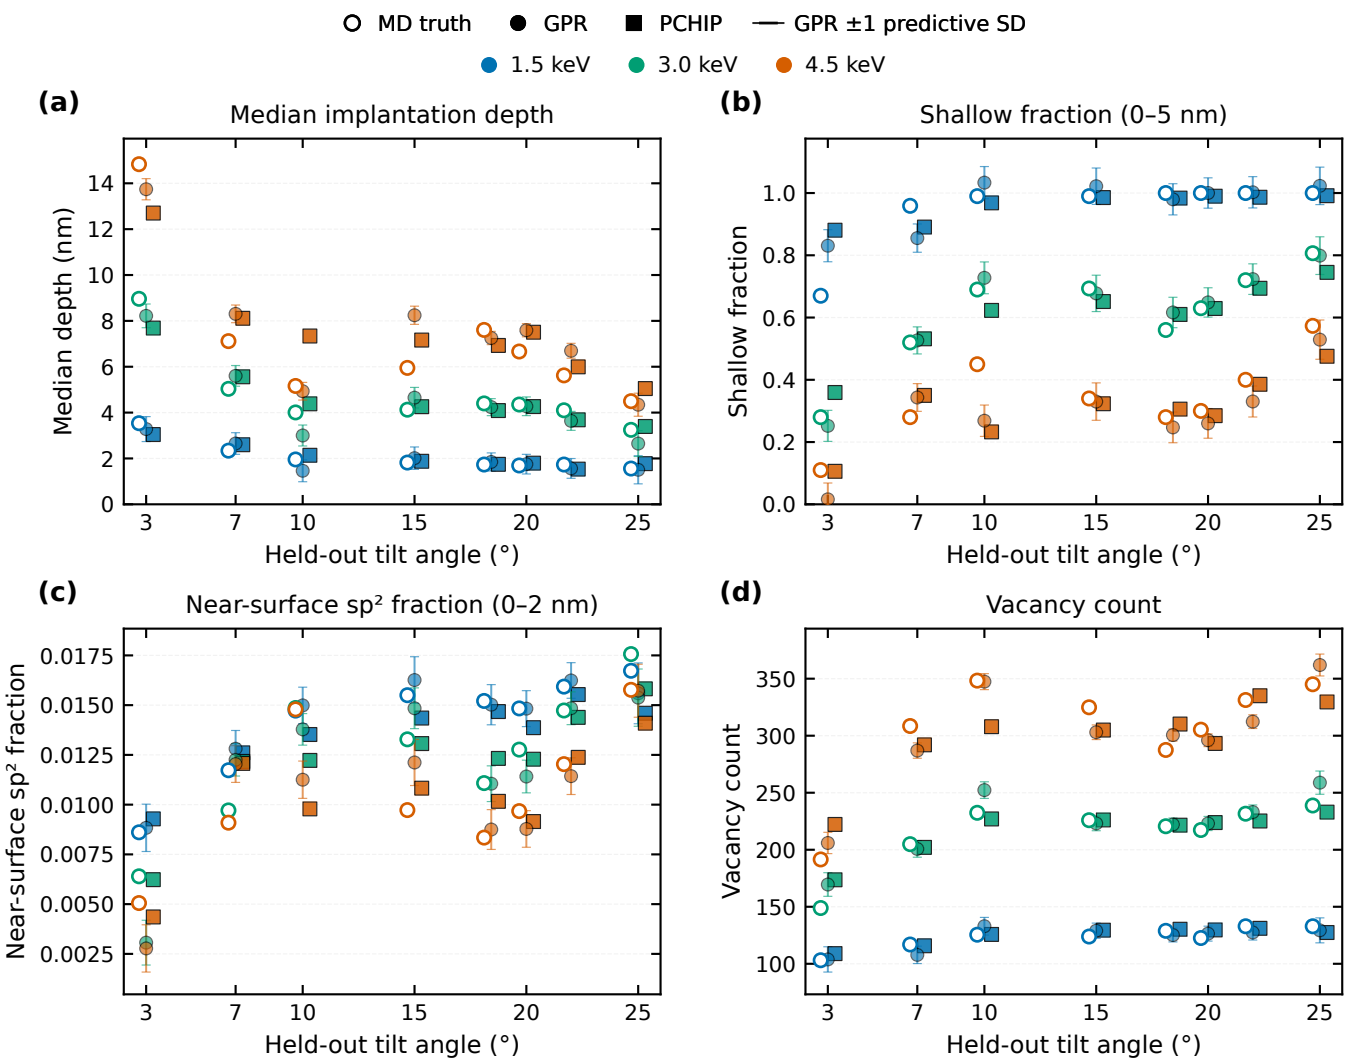
MD truth
GPR
PCHIP
GPR ±1 predictive SD
1.5 keV
3.0 keV
4.5 keV
(a)
Median implantation depth
Median depth (nm)
Held-out tilt angle (°)
(b)
Shallow fraction (0–5 nm)
Shallow fraction
Held-out tilt angle (°)
(c)
Near-surface sp² fraction (0–2 nm)
Near-surface sp² fraction
Held-out tilt angle (°)
(d)
Vacancy count
Vacancy count
Held-out tilt angle (°)