












ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ TICKY (ПСТ)


Продовження...




ВИБЕРІТЬ циліндричний або сферичний пристрій для створення тиску (ПСТ) та розташуйте його в ділянці пахової складки, одночасно підтримуючи тиск на гемостатичну пов'язку в рані (приклади ПСТ: черевик/чобіт; пляшка, наповнена водою; фляга).

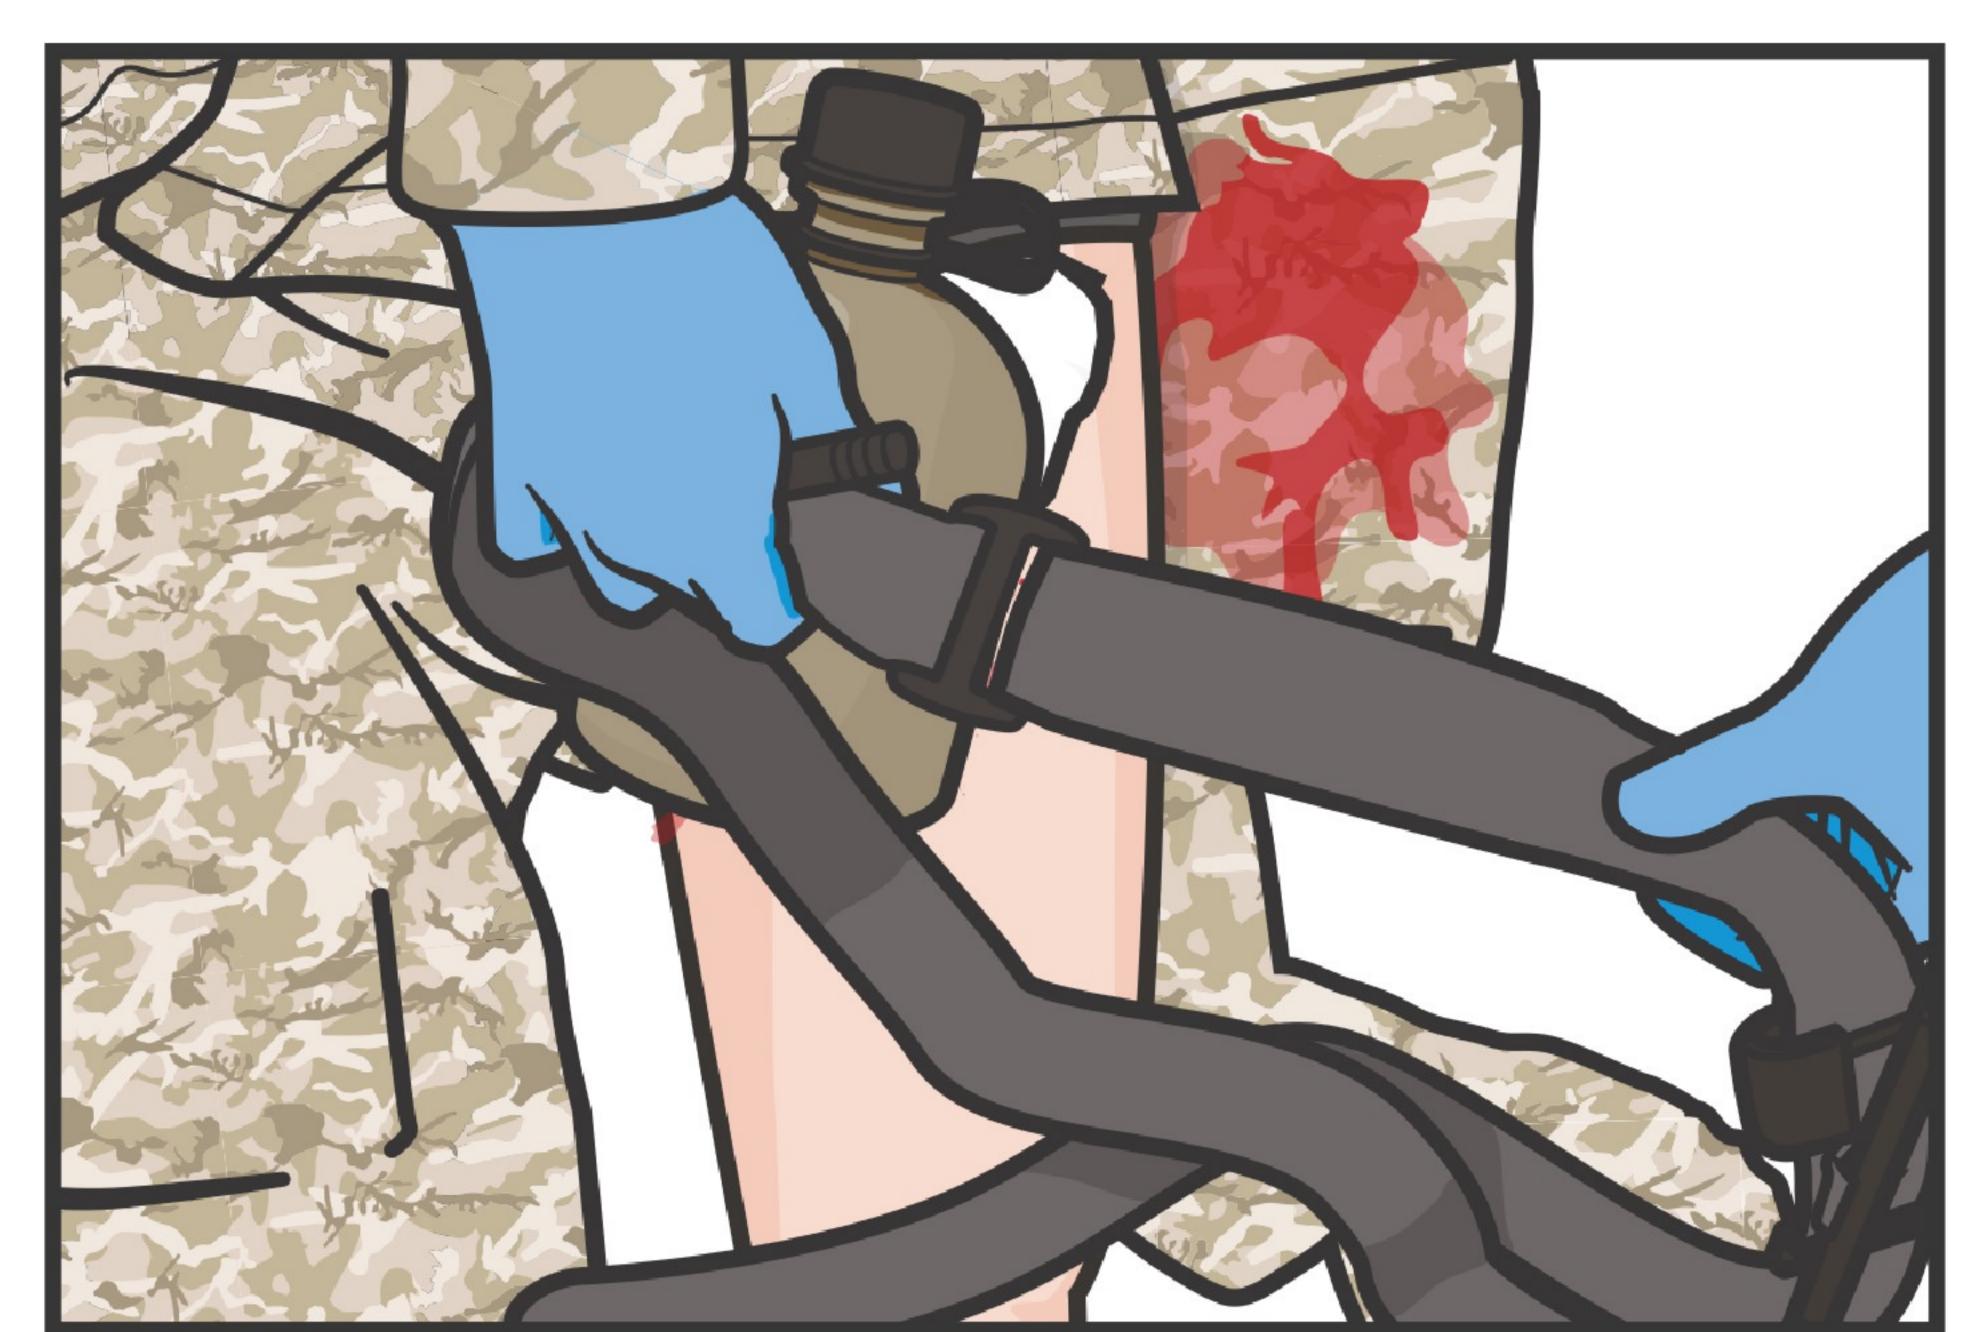


ОБЕРІТЬ турнікет, який можна буде обернути навколо талії/стегна пораненого, або з'єднайте разом два турнікети.

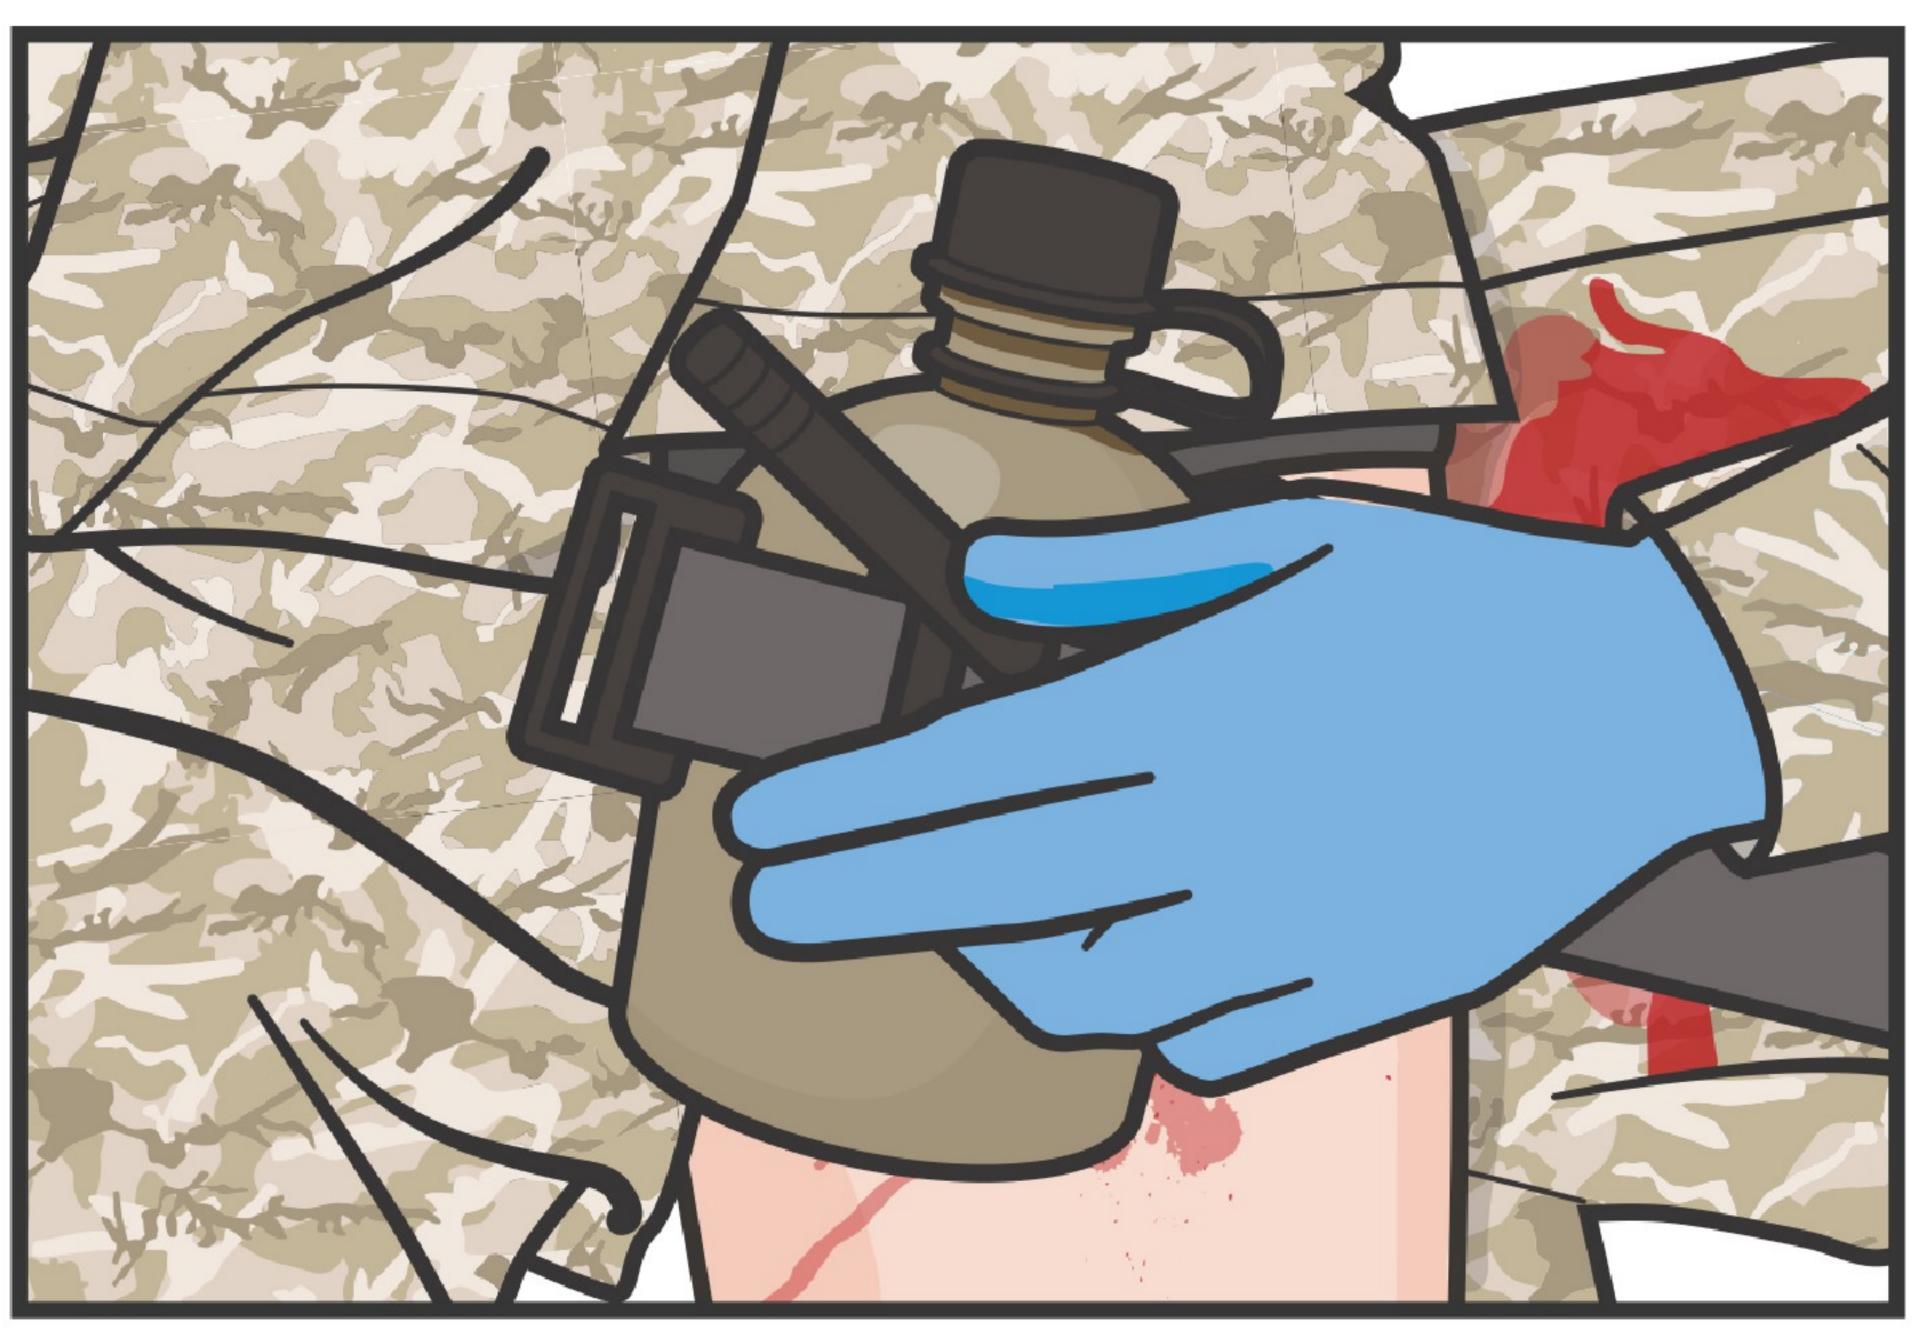

РОЗТАШУЙТЕ турнікет із зубчастим механізмом або турнікет з воротком і пряжкою безпосередньо над серединою ПСТ; упевніться, що зубчастий механізм/вороток розташований у напрямку досередини тіла.

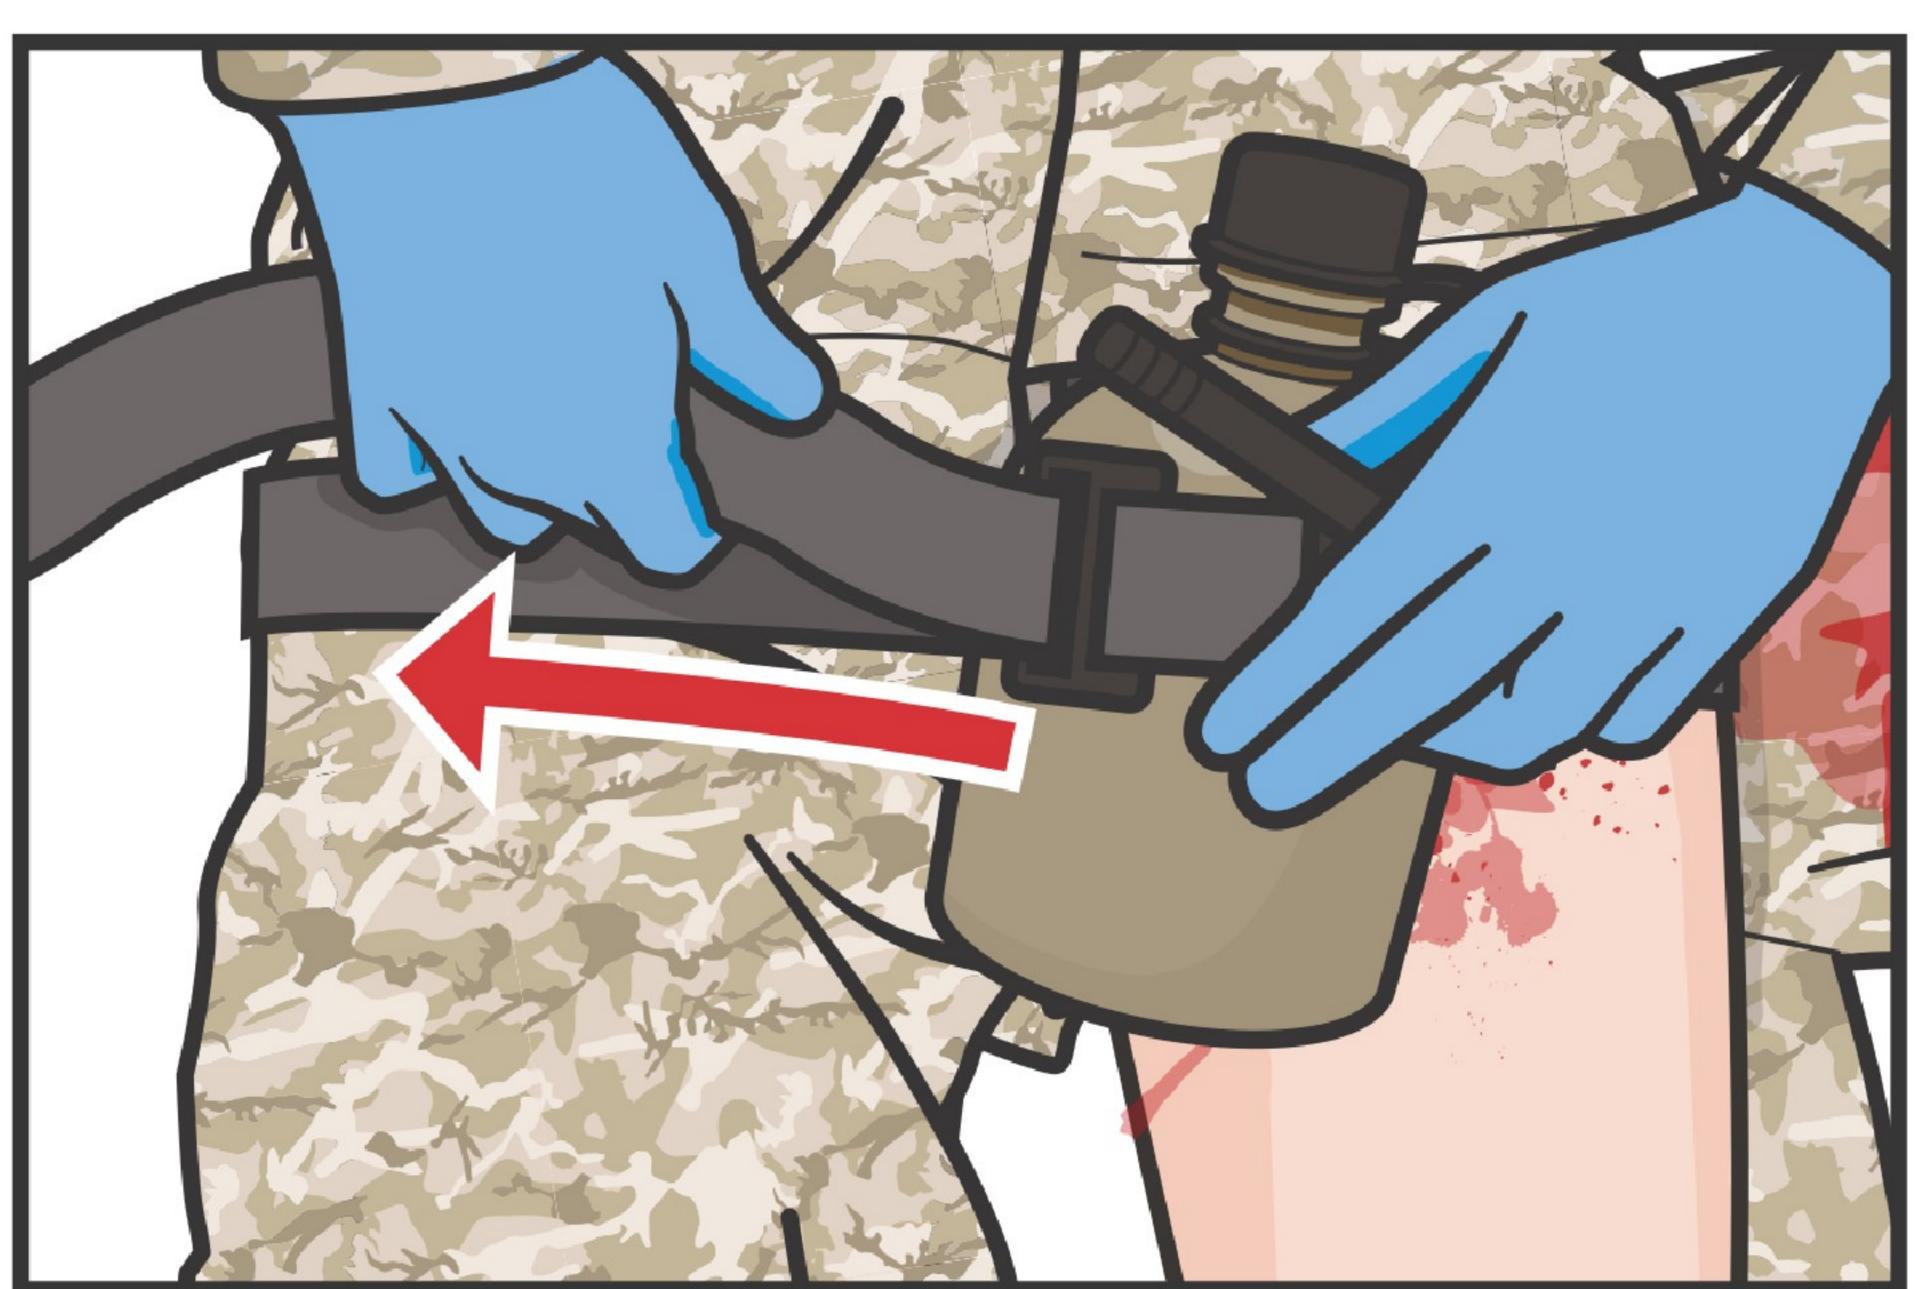


Перед затягуванням турнікета УСУНЬТЕ всі провисання ременя/самоклейкої стрічки, штовхаючими рухами впоперек тіла пораненого.

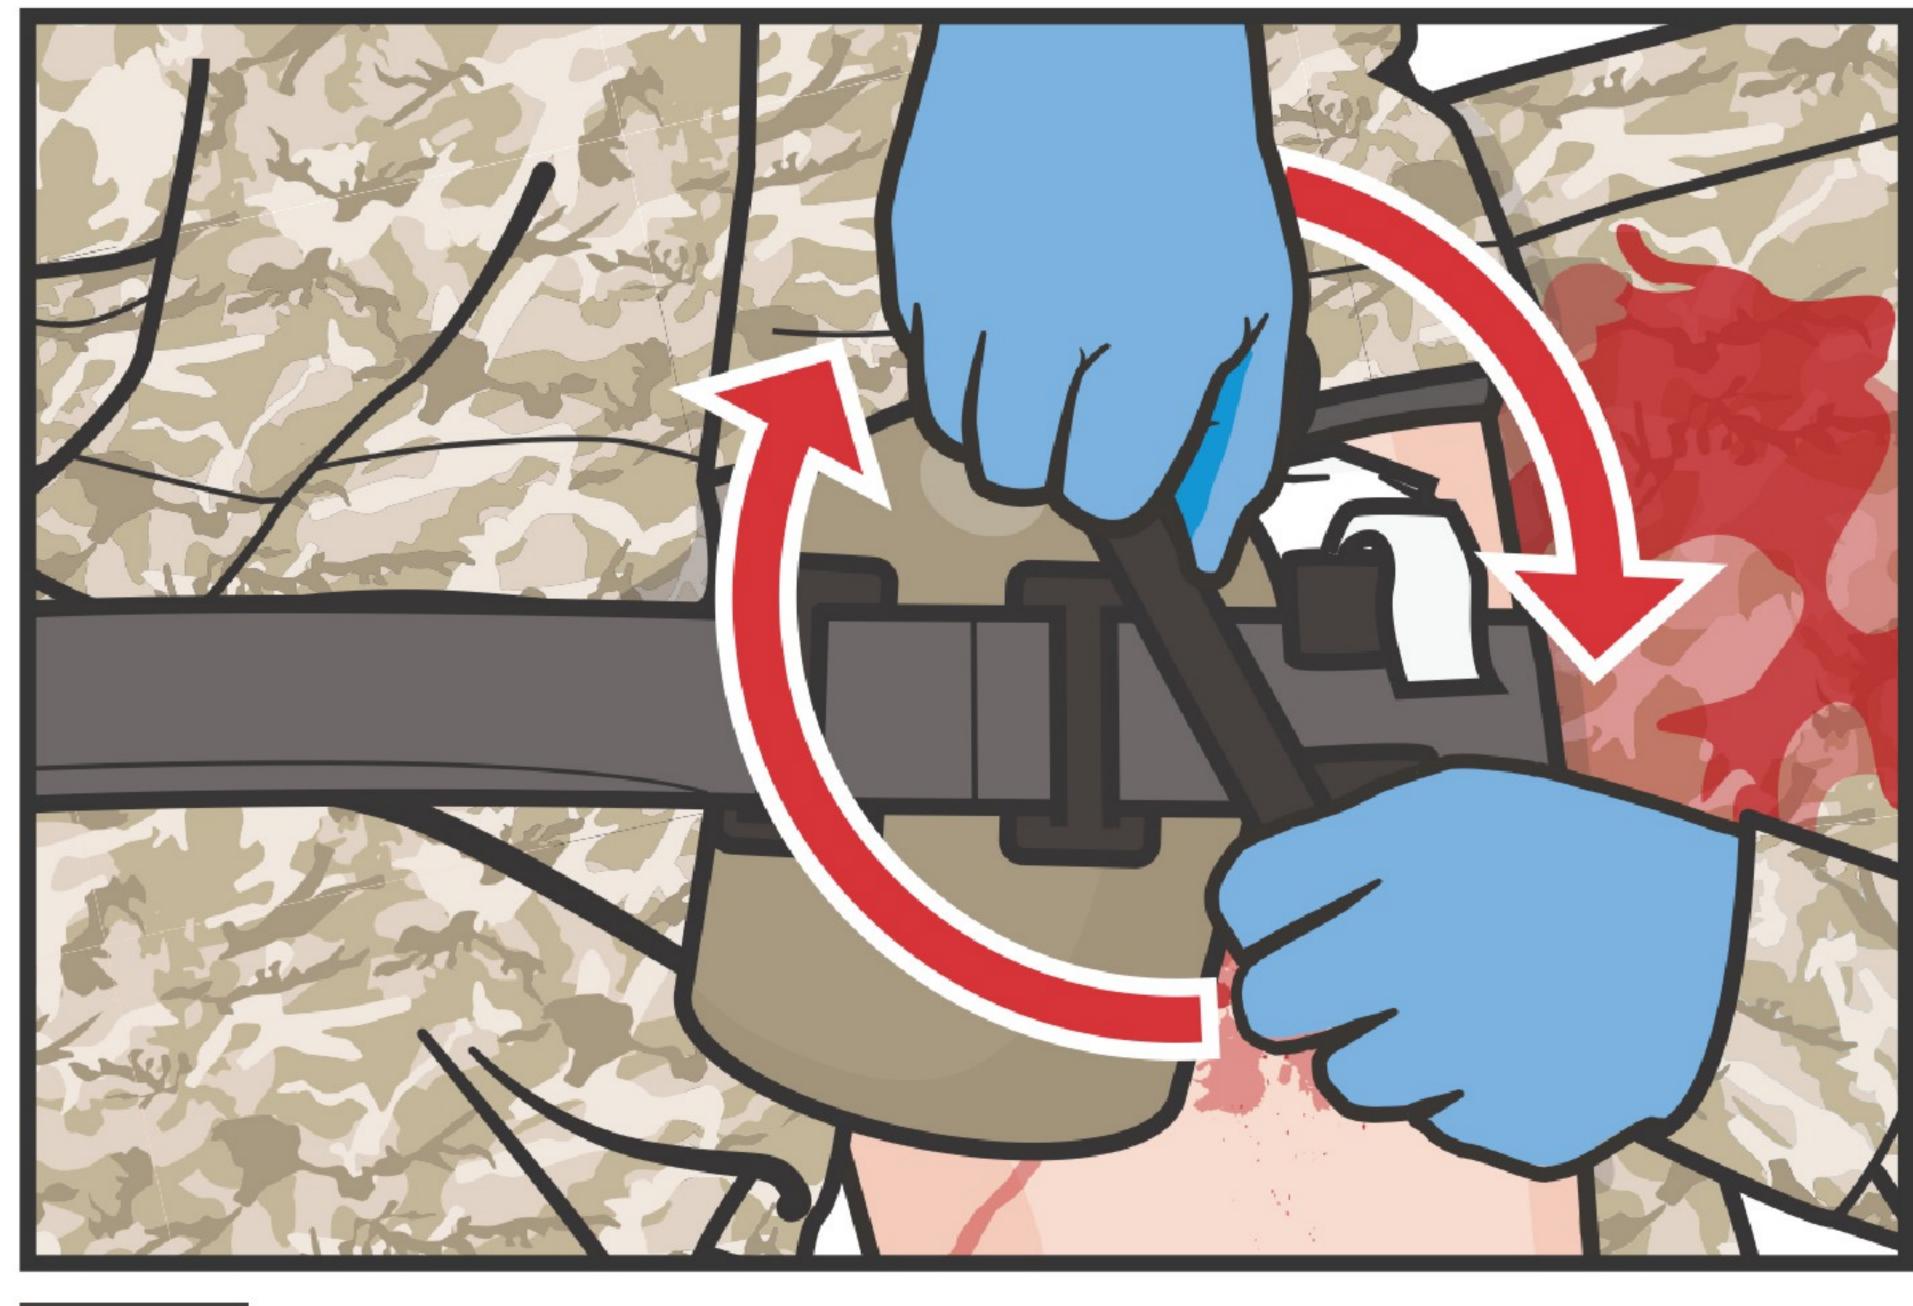


ЗАТЯГНІТЬ турнікет до припинення кровотечі та зникнення дистального пульсу на кінцівці.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Якщо кровотеча не зупинилася та не зник дистальний пульс нижче накладання турнікета, усуньте всі залишкові провисання ременя (якщо це можливо) і сильніше закрутіть вороток або затягніть зубчастий механізм турнікета, доки кровотечу не буде зупинено та доки не зникне дистальний пульс.

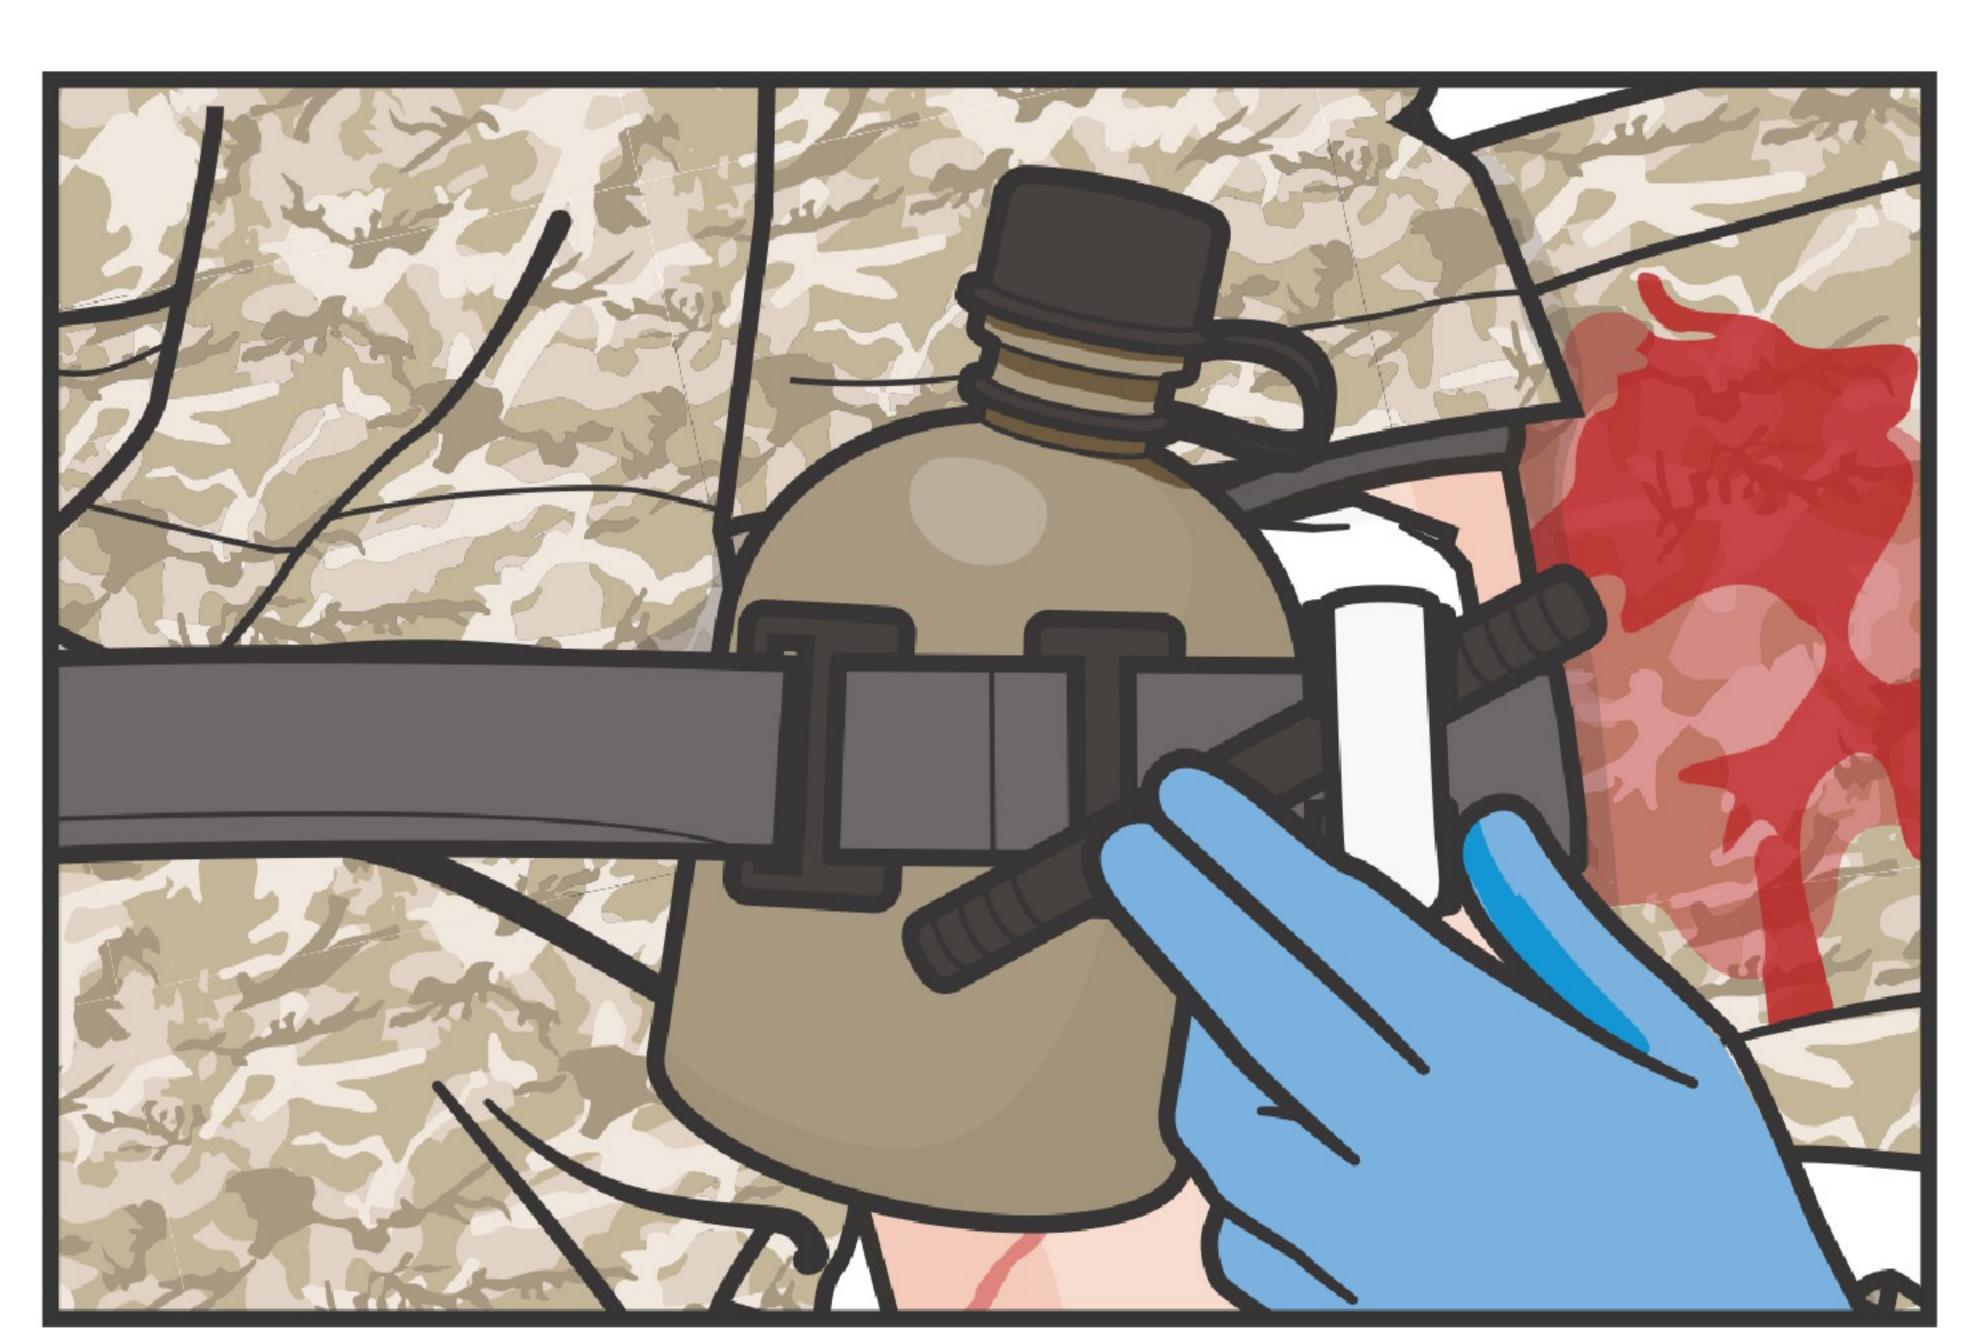

ОГЛЯНЬТЕ розташування обладнання та переконайтеся, що ПСТ не змістився, а зубчастий механізм/вороток і пряжка знаходяться в належній позиції над пристроєм.

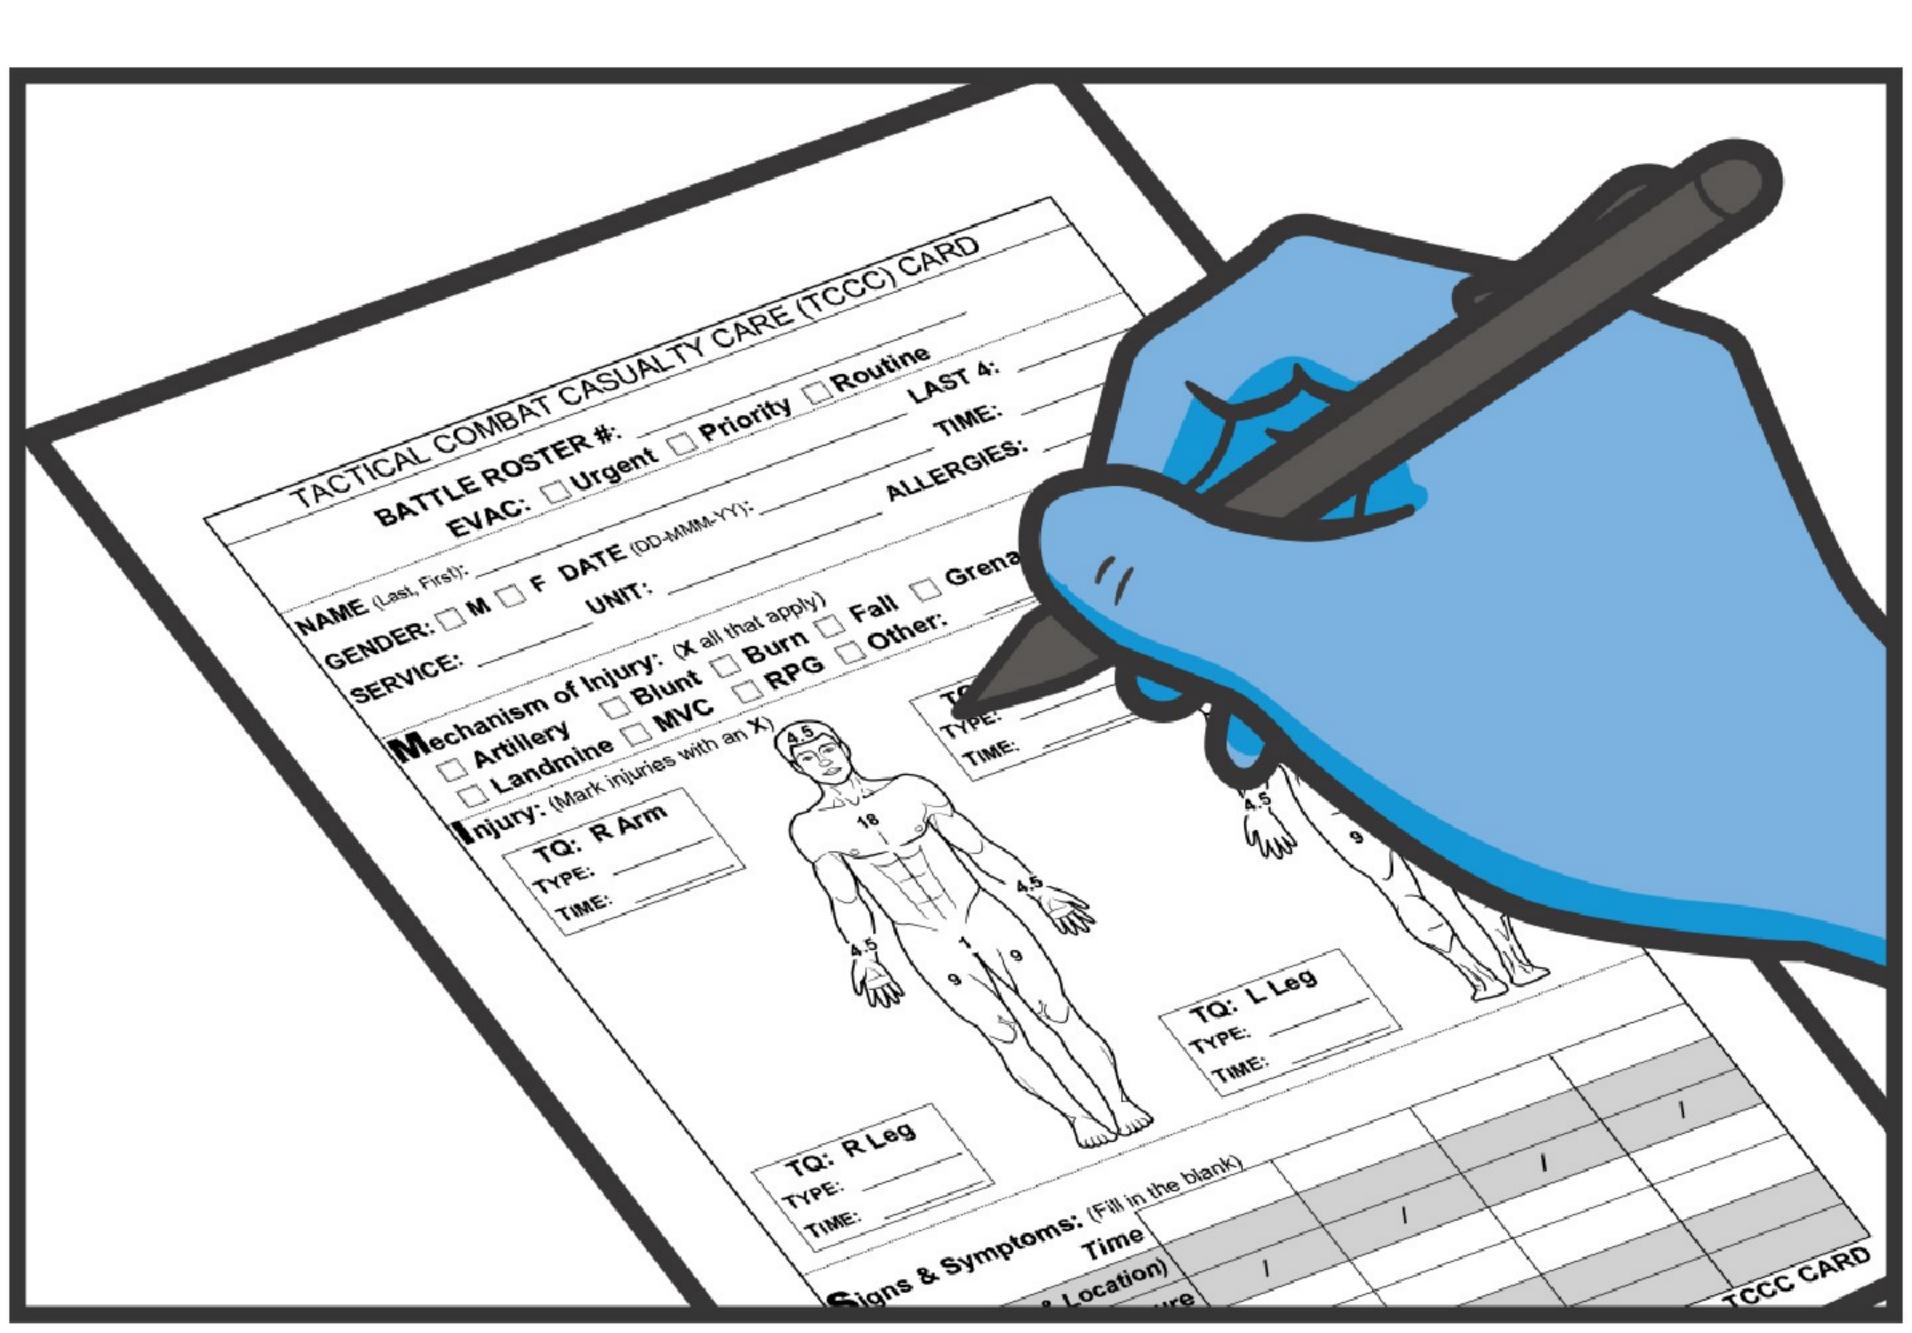

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.