


Penempatan elektroda RA, LA, RL dan klip PPG pada pengguna

Patient's
right


Anterior view

Patient's
left

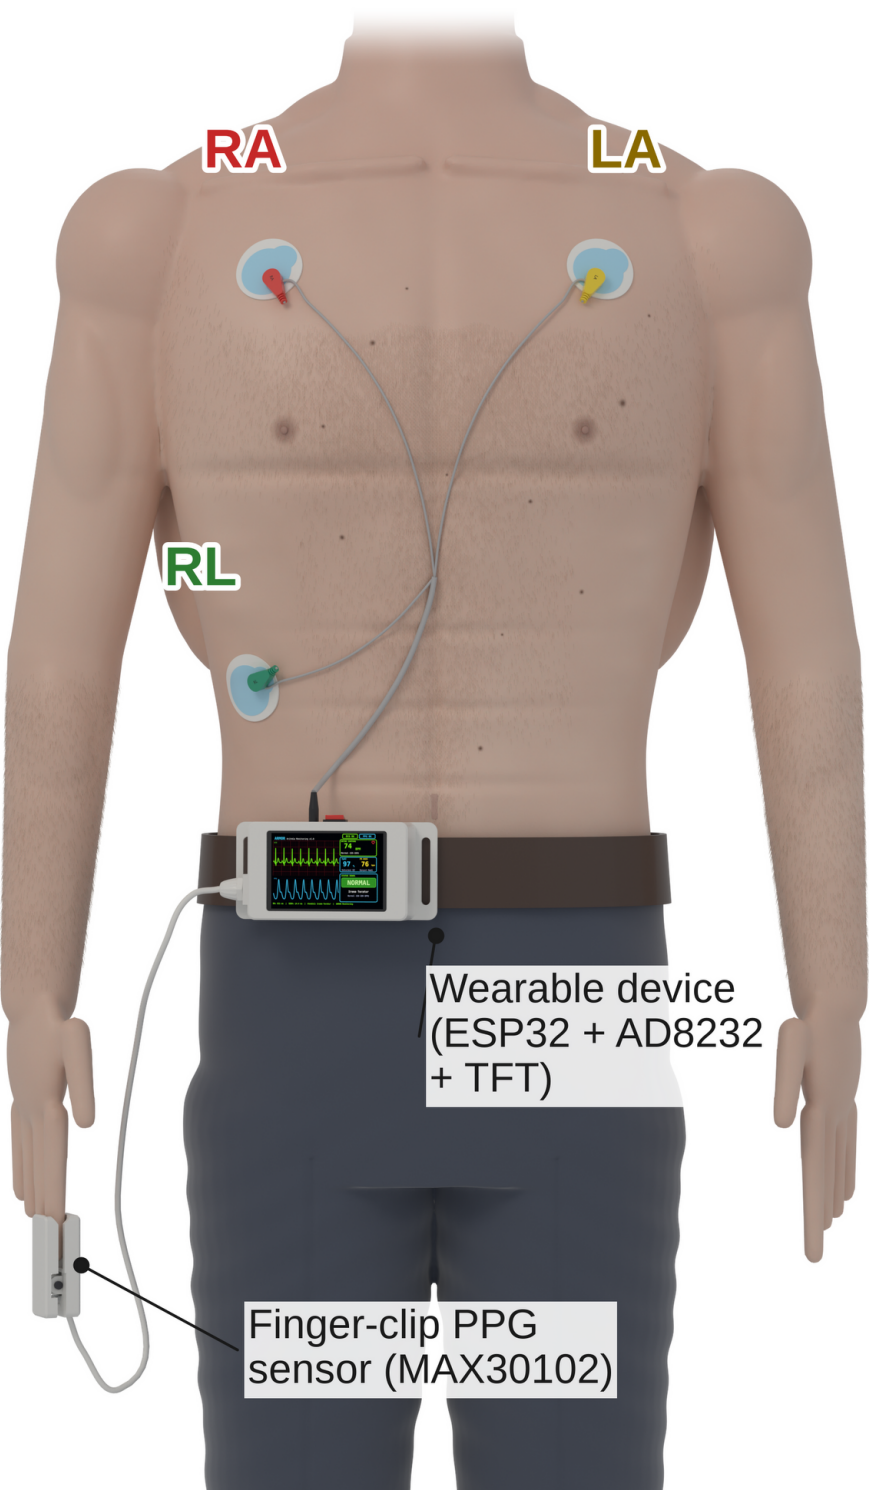

Wearable device
(ESP32 + AD8232
+ TFT)

Finger-clip PPG
sensor (MAX30102)

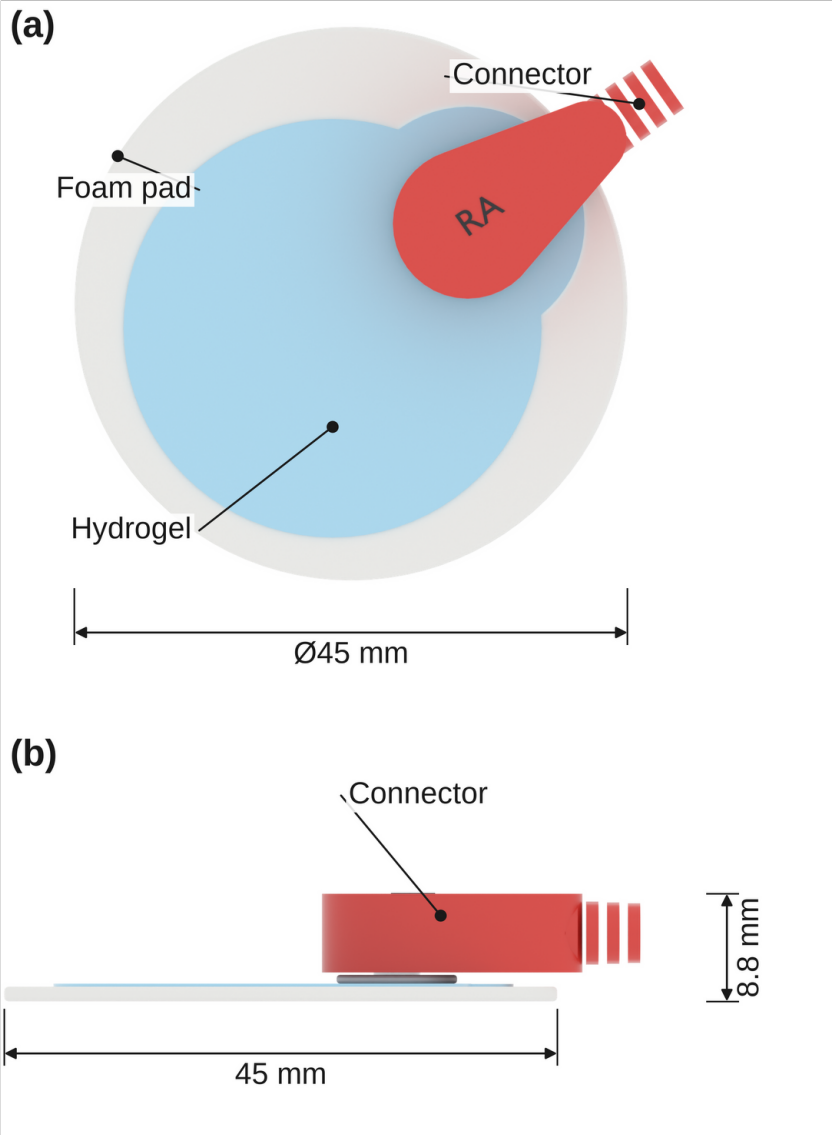

Gambar jurnal: penempatan elektroda

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

RA merah, LA kuning, RL hijau; klip MAX30102

Keterangan: bagian J-1

Satuan: mm | Skala: tidak diskalakan

Halaman 16/16 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)