


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

İNFRARUJ AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-250 W Gücünde olmalıdır.

2-

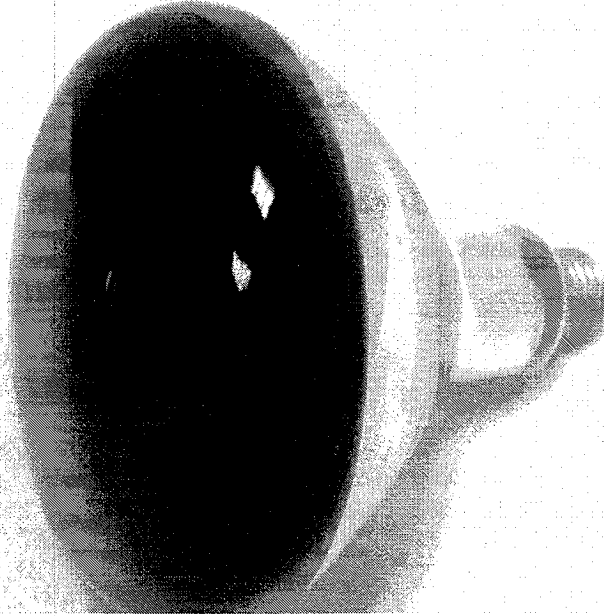

3-TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

4-Garantili olmalıdır.

Beypazarı Devlet Hastanesi
Fikret KÖKÇE
Teknisyen
Sicil No. MM857

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Sorumlu
Tee. *Büyük*
SICİL NO: HEST 15