



SATINALMA BİRİMİ

*PATOLOJİ... LABORATUVARI... KİRTASİYE... VE...  
TİBBI... MALZEME... ALIMI*

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK  
GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alının acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mali ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümküntür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin OZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: *09/09/2016*  
SAAT: *15:22*

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

I.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : PATOLOJİ STOĞU

Talep Tarihi / No : 04/08/2016... /

1018

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		CAMA YAZAR KALEM (İNCE UÇLU)		YOK	Künye No: 40 ADET
2		KSILENE DAYANIKLI CAMA YAZAR KALEM		YOK	Künye No: 10 ADET
3	150-03-04	SAKLAMA KABI NON STERİL 10000ML		YOK	Künye No: 100 ADET
4	150-03-03	SAKLAMA KABI NON STERİL 7500ML		YOK	Künye No: 100 ADET
5		ALÜMINYUM AMONYUM SÜLFAT		YOK	Künye No: 10 KİLOGRAM
6		HEMOTOXİLENE 500 GR		YOK	Künye No: 500 GRAM ADET
7	150-03-04	FORMALİN HAZIR TAMPONLU		YOK	Künye No: 3000 LİTRİ
8	150-03-03	BİSTÜRİ UCU NO: 24		YOK	Künye No: 25 ADET
9	150-03-04	GLİSEROL		YOK	Künye No: 50 LİTRİ
10	150-03-04	MEGAFUNNEL.		YOK	Künye No: 1000 ADET
11	150-03-03	LIGHT GREEN		YOK	Künye No: 100 GRAM

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
2016 YIL SONUNA KADAR YETECEK MİKTARDIR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim DRA.Y. ANKARA OAK ÇALMAZ ARŞ.HST. Kazım SÖZBÜYÜKLU Elçilik İmzayı
	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Dr. Aykut ONÇÜSEVER Patoloji Uzmanı Dip. Neurol. AA-116 Klinik İdari Sorumlusu
	..... / ..... / 20....	T.C.S.B. Dr.A.Y. Ankara Onkoloji Eğit. ve Arş. Hst. Prof. Dr. Oktay KANDEMİR DiKMS. Bantlı
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü <i>.../..../.....</i>
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yönetisi <i>.../..../.....</i>

18

**T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman  
Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

**CAMA YAZAR KALEM ASETAT  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**


Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji bölümünde kullanılmak üzere cama yazar kalem asetat teknik şartnamesidir.


**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Kalem 0,3 (S), ince uca sahip olmalıdır.
- 2.2. Hidrofobik ve permanent özellikte olmalıdır.
- 2.3. Kolay yazabilir olmalıdır.
- 2.4. Suda ve asetonda kolayca silinmemelidir.
- 2.5. Mavi, kırmızı ve siyah renkleri mevcut olmalıdır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnameye belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
DR. A. YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARŞİV HAST.  
KOD: 11111111111  
Recep KOYLUOĞLU  
Bölge Teknisyen

  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep KOYLU  
Bölge Tek.

2

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ  
DR. ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

**KSİLENE DAYANIKLI CAMA YAZAR KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde kullanılacak Ksilene Dayanıklı Cama Yazar Kalem teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Patoloji Laboratuarda kaset ve lam yazmaya uygun olmalıdır.
- 2.2. Orijinal kaset ve lam yazar kalem olmalıdır.
- 2.3. Ksilene girdiğinde silinmemelidir.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

T.C.S.B.  
D.R.A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARASTIRMALAR MERKEZİ  
Kazım ELIFOĞLU  
Baş Teknisyen



L. S. b.  
D.R.A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARASTIRMALAR MERKEZİ  
Wz. Bı. Fisun ARDIÇ  
Patoloji Uzmanı  
Dfu. No: 3142



D.R.A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARASTIRMALAR MERKEZİ  
T.C. S. B.  
Dr. Z. Melda BULUT  
Patoloji Uzmanı



T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Abdurrahman  
Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## SAKLAMA KABI DISPOSABLE NON STERİL PLASTİK 7500 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Patoloji Kliniği'nde kullanılacak saklama kabı disposable non steril plastik 7500ml teknik şartnamesidir.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Saklama kabı 7500 ml kapasiteli olmalıdır.
- 2.2. Şeffaf (içi görülebilen) formaline dayanıklı, sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3. Non steril ve disposable olmalıdır.
- 2.4. Kapakları açılmayacak ve sızdırımayacak şekilde vidalı veya güvenilir kilitli olmalıdır.
- 2.5. Saklama kabının ağız kısmı ile taban kısmı ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır.
- 2.6. Ürün üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

### 3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özelliklerini taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnameye belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

T.C Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onkoloji  
Recep KOŞLU  
Bölge Hast.

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM  
ARASTIRMA HASTANESİ**

DS.B1  
DR. Z. YÜKSELİKAĞAOĞLU EĞ. ve ARS.HST.  
Kazım ELİFOĞLU  
Bşk Teknisyen

4/10

T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman  
Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## SAKLAMA KABI DISPOSABLE NON STERİL PLASTİK 10000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Patoloji Kliniğinde kullanılacak saklama kabi disposable non steril plastik 10000ml teknik şartnamesidir.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Saklama kabi 10000 ml kapasiteli olmalıdır.
- 2.2. Şeffaf (içi görülebilen) formaline dayanıklı, sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3. Non steril ve disposable olmalıdır.
- 2.4. Kapakları açılmayacak ve sızdırmayacak şekilde vidalı veya güvenilir kilitli olmalıdır.
- 2.5. Saklama kabının ağız kısmı ile taban kısmı ölçüleri arasında çok büyük fark olmamalıdır.
- 2.6. Ürün üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

### 3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özelliklerini taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

DRA. A. YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARŞİV HASTANESİ  
K. Ümm ELİFOĞLU  
Baş Teknisyen

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep ODTÜ  
BİS/10

5/2

T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## ALUMİNYUM AMONYUM SÜLFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde kullanılacak Aluminyum amonyum Sülfat teknik şartnamesidir.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. En fazla 2.5 kg. lük orijinal ambalaj olmalıdır.
- 2.2. NH<sub>4</sub> AL (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.12 H<sub>2</sub>O formülünde olmalı M=453,33 G/mol ve %99 saflikta olmalıdır.

### 3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnameye belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi

T.C. S.B.  
DR. A. YURTAŞLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARŞ. HST.  
Kazım EKİFOĞLU  
Baş Teknisyen

Birim Yetkilisi

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep KÖYÜK  
Başhekim Yardımcısı

Birim Yetkilisi

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM**  
**ARŞAFTIRMA HASTANESİ**  
ONAY  
Başhekim Yardımcısı

12

T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## HEMATOKSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere Hematoksilen Teknik Şartnamesidir.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Kimyasal formülü (C<sub>16</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>) olmalı, FW: 302.3 gr/mol olmalıdır.
- 2.2. Kristal şeklinde 100 gr'lık ambalajda olmalıdır.
- 2.3. C.I.No 75290 olmalıdır.
- 2.4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

### 3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

KOSB  
DELA ANKARA ONKOLOJİ EĞİT. VE ARŞ.HST.  
Kazım ELİFOĞLU  
Baş Teknisyen

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan-Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep KOYSU  
Baş Teknik

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM  
ARAŞTIRMA HASTANESİ

7

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ  
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  
HASTANESİ

**TAMPONLU FORMALİN  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Patoloji Kliniği'nde kullanılacak formalin teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 2.1. Patoloji laboratuarlarında kullanıma uygun histolojik fiksatif olmalıdır.
- 2.2. Sodium dihidrojen fosfat ve disodyum hidrojen fosfat tuzları ile tamponlanmış olmalıdır.
- 2.3. 25 C'da pH 7, nötral olmalıdır.
- 2.4. %10'luk kullanıma hazır olmalıdır.
- 2.5. Üretici tarafından verilen analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
- 2.6. Bölümün talebi doğrultusunda 5 litrelik veya 20 litrelik ambalajlarda teslim edilecektir.
- 2.7. Ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
- 2.8. Teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miyeli olmalıdır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnameye belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

T.C. B.B.  
D.R.A.Y. ANKARA İLİ KAMU HAST. BİRLİĞİ DR. ABDURRAHMAN YURTARSLAN  
Kazım EYLÜL OĞLU  
Baş Teknisyen

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Ünlü Hast. Ve Ara. Hast.  
Recep KÖYÜK  
Böl. Sek.

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM  
ARAŞTIRMA HASTANESİ**

8

**T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  
HASTANESİ**

**BİSTÜRİ UCU NO: 24  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniğinde kullanılmak üzere bistüri ucu no:24 teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
- 2.2. Bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasından oynamamalıdır.
- 2.3. Malzeme orijinal steril ambalajında ambalaj üzerinde; üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 100'er adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 2.4. 24 numara olmalıdır.
- 2.5. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

T.C.S.B.  
D.R.A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARŞ.HST.  
KAZMI DİŞ İÇ İLGİLERİ  
Baş Teknisyen

L.C.B. 2  
Dr. A. Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARŞ.HST.  
Uz.Dr. Fısun ARDIÇ  
Patoloji Uzmanı  
Dip.No:3142

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtarslan Ankara EĞİT. ve Arş. Hast.  
Recep KOVSU  
Baş Tek

T.C

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## GLİSEROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılacak gliserol teknik şartnamesidir.


### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Molekül formülü C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> olmalıdır.
- 2.2. Molekül ağırlığı 92.10 gr/mol olmalıdır.
- 2.3. Ambalajı cam veya sert plastikten yapılmış orijinal ambalajında olmalıdır.
- 2.4. Pataloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.

### 3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özelliklerini taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

  
T.C.S.B.  
TÜRKİYE KAMU ONKOLOJİ EĞİT. VE ARŞ. HST.  
KAZIM ELIFOĞLU  
Baş Teknisyen

  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep KÖYÜ  
Baş Tek

T.C  
Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

### MEGAFUNNEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. KONU :**

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde kullanılacak Megafunnel teknik şartnamesidir.

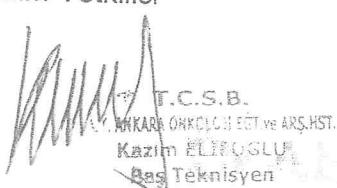
**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Laboratuarda kullanılan (Cytospin Cytocentrifuge) cihazı için ve buna uyumlu, disposable olmalıdır.
- 2.2. Buna uygun özel jamları ile birlikte verilecektir.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi




T.C.S.B.  
ANKARA ONKOLOJİ EĞİT. ve ARŞ.HST.  
Kazım ELIFOGLU  
Baş Teknisyen

Birim Yetkilisi



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dr. A. Yurtaslan Onk. Eğit. ve Arş. Hast.  
Recep KOŞLU  
Baş Tek.

Birim Yetkilisi



RECEP KOŞLU  
Baş Tek.

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM**  
**ONAY**  
Başhekim Yardımcısı

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM**  
**HASTANESİ**

**T.C**  
**Sağlık Bakanlığı**  
**Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu**  
**Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan**  
**Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

### LIGHT GREEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. KONU :**

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde kullanılacak Light Green tüp teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Kimyasal formülü C37 H34 na 2 O9 S3 olmalıdır.
- 2.2. CI 42095 olmalıdır.
- 2.3. Analitik saflikta olmalıdır.
- 2.4. Orijinal ambalajda olmalıdır

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satın Alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup, uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecektir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özelliklerini taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi

D.L.N.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİT. VE ARAŞ.HAST.  
 Dr. A. YURTASLAN  
 KANUN ELİFOĞLU  
 Baş Teknisyen

Birim Yetkilisi

T.C. Sağlık Bakanlığı  
 Dr. A. Yurtaslan ORT. EĞİT. VE ARAŞ. HAST.  
 Recep TOYSU  
 Baş MÜD.

Birim Yetkilisi

**ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM**  
**ARAŞTIRMA HASTANE**  
**ONAY**  
**Başhekim Yardımcısı**